



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, MOBILIARIO CLÍNICO Y SEÑALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS (AREA SANITARIA VI)

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro e instalación del mobiliario de oficina, mobiliario clínico y señalización a utilizar en el Hospital del Oriente de Asturias (Área Sanitaria VI).

Este pliego tiene como finalidad definir el ámbito de desarrollo del suministro a realizar y las condiciones que se deben cumplir, complementando aquello especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las dependencias a equipar son las que figuran en los planos de la obra de rehabilitación Consultas Externas y Salud Mental ubicadas en el ala oeste y Consultas Externas ubicadas en el ala este del Hospital del Oriente de Asturias (Anexo I).

Se pretende la adquisición de artículos de calidad que garanticen su durabilidad y la inversión patrimonial a lo largo del tiempo.

Los artículos se elegirán dentro de una gama estética funcional, de manera que todos ellos guarden uniformidad en el diseño en cuanto a formas, sistemas, acabados y materiales.

El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario y equipamiento electrónico, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material.

Los artículos electrónicos incluirán las programaciones necesarias para su correcto funcionamiento.


En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en este pliego de Prescripciones Técnicas, así como en las normativas de obligado cumplimiento, en especial aquellas relativas a la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.- ACOPIO, ENTREGA, MONTAJE Y COLOCACIÓN

Los adjudicatarios deberán realizar previo al suministro mediciones exactas en las instalaciones, al objeto de verificar que no existan diferencias con los planos facilitados en el Anexo I que puedan afectar a la posterior ubicación del mobiliario.

El adjudicatario, antes de la entrega contactará con los responsables del Área Sanitaria VI y visitará los lugares de descarga y almacenaje al efecto de coordinar la operativa de la entrega.

El equipamiento deberá transportarse debidamente embalado y protegido. El deterioro de algún elemento como consecuencia de su manipulación durante las tareas de carga/descarga



e instalación será imputable al adjudicatario. Este se comprometerá por escrito a reponer el elemento dañado en un plazo no superior a 48 horas.

El adjudicatario ubicará e instalará por sus medios el mobiliario en los lugares establecidos y los dejará totalmente operativos para la ocupación por el personal destinado en el mismo.

El suministro objeto del contrato se hará cuando las nuevas Consultas y Salud Mental aún no estén ocupadas y al mismo tiempo que la puesta a punto de las nuevas instalaciones. La entrega, acopio, montaje e instalación se hará siempre evitando distorsionar el correcto funcionamiento de la citada puesta en marcha.

En caso contrario, si la anterior circunstancia no fuera viable, la empresa adjudicataria será encargada de almacenar los artículos adjudicados para proceder a su suministro, distribución y montaje de acuerdo a las instrucciones de los responsables del Área Sanitaria correspondiente.

Los productos deben incorporar una etiqueta de identificación, que sea duradera y fácilmente legible, situada en lugar accesible pero no visible en condiciones normales de utilización. En dicha etiqueta se especificarán el nombre o razón social del fabricante y del oferente, en caso de no ser coincidentes.

Con los bienes suministrados se entregarán las instrucciones que posibiliten al usuario la comprensión de su utilidad y su manejo y mantenimiento.

El contenido del lote tendrá que ajustarse exactamente a la oferta que resulte adjudicataria. No se admitirán ningún tipo de cambios en cuanto a los productos ofertados y que no hayan sido previamente y expresamente autorizados por escrito por los responsables del Área Sanitaria correspondiente.

La entrega de los muebles se rechazará si sus características físicas o técnicas no corresponden a los requerimientos del documento de licitación o no son las ofertadas, si los muebles pertenecen a una marca o modelo distintos del ofertado o los acabados no son los exigidos.

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

De manera general se puntualiza que el diseño de los muebles no podrá representar en ningún momento un riesgo durante el desplazamiento de las personas. En particular los soportes (pies) tendrán que estar posados de tal manera que no obstaculicen los movimientos del usuario.

Las partes del mueble con las cuales el usuario está directamente en contacto, en condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida corporal (por ejemplo, cortes y/o aplastamientos) y deterioro material (en concreto las partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni tienen que manchar).

Las aristas y los ángulos con los que el usuario está en contacto, en condiciones normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si la espesura de los materiales no permite respetar este radio de curvatura, las aristas tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que ser diseñados de



manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes.

Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio, y acabados por una parte lisa.

Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ella.

Específicamente se deberá cumplir las siguientes normas o equivalentes:

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO ENSAYO
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 527-1:2011
	Requisitos mecánicos de seguridad.	UNE-EN 527-2:2003
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 527-3:2003
Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-1/AC:2003
	Requisitos de seguridad.	UNE-EN 1335-2:2009
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.		UNE-EN 13761:2013
	Determinación de la estabilidad.	UNE-EN 1022:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 1728:2013
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Archivo	Requisitos de seguridad	UNE-EN 14073-2:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.	UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo.	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 14074:2005
Tableros derivados de la madera	Determinación del contenido en formaldehído. Método de extracción denominado del perforador.	UNE-EN ISO 12460-5:2016



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO ENSAYO
	Determinación de la emisión de formaldehído. Método de análisis de gas.	UNE-EN ISO 12460-3:2016 UNE-EN 717-2/AC:2003
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire. Método de la cámara pequeña.	ASTM D6007-02 (2008)
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire y velocidad de emisión. Método de la cámara grande.	ASTM E1333-96 (2002)
Mobiliario tapizado	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.	UNE-EN 1021-1:2015 ISO 8191-1:1988
	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.	UNE-EN 1021-2:2015 ISO 8191-2:1988
	Prueba de fuego de materiales compuestos tapizados para el asiento.	Bs 5852-1:1979
	Prueba de incendio de muebles forrados.	Bs 5852-2:1982
	Métodos de ensayo para la evaluación de la ignición de los asientos tapizados con fuentes de ignición	Bs 5852-2:1990 Bs 5852:2006

SEGURIDAD E HIGIENE

- Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido en el Real decreto 488/1997 del 14 de abril de 1997(transposición de la directiva europea 90/207/CEE).
- En todos los muebles donde existan componentes de cristal: puertas, elementos de separación, decoración, etc... se utilizarán siempre cristales de seguridad (templado o laminado), con independencia de indicar la presencia de este material en los embalajes.

ERGONOMIA

- Cumplimiento del real decreto 488/1997 del 14 de Abril de 1997(transposición de la directiva europea 90/207/CEE).

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Sublote 1.1: Alfombra goma eva
Sublote 1.2: Armario metálico persiana. Medidas 100x43,5x135cm
Sublote 1.3: Armario metálico persiana. Medidas 120x43,5x198cm



Sublote 1.4: Armario metálico persiana. Medidas 100x43,5x198cm
Sublote 1.5: Bancada 3 asientos
Sublote 1.6: Bancada 4 asientos
Sublote 1.7: Butaca
Sublote 1.8: Cortina enrollable separadora camilla medidas 200 x 270 cms.
Sublote 1.9: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 90x100 cms
Sublote 1.10: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 120x130 cms
Sublote 1.11: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 130x130 cms
Sublote 1.12: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 252x112 cms
Sublote 1.13: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 140x100
Sublote 1.14: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 280x100
Sublote 1.15: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 290x100
Sublote 1.16: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 295x100
Sublote 1.17: Estantería medidas 60 x 45 x 120 cms
Sublote 1.18: Estantería medidas 125 x 45 x 160 cms
Sublote 1.19: Mesa de oficina 1400 x 800 x 740 mm
Sublote 1.20: Mesa de oficina 1600 x 800 x 740 mm con ala
Sublote 1.21: Mesa para microscopio (2 puestos)
Sublote 1.22: Mesa Reuniones
Sublote 1.23: Mesita auxiliar baja
Sublote 1.24: Mesita baja infantil
Sublote 1.25: Perchero de Pared
Sublote 1.26: Silla de confidente con brazos color azul oscuro
Sublote 1.27: Silla de confidente con brazos color granate
Sublote 1.28: Silla ergonómica de trabajo color azul oscuro
Sublote 1.29: Silla ergonómica de trabajo color granate
Sublote 1.30: Sillas infantiles bajas
Sublote 1.31: Taburete alto con asiento en madera
Sublote 1.32: Taburetes ruedas sin respaldo regulable altura.
Sublote 1.33: Taquilla doble cuerpo (colgar y baldas)
Sublote 1.34: Videoprojector con cableado
Sublote 1.35: Vinilos decorativos zona pediatría
Sublote 1.36: Vitrina de pared con 2 puertas correderas de cristal

LOTE 2: Mobiliario Clínico

Sublote 2.1: Báscula electrónica con tallímetro
Sublote 2.2 : Camilla hidráulica con portarrollos
Sublote 2.3: Carro de acero inoxidable 2 baldas
Sublote 2.4: Lámpara de Exploración LED Cirugía Menor
Sublote 2.5: Sillón de Extracciones con dos ruedas traseras con freno y con apoyabrazos, azul
Sublote 2.6: Sillón Exploración ORL

LOTE 3: Señalización

Sublote 3.1: Señalización Área Consultas Externas (encima puerta entrada) 70x20 aprox
Sublote 3.2: Señalización Área Salud Mental (encima puerta entrada) 900x150mm aprox
Sublote 3.3: Señalización Aseos (250x250mm)



Sublote 3.4: Señalización de despachos (250x250mm)

Sublote 3.5: Señalización Puerta Consulta (250x250mm)

5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Los licitadores que presenten ofertas que no cumplan con las especificaciones mínimas que a continuación se describen, serán excluidos del presente procedimiento.

A tales efectos se adjuntan las fichas de autoevaluación según **Anexo III**, que deberán ser cumplimentadas por los licitadores.

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Los tipos de muebles propuestos tendrán que ser de modelos descritos dentro de una misma serie, para conseguir la máxima homogeneidad y armonización posible entre ellos.

Sublote 1.1: Alfombra goma eva

Medidas 200 x 200 cm

Fabricada con EVA (no contiene PVC)

Sublote 1.2: Armario metálico persiana. Medidas 100x43,5x135cm

Medidas: 100 x 43,5 x 135 cm ($\pm 5\%$)

Fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm

Pintura epoxi

3 estantes interiores regulables

Sistema antivuelco

Cerradura con llave

Sublote 1.3: Armario metálico persiana. Medidas 120x43,5x198cm

Medidas: 120 x 43,5 x 198 cm ($\pm 5\%$)

Fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm

Pintura epoxi

4 estantes interiores regulables

Sistema antivuelco

Cerradura con llave

Sublote 1.4: Armario metálico persiana. Medidas 100x43,5x198cm

Medidas: 100 x 43,5 x 198 cm ($\pm 5\%$)

Fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm

Pintura epoxi

4 estantes interiores regulables

Sistema antivuelco

Cerradura con llave

Sublote 1.5: Bancada 3 asientos

Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno

Estructura metálica epoxi

Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo

Sin brazos y sin mesa



Sublote 1.6: Bancada 4 asientos

Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno
Estructura metálica epoxi
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo
Sin brazos y sin mesa

Sublote 1.7: Butaca

Medidas: 71 alto x 78 ancho (46 alto asiento y 63 alto brazos) ($\pm 5\%$)
Estructura interior en madera con forma ergonómica
Recubrimiento de espuma de poliuretano de densidad variable y alta resiliencia HR
Patas de madera de haya
Tapicería vinílica impermeable antimicrobial, antibacterial y antimicótica

Sublote 1.8: Cortina enrollable separadora camilla medidas 200 x 270 cms.


Medidas: 200 cm. ancho x 270 cm. de alto
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)
Peso: 407 gr/m² aprox.
Espesor: 0,25 – 0,33 mm
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.9: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 90x100 cms

Medidas: 90 cm. ancho x 100 cm. de alto
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo,
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.
Enrollable mediante mecanismo de cadena
Apertura 3%
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.
Color blanco
Peso: 365-380 gr/m² aprox.
Espesor: 0,20 – 0,30 mm
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.10: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 120x130 cms

Medidas: 120 cm. ancho x 130 cm. de alto
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo,
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.
Enrollable mediante mecanismo de cadena
Apertura 3%
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.
Color blanco
Peso: 365-380 gr/m² aprox.
Espesor: 0,20 – 0,30 mm
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo



Sublote 1.11: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 130x130 cms

Medidas: 130 cm. ancho x 130 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo,

Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.

Enrollable mediante mecanismo de cadena

Apertura 3%

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Color blanco

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.12: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 252x112 cms

Medidas: 252 cm. ancho x 112 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo,

Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.

Enrollable mediante mecanismo de cadena

Apertura 3%

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Color blanco

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.13: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 140x100

Medidas: 140 cm. ancho x 100 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo

Fabricado con tubo de aluminio extrusionado

Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Altura mandos 2 metros

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.14: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 280x100

Medidas: 280 cm. ancho x 100 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo

Fabricado con tubo de aluminio extrusionado

Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)


Altura mandos 2 metros

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1



Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.15: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 290x100

Medidas: 290 cm. ancho x 100 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo

Fabricado con tubo de aluminio extrusionado

Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Altura mandos 2 metros

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m² aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.16: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 295x100

Medidas: 295 cm. ancho x 100 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo

Fabricado con tubo de aluminio extrusionado

Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Altura mandos 2 metros

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m² aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.17: Estantería medidas 60 x 45 x 120 cms

Medidas 60 x 45 x 120 cms ($\pm$ 5%)

Fabricada en melamina

Trasera 8 mm; Laterales 19 mm

2 estantes de 25 mm

Sublote 1.18: Estantería medidas 125 x 45 x 160 cms

Medidas 125 x 45 x 160 cms ($\pm$ 5%)

Fabricada en melamina

Trasera 8 mm; Laterales 19 mm

3 estantes de 25 mm

Sublote 1.19: Mesa de oficina 1400 x 800 x 740 mm

Medida de la mesa 1400 x 800 x 740 mm ($\pm$ 5%)

Acabado de la superficie mesa en melamina 25 mm.

Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi


4 patas metálicas de 50x50 mm

Bandeja organización para cableado


Sublote 1.20: Mesa de oficina 1600 x 800 x 740 mm con ala

Acabado de la superficie mesa en melamina

Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi



4 patas metálicas de 50x50 mm Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm ($\pm 5\%$) Medida del ala de 960 x 600 x 740 mm ($\pm 5\%$) Faldón a juego con mesa y ala Bandeja organización para cableado
Sublote 1.21: Mesa para microscopio (2 puestos) Medida de la mesa 120 + 120 x 60 x 74 cm. ($\pm 5\%$) Acabado de la superficie mesa en melamina Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi 4 patas de 50x50 mm
Sublote 1.22: Mesa Reuniones Medida 300 x 120 x 74 cm. ($\pm 5\%$) Acabado de la superficie mesa en melamina Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi 4 patas de 50x50 mm
Sublote 1.23: Mesita auxiliar baja Acabado de la superficie mesa en melamina Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi Medida de 620 x 620 mm ($\pm 5\%$) Altura 400 cm ($\pm 5\%$)
Sublote 1.24: Mesita baja infantil Medidas: Ø 100 cm x 58 cm de alto ($\pm 5\%$) Tapa en laminado de alta presión Cantos de DM mecanizados y barnizados
Sublote 1.25: Perchero de Pared Perchero metálico mural 3 o 4 colgadores
Sublote 1.26: Silla de confidente con brazos color azul oscuro Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento) Asiento y respaldo de polipropileno en color azul oscuro Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas
Sublote 1.27: Silla de confidente con brazos color granate Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento) Asiento y respaldo de polipropileno en color granate Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas
Sublote 1.28: Silla ergonómica de trabajo color azul oscuro Silla ergonómica con regulación automática en altura Sistema de regulación con mecanismo SYNCRO bloqueable en varias posiciones Asiento ergonómico con curvatura delantera Apoyabrazos regulables Regulación independiente de la altura del respaldo Regulación en profundidad del asiento (trasla/automático) Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor aproximadamente, e interior de madera o polipropileno



Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo

Sublote 1.29: Silla ergonómica de trabajo color granate

Silla ergonómica con regulación automática en altura

Sistema de regulación con mecanismo SYNCRO bloqueable en varias posiciones

Asiento ergonómico con curvatura delantera

Apoyabrazos regulables

Regulación independiente de la altura del respaldo

Regulación en profundidad del asiento (trasla/automático)

Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor aproximadamente, e interior de madera o polipropileno

Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo

Sublote 1.30: Sillas infantiles bajas

Medidas: 39 x 40 x 34 cm ($\pm 5\%$)

Fabricado en polipropileno

Apilables

A juego con mesa sublote 1.24

Sublote 1.31: Taburete alto con asiento en madera

Estructura metálica con 4 patas en tubo de acero redondo de 22x1,5 mm

Reposapiés en acero

Tapas en cada tapa en su apoyo en el suelo para evitar roces y ruidos

Asiento anatómico color haya regulable en altura y con respaldo

Sublote 1.32: Taburetes ruedas sin respaldo regulable altura.

Base fabricada en tubo de acero redondo de 25 mm de $\varnothing$ ($\pm 5\%$) con ruedas o topes deslizantes

Asiento tapizado polipiel en material ignífugo

Aro reposapiés

Incorpora columna de gas para regulación neumática de la altura del asiento

Sublote 1.33: Taquilla doble cuerpo (colgar y baldas)

Medidas: 30x50x180 cm ($\pm 5\%$)

Fabricadas en chapa de acero

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster

Bandeja y colgador para perchas

Bordes sin aristas

Bisagras ocultas

Con roseta de ventilación

Cerradura de cilindro con 2 llaves

Sublote 1.34: Videoprojector con cableado

Tecnología LCD

Luminosidad 3200 lumen


Enfoque manual

Resolución XGA

Ratio de proyección 1,5-1,8:1

Zoom manual

Con cableado de conexión para correcto funcionamiento



Sublote 1.35: Vinilos decorativos zona pediatría

Película de calandre polimérico con polímeros añadidos para reducir su encogimiento

Garantía exterior mínimo 5-7 años

Medidas 1000x1000 mm ($\pm 5\%$) de vinilo recortado con motivo a elegir (elefante, hipopótamo,...)

Sublote 1.36: Vitrina de pared con 2 puertas correderas de cristal

Medidas: 700x 250 x 500 mm ($\pm 5\%$)

Fabricada en acero esmaltado

Puertas correderas de cristal con cerradura

1 estante de cristal

LOTE 2: Mobiliario Clínico

Sublote 2.1: Báscula electrónica con tallímetro

Pantalla LCD con 5 dígitos de tamaño ≥ 15 mm

Capacidad mínima 4kg. Máximo entre 220 -250 KG.

Funcionamiento por conexión a red con el cargador provisto o con baterías internas (Pilas) incluidas.

Apagado automático.

Plataforma antideslizante

Rango de medida del tallímetro: 60-70 hasta 200 cm.

Cálculo automático del índice de masa corporal.

Tecnología de compensación de movimiento.

Firmware actualizable por conexión USB/RS232.

Sublote 2.2 : Camilla hidráulica con portarrollos

Medidas: 190 x 62 x 55-90 cm. ($\pm 5\%$)

Tres cuerpos con respaldo abatible

Estructura de acero con acabado epoxi

Peso soportado 180 kg.

Tapizado de gran densidad en material ignífugo

Motor hidráulico

Altura regulable

Sublote 2.3: Carro de acero inoxidable 2 baldas

Medidas 62x47x90 cm

Con cajón

Con ruedas

Sublote 2.4: Lámpara de Exploración LED Cirugía Menor

Lámpara LED flexible (7 W)

Base rodable de 5 tubos de acero inoxidable

Sublote 2.5: Sillón de Extracciones con dos ruedas traseras con freno y con apoyabrazos, azul

Sillón con motor eléctrico

Estructura en acero con recubrimiento epoxi

Respaldo, brazos y piernas elevables y reclinables


Tapizado en tela vinílica azul, antibacteriana, ignífugo

Ancho 62 cm ($\pm 5\%$)

Peso soportado 180 kg ($\pm 5\%$)

Con ruedas escamoteables

Posición especial Trendelenburg compensado



Certificado CE

Sublote 2.6: Sillón Exploración ORL

Zócalo circular muy estable con antideslizamiento periférico

Columna hidráulica

Capacidad 170 kg. ($\pm 5\%$)

Tapicería ignífuga

Altura variable 58 a 78 cm ($\pm 5\%$)

Reposabrazos elevables

Respaldo inclinable por cilindro de gas

Movimiento del respaldo y del reposapiernas combinado

Rotación 360° continua con bloqueo por pedal

Reposacabezas ajustable en altura e inclinación

LOTE 3: Señalización

Las características, materiales y dimensiones de la señalización que se detalla a continuación, deberán ajustarse al manual de señalización corporativo del SESPA según **Anexo II**

Sublote 3.1: Señalización Área Consultas Externas (encima puerta entrada) 70x20 aprox.

Suministro y colocación de placas de señalización Área Consultas Externas de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.2: Señalización Área Salud Mental (encima puerta entrada) (900x150mm)

Suministro y colocación de placas de señalización Área Salud Mental de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.3: Señalización Aseos (250x250mm)

Suministro y colocación de placas de señalización Aseos de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.4: Señalización de Despachos (250x250mm)


Suministro y colocación de placas de señalización Despachos de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.5: Señalización Puerta Consulta (250x250mm)

Suministro y colocación de placas de señalización Puertas Consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA


En Oviedo, a 15 de mayo de 2019

Alejandra Fernández Menéndez
Coordinadora Técnica de Recursos Materiales
Servicio de Salud del Principado de Asturias

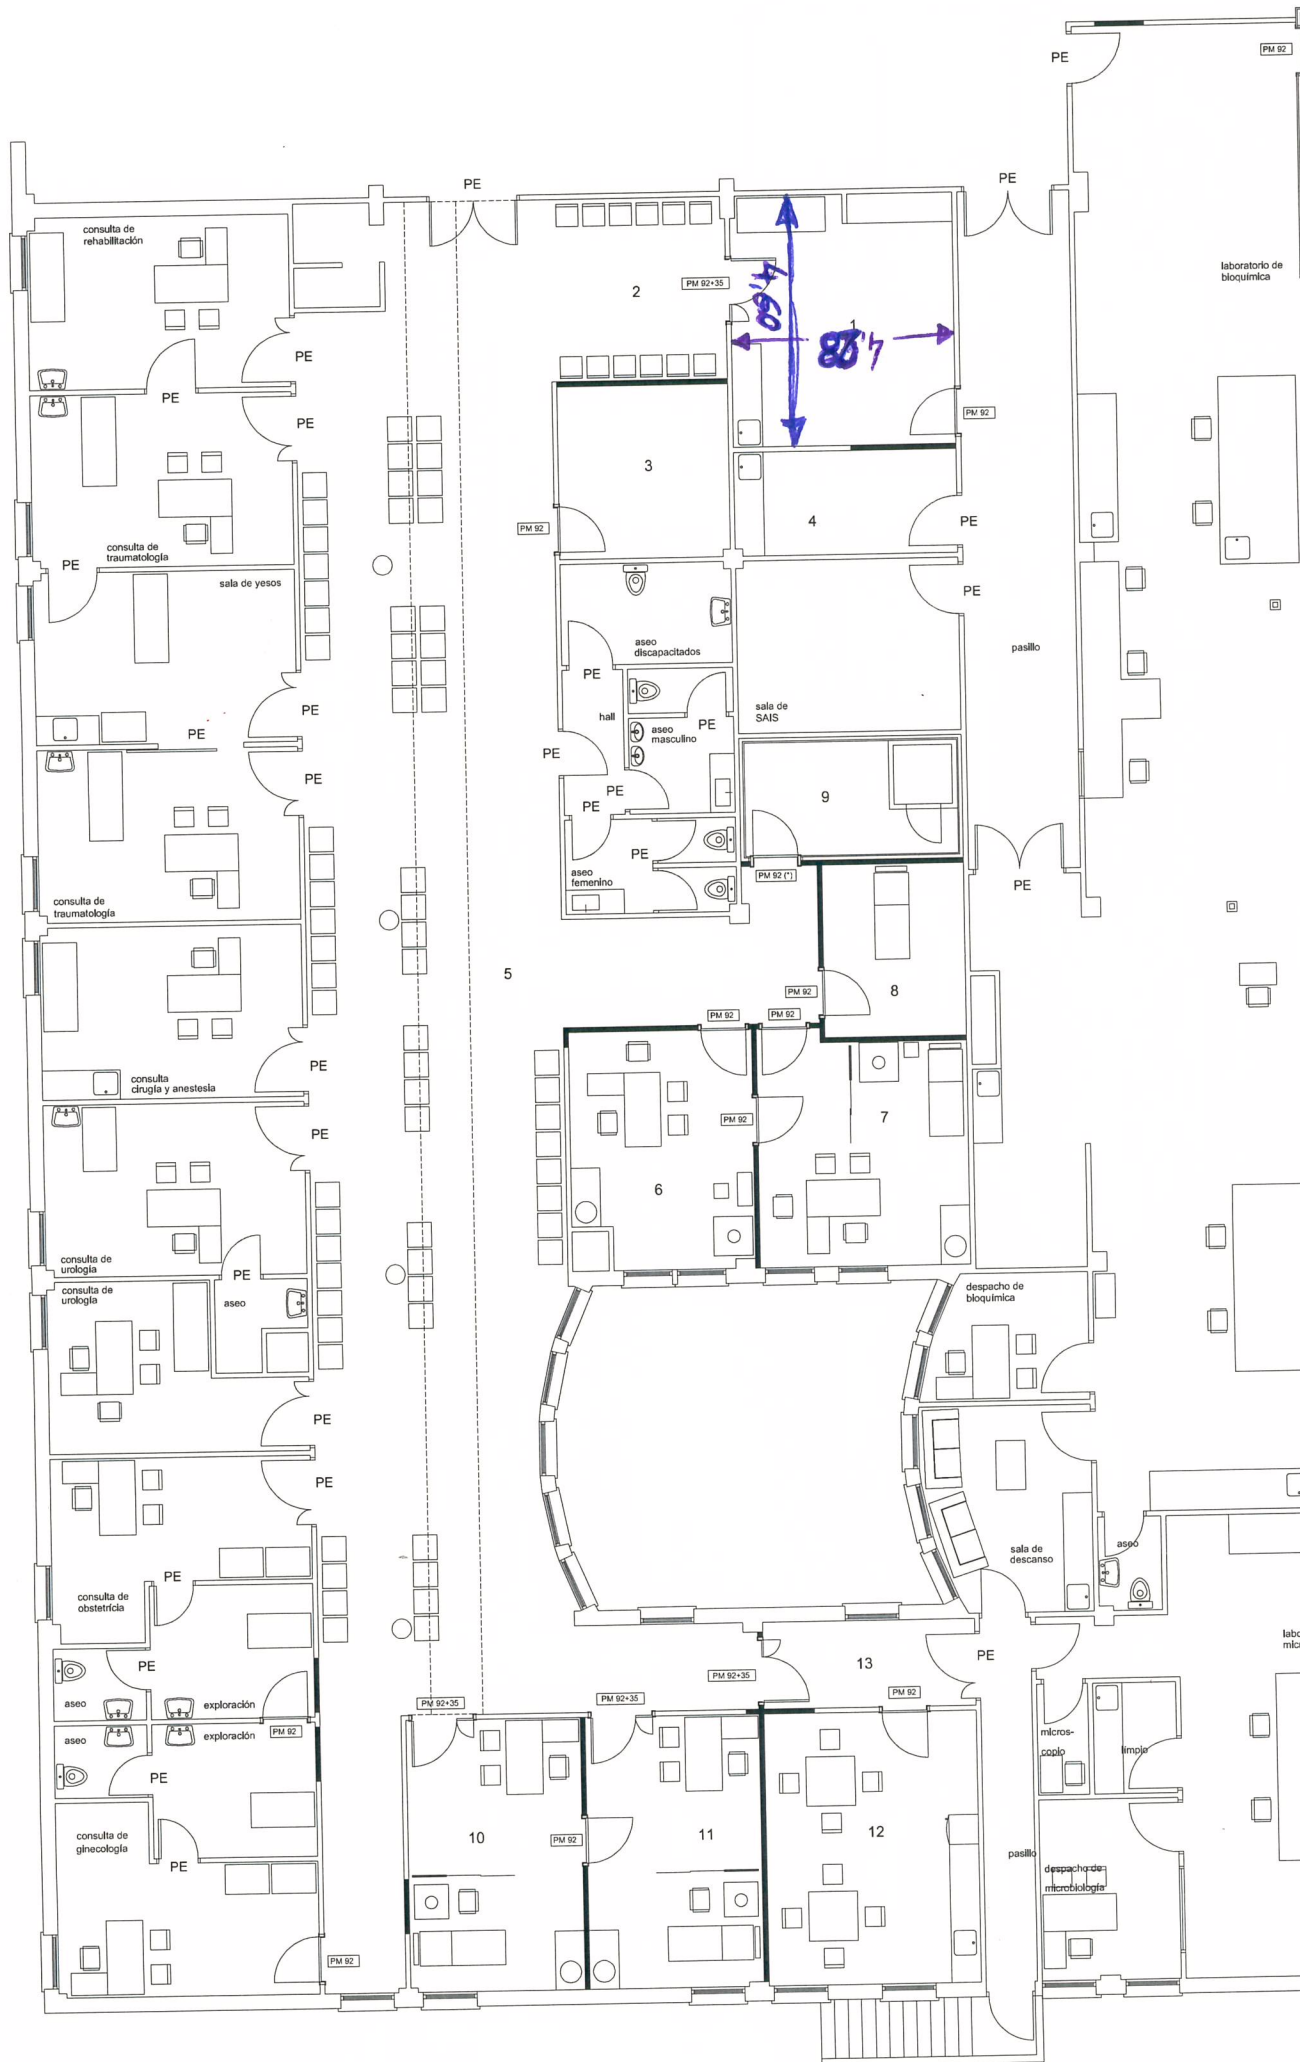

Manual de identidad gráfica

ANEXO



**SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS**

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Indicador direccional.

El elemento gráfico de señalización más universal es la flecha, que especifica la dirección a seguir para localizar un lugar determinado.

La flecha puede funcionar independientemente o incluida en otro rótulo de información, como indicador general de trayecto de paso.

Teniendo en cuenta que las posiciones son verticales, horizontales y oblicuas, es imprescindible la colocación correcta del elemento direccional dentro de la estructura de información.

En esta página se muestran las distintas configuraciones de las flechas según la dirección que indiquen.



Pantone 424




Arriba



Abajo



A la izquierda



A la derecha



A la izquierda y arriba



A la derecha y arriba



A la izquierda y abajo



A la derecha y abajo

Sistema de escritura.

La forma de la letra, la tipografía, es uno de los elementos que facilitan la lectura y comprensión de los textos en la señalización. Se contribuye así, de gran manera, a la comunicación a través de la escritura.

En señalizaciones es aconsejable el uso de una familia tipográfica con caracteres claros y poco complicados.

Para la elaboración del programa de señalización, hemos adoptado, por su trazado moderno, simple, funcional y, sobre todo, por su excepcional legibilidad, el carácter Gill Sans.

Se recomienda muy especialmente no abusar de letras en caja alta.

Gill Sans Bold.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ
O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q
r s t u v w x y z , . () ? ; " -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gill Sans Regular.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P
Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q
r s t u v w x y z , . () ? ; " -

**Señalización exterior.
Monolito (grande)
de 2 caras.**

Símbolo recortado en metacrilato blanco de 20 mm.; el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072.

Texto "Nombre del centro" recortado en metacrilato transparente de 15 mm.; frontal en vinilo blanco.

Texto "Gobierno del Principado de Asturias" recortado en metacrilato blanco de 8 mm.; frontal en vinilo gris pantone 424.

Rótulo nº **1-A**

Características técnicas:

Módulo luminoso con luz interior.

Estructura realizada con tubería y perfilera de acero laminado en diversas dimensiones con arreglo a las condiciones técnicas necesarias; unida mediante soldaduras de arco eléctrico y tratadas para protegerlas de posibles oxidaciones.

Módulo 1, opaco.

Revestimiento exterior de aluminio extrusionado, unido mediante soldadura de arco eléctrico. Pintado en plata mate.


Módulo 2, luminoso.

Revestimiento exterior de aluminio extrusionado, unido mediante soldadura de arco eléctrico. Pintado en plata mate. Frontal de metacrilato transparente de 5 mm. y pintado en pantone 072.

Tratamiento antioxidante por recubrimiento electrolítico de zinc, desengrasado, aplicación de una mano de imprimación, una mano de aparejo y dos manos de acabado de pintura realizadas en cabina-horno.

Fijación sobre el terreno con zapatas de hormigón y anclajes metálicos.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

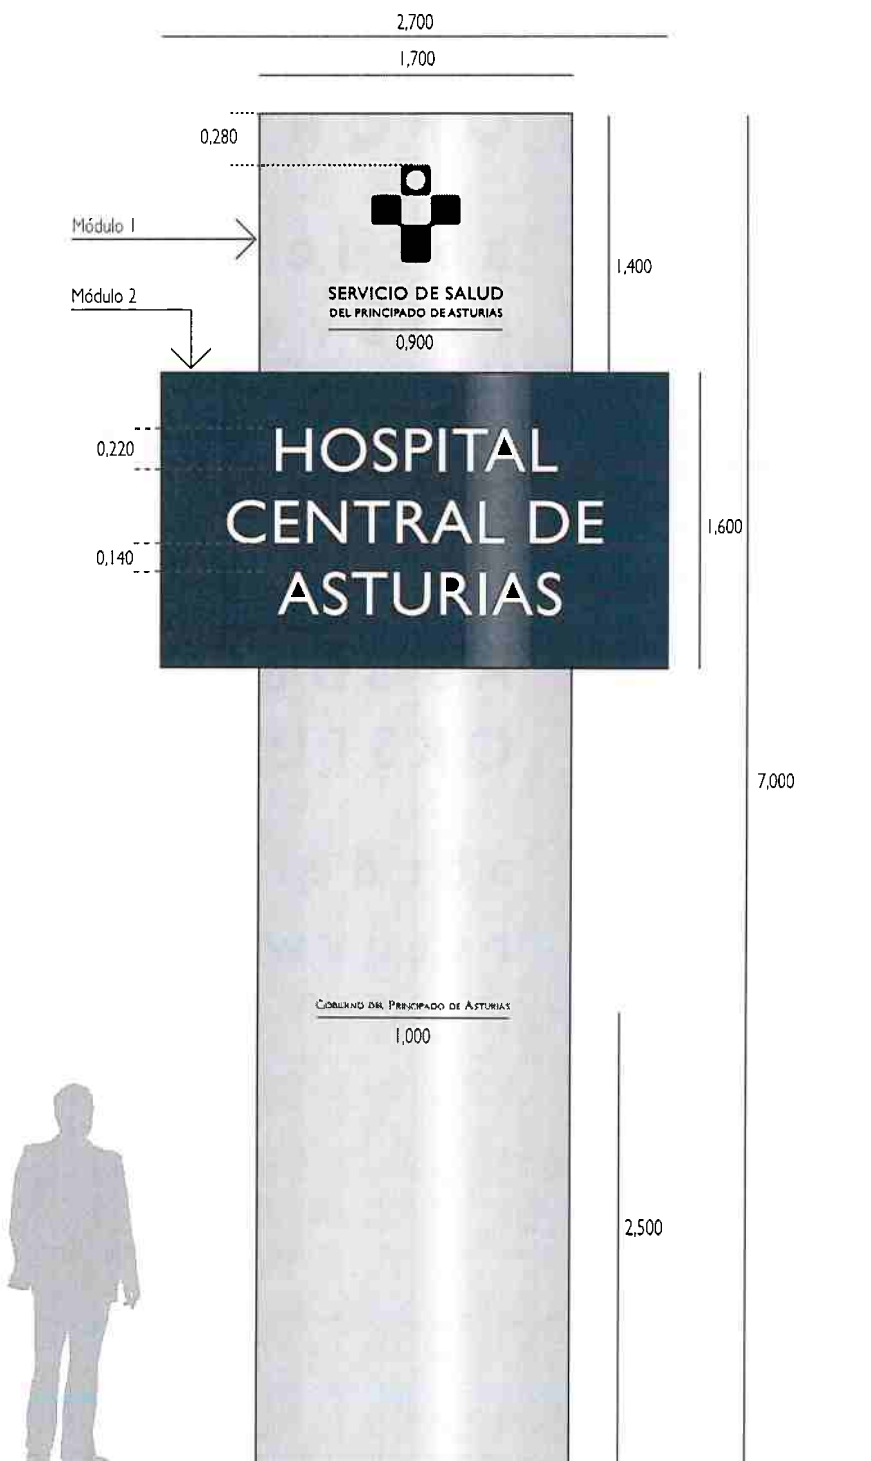

Acotaciones en metros.

**Señalización exterior.
Monolito (grande)
de 2 caras.**


Iluminación módulo 2:

Interior mediante tubos
fluorescentes, utilizando los
necesarios para conseguir una
iluminación uniforme:

12 proyectores (6 por cada lado,
3 en la parte superior y 3 en la
inferior) para, por medio de
barridos, iluminar la imagen del
"Servicio de Salud del Principado
de Asturias" y el texto "Gobierno
del Principado de Asturias".

Rótulo nº


1-B

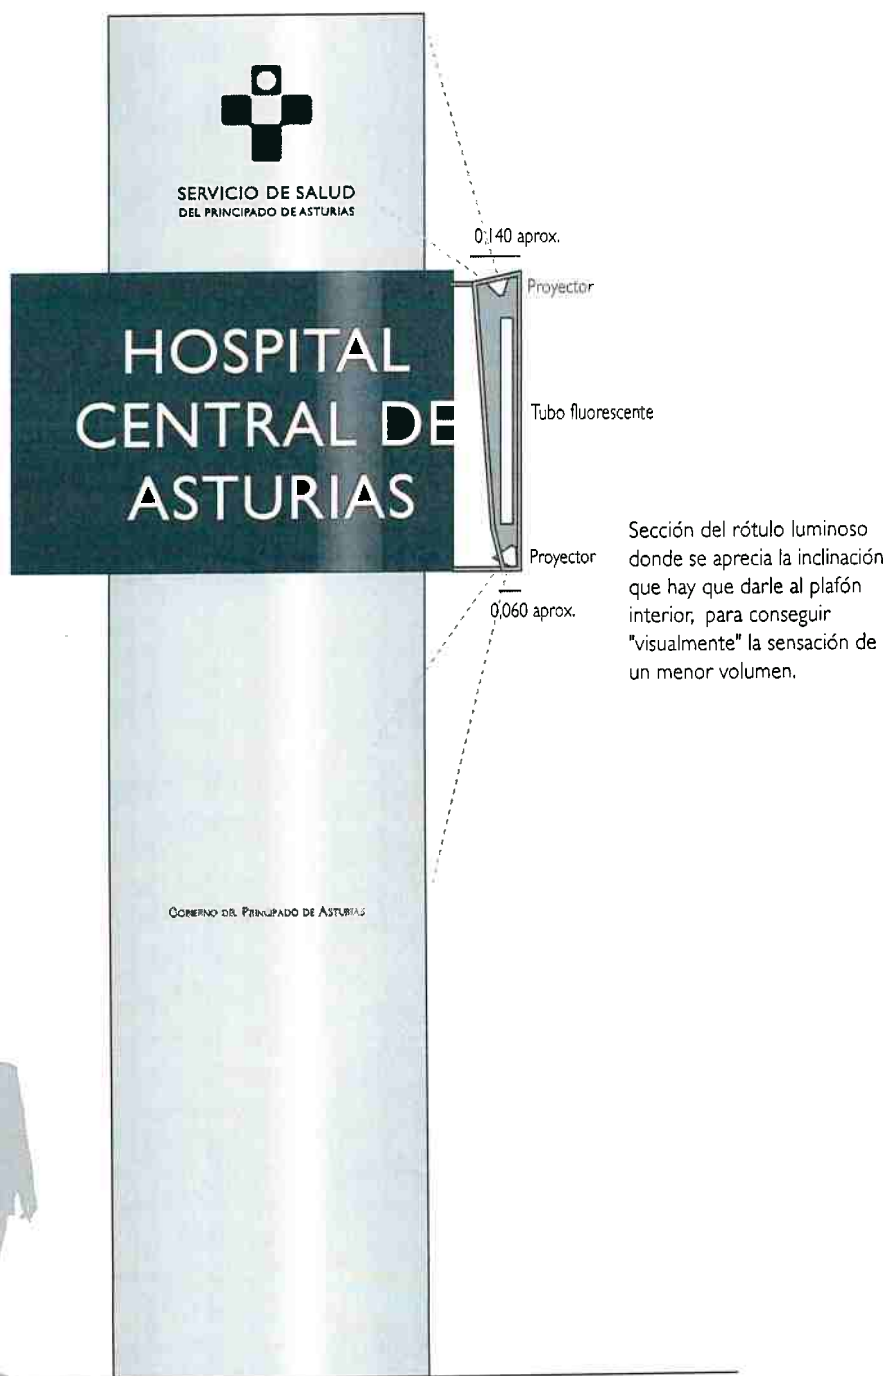

**Señalización exterior.
Monolito (grande)
de 2 caras.**

Vista lateral.

Rótulo nº **1-C**

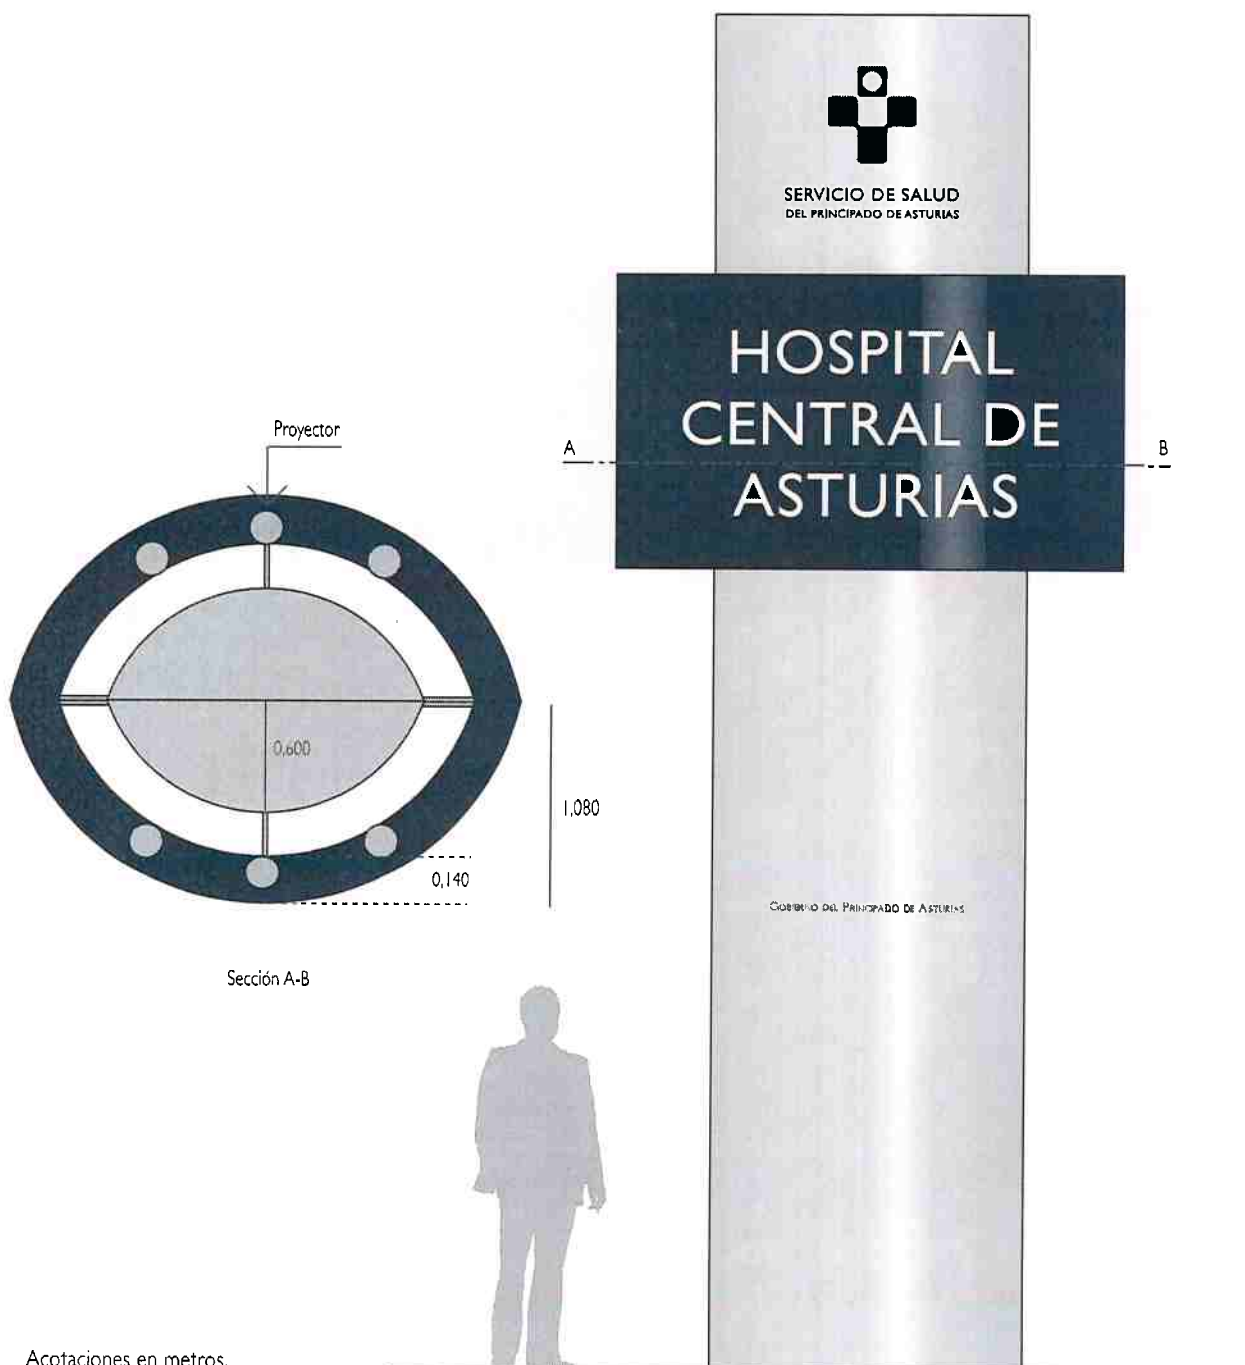

Acotaciones en metros.

**Señalización exterior.
Monolito (pequeño)
de 2 caras.**

Símbolo recortado en metacrilato blanco de 10 mm.; el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072.

Texto "Nombre de la actividad" recortado en metacrilato transparente de 15 mm.; frontal en vinilo blanco.

Texto "Gobierno del Principado de Asturias" recortado en metacrilato blanco de 4 mm.; frontal en vinilo gris pantone 424.

Texto "Nombre del centro" calado sobre el fondo azul.

Rótulo nº **2-A**

Características técnicas:

Módulo luminoso con luz interior:

Estructura realizada con tubería y perfilera de acero laminado en diversas dimensiones con arreglo a las condiciones técnicas necesarias; unida mediante soldaduras de arco eléctrico y tratadas para protegerlas de posibles oxidaciones.

Módulo 1, opaco.

Revestimiento exterior de aluminio extrusionado, unido mediante soldadura de arco eléctrico. Pintado en plata mate.


Módulo 2, luminoso.

Revestimiento exterior de aluminio extrusionado, unido mediante soldadura de arco eléctrico. Pintado en plata mate. Frontal de metacrilato transparente de 5 mm. y pintado en pantone 072.

Tratamiento antioxidante por recubrimiento electrolítico de zinc, desengrasado, aplicación de una mano de imprimación, una mano de aparejo y dos manos de acabado de pintura realizadas en cabina-horno.

Fijación sobre el terreno con zapatas de hormigón y anclajes metálicos.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

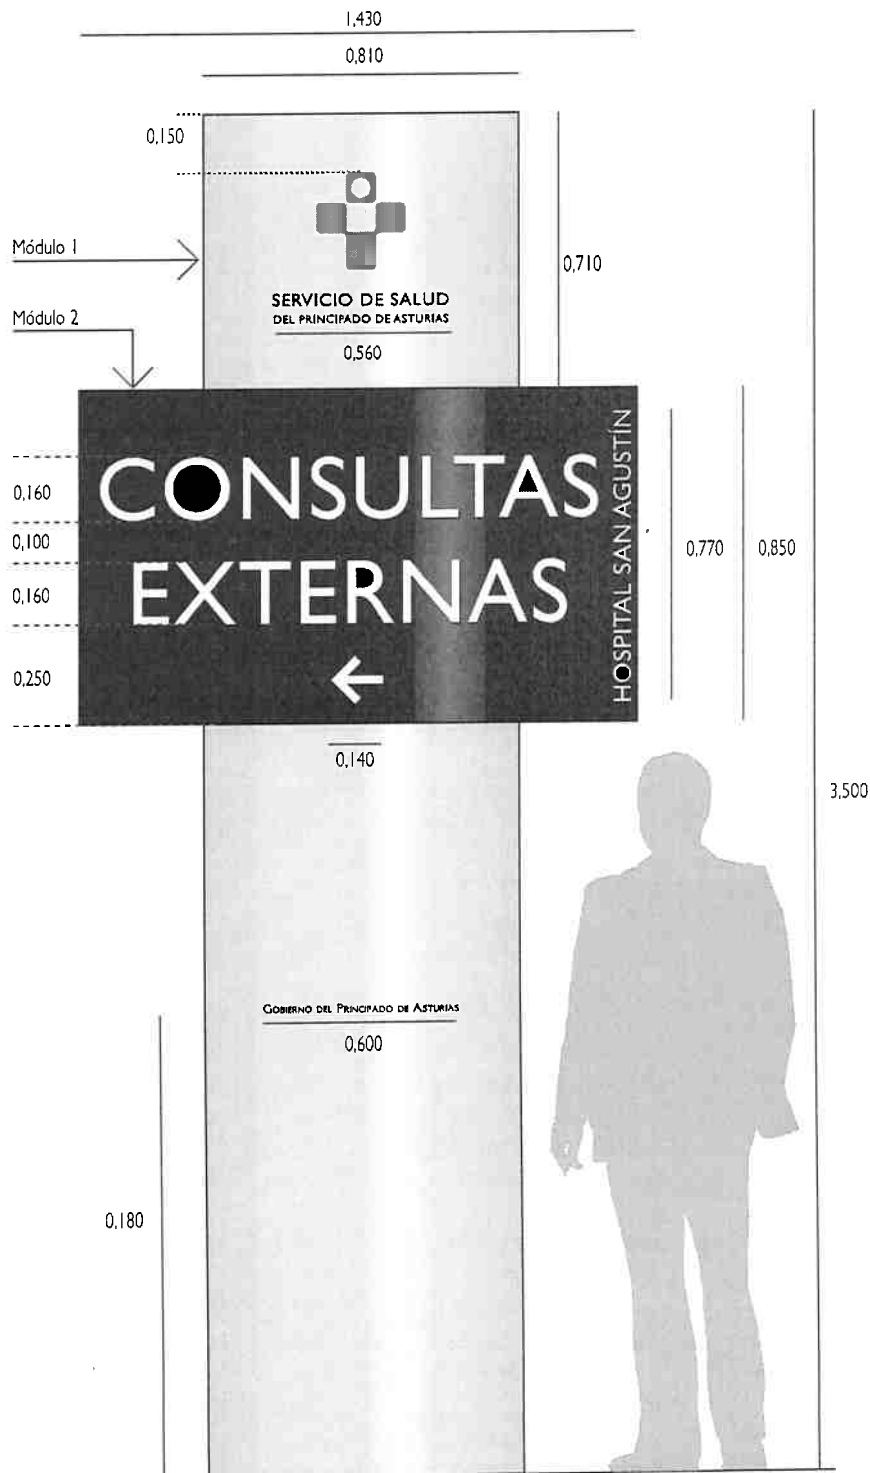

Acotaciones en metros.

**Señalización exterior.
Monolito (pequeño)
de 2 caras.**


Iluminación módulo 2:

Interior mediante tubos
fluorescentes, utilizando los
necesarios para conseguir una
iluminación uniforme:

12 proyectores (6 por cada lado,
3 en la parte superior y 3 en la
inferior) para, por medio de
barridos, iluminar la imagen del
"Servicio de Salud del Principado
de Asturias" y el texto "Gobierno
del Principado de Asturias".

Rótulo nº **2-B**

Sección del rótulo luminoso
donde se aprecia la inclinación
que hay que darle al plafón
interior para conseguir
"visualmente" la sensación de
un menor volumen.

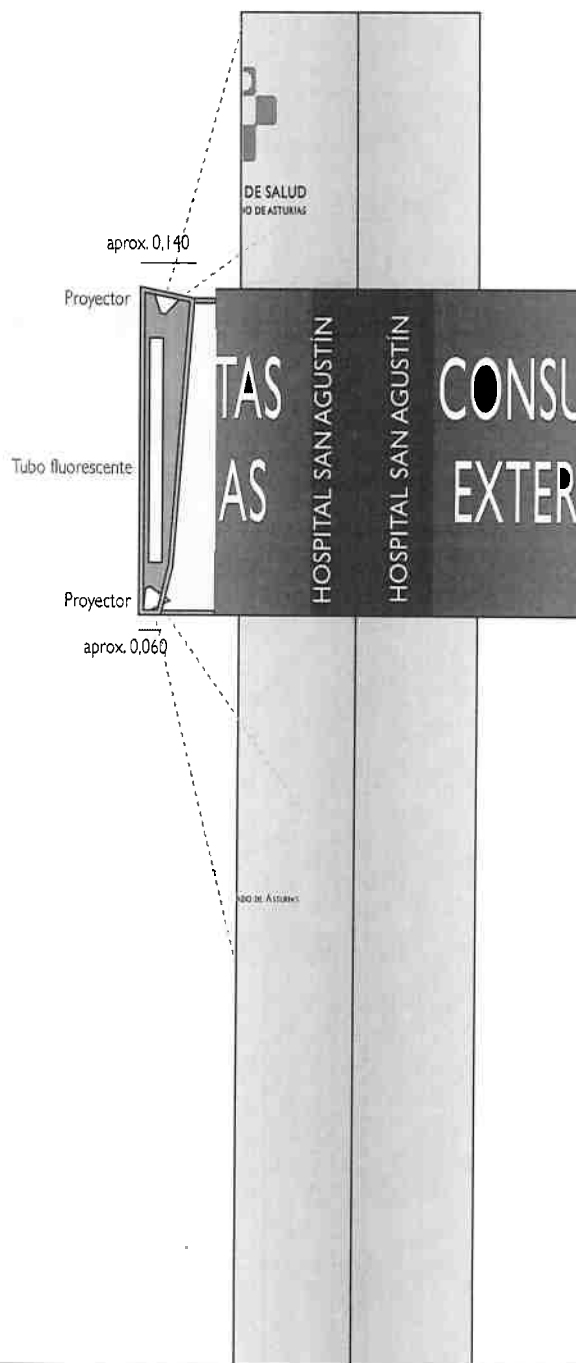



Acotaciones en metros.

**Señalización exterior.
Monolito (pequeño)
de 2 caras.**

Vista lateral.

Rótulo nº **2-C**

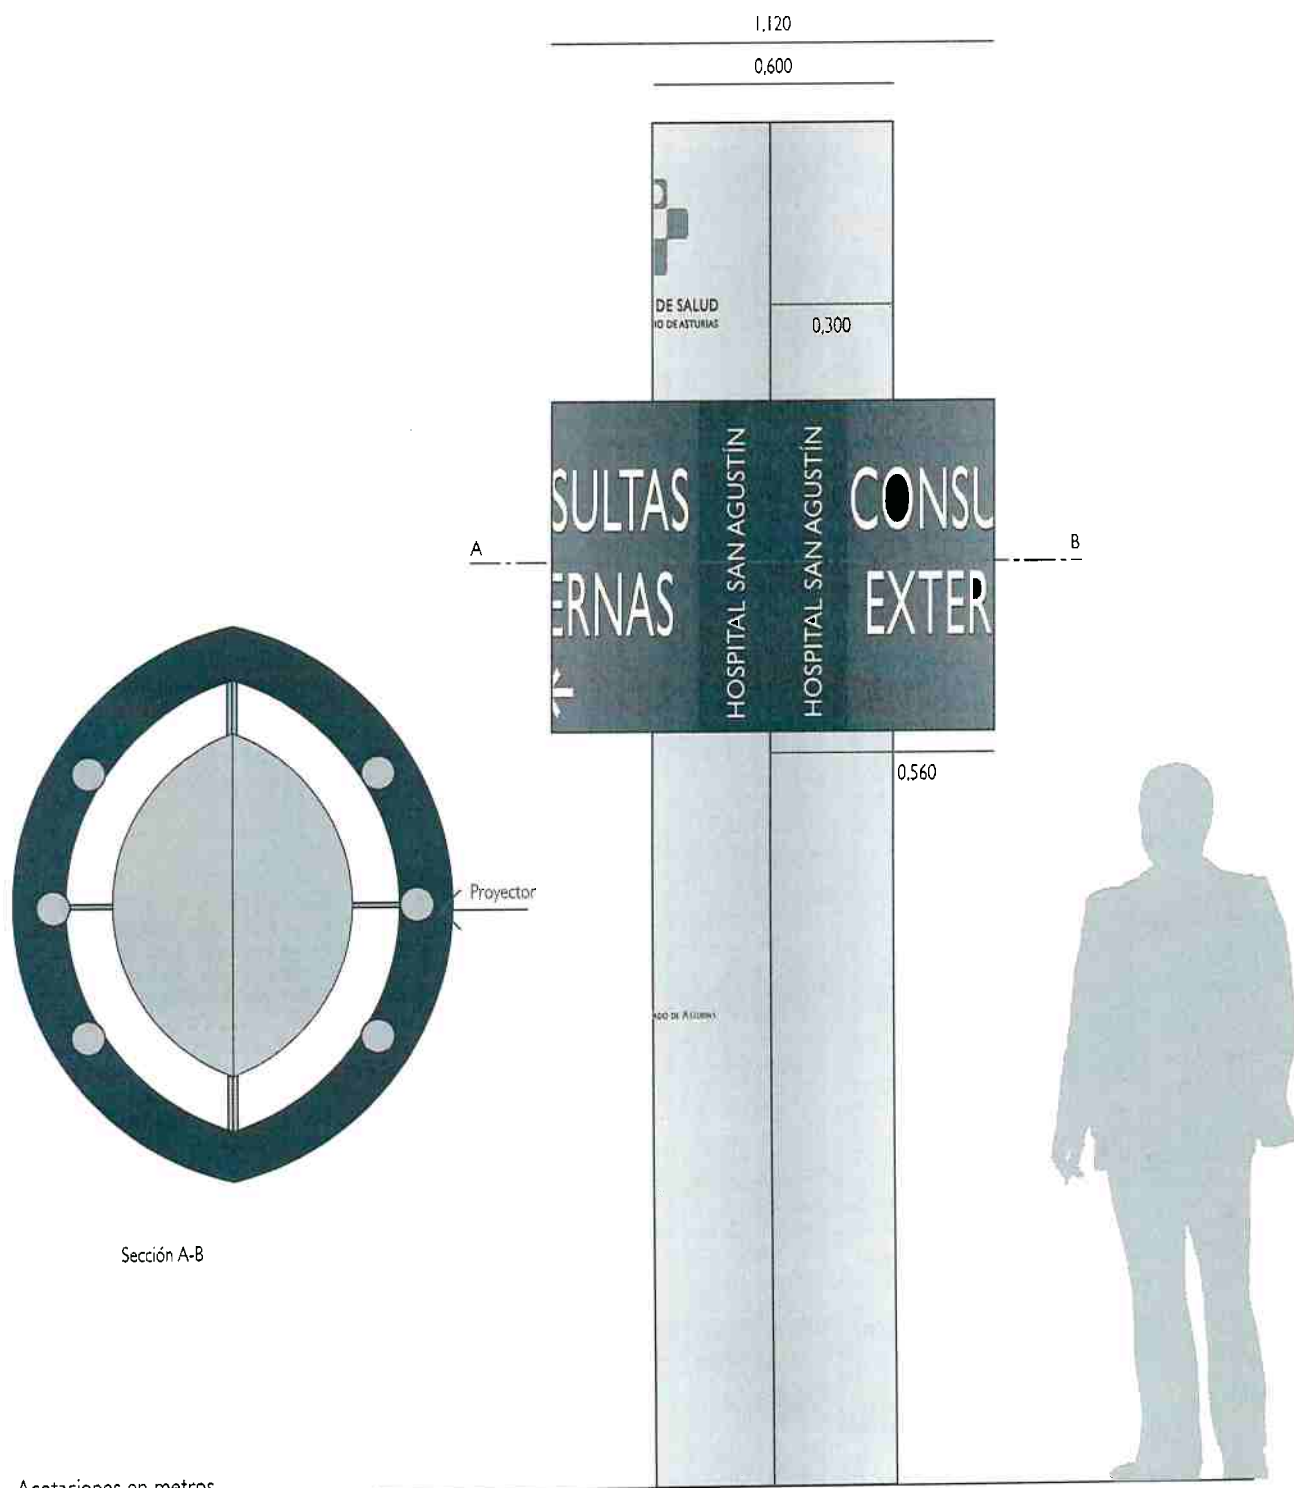

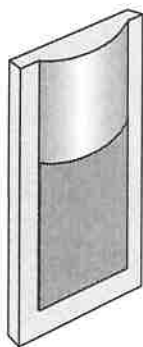

Señalización de Centros de Salud y Áreas Sanitarias.

Modelo complementario.

Rótulo formado por dos elementos:

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasermat exteriores, LM 922-382 China


blue/white) o similar para la rotulación del servicio correspondiente.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.


Esta señal puede estar iluminada exteriormente por medio de focos.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

Rótulo nº **3-A**

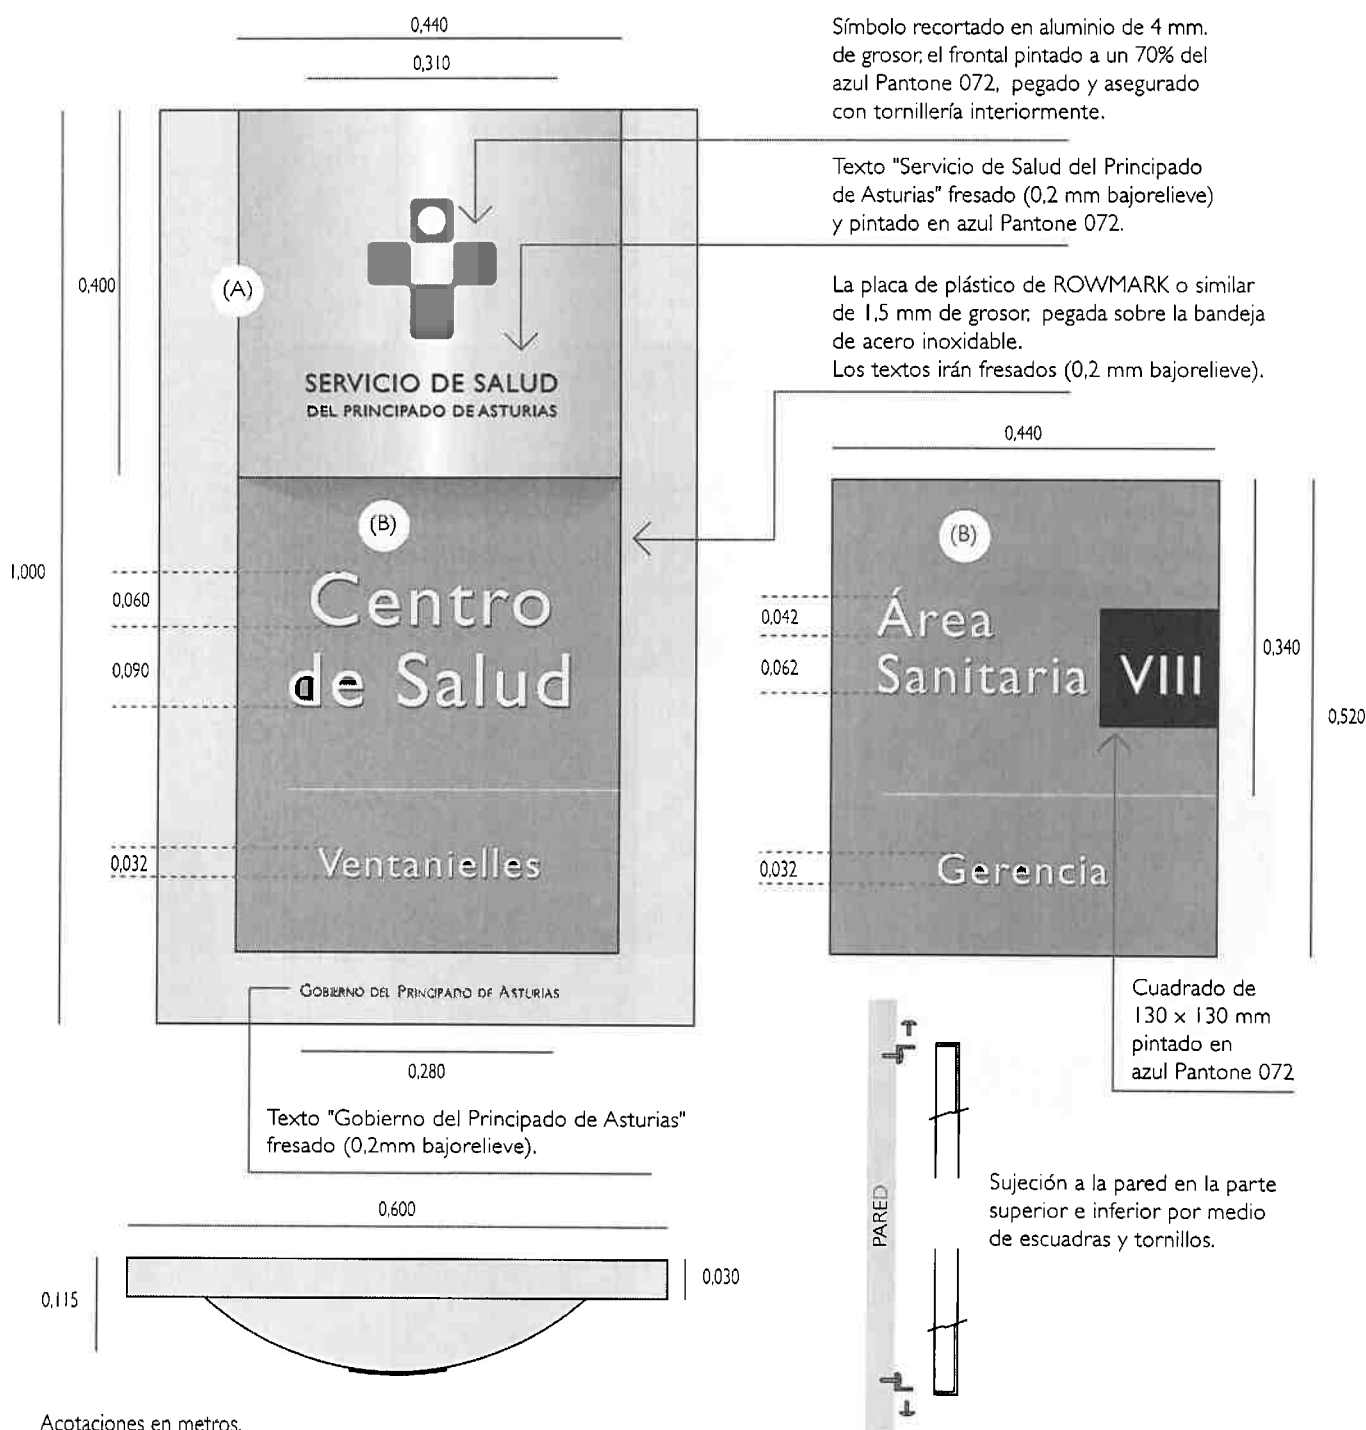

Acotaciones en metros.

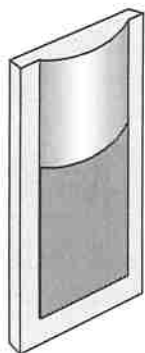

Señalización de Consultorios Periféricos y Locales.

Modelo complementario.

Rótulo formado por dos elementos:

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasermark exteriores, LM 922-382 China


blue/white) o similar para la rotulación del servicio correspondiente.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Esta señal puede estar iluminada exteriormente por medio de focos.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

Rótulo nº 4-A

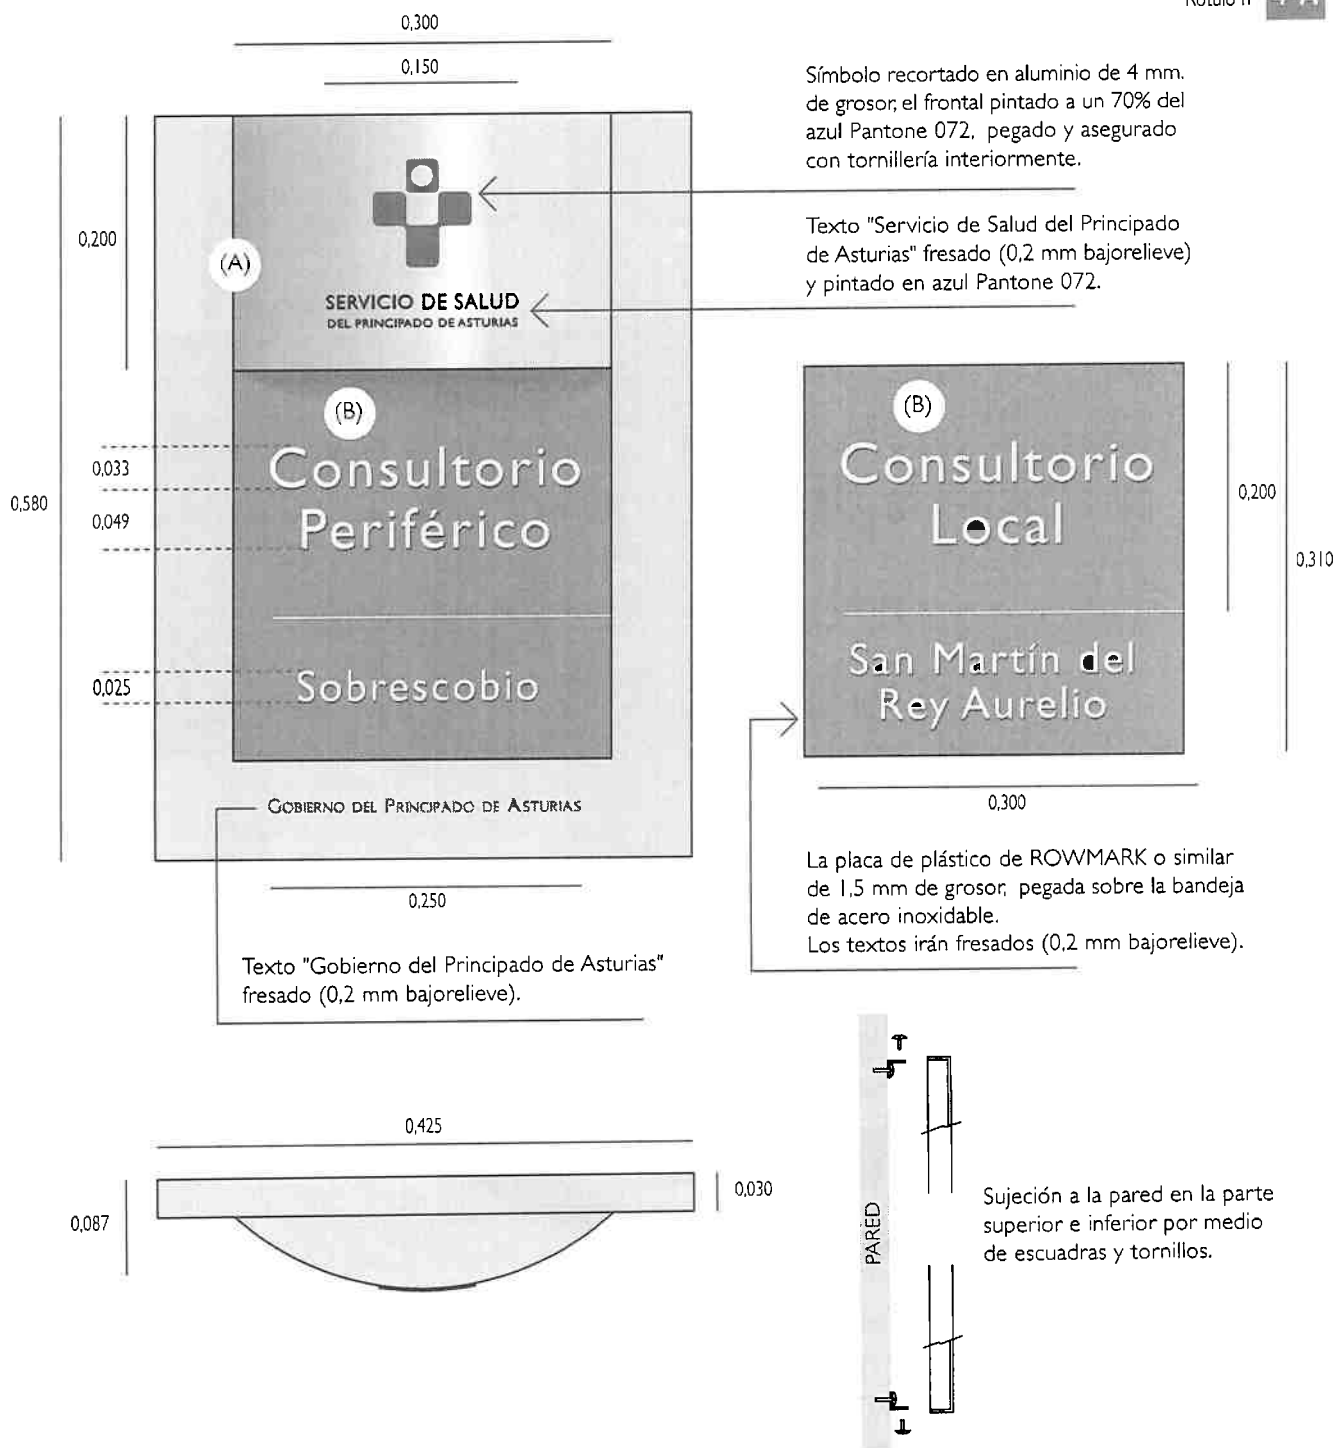

Acotaciones en metros.

Señalización exterior.

Módulo luminoso con luz interior, que se colocará en la pared. Tendrá las mismas características técnicas de fabricación y la misma iluminación que los rótulos números 1 y 2.

Símbolo recortado en metacrilato blanco de 15 mm.; frontal pintado a un 70% de azul pantone 072.

Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" en vinilo azul Pantone 072.

Texto "Gobierno del Principado de Asturias" recortado en vinilo gris Pantone 424.

Texto "Nombre del centro" recortado en metacrilato transparente de 15 mm.; frontal en vinilo blanco.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

Rótulo nº **5-A**



Acotaciones en metros.

Señalización exterior con directorio.

Módulo luminoso con luz interior, que se colocará en la pared. Tendrá las mismas características técnicas de fabricación y la misma iluminación que los rótulos números 1 y 2.

Símbolo recortado en metacrilato blanco de 15 mm. y el frontal pintado a un 70% de azul Pantone 072.


Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" en vinilo azul Pantone 072.

Texto "Gobierno del Principado de Asturias" recortado en vinilo gris Pantone 424.

Texto "Nombre del centro" recortado en metacrilato transparente de 15 mm. el frontal en vinilo blanco.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

Rótulo nº **5-B**

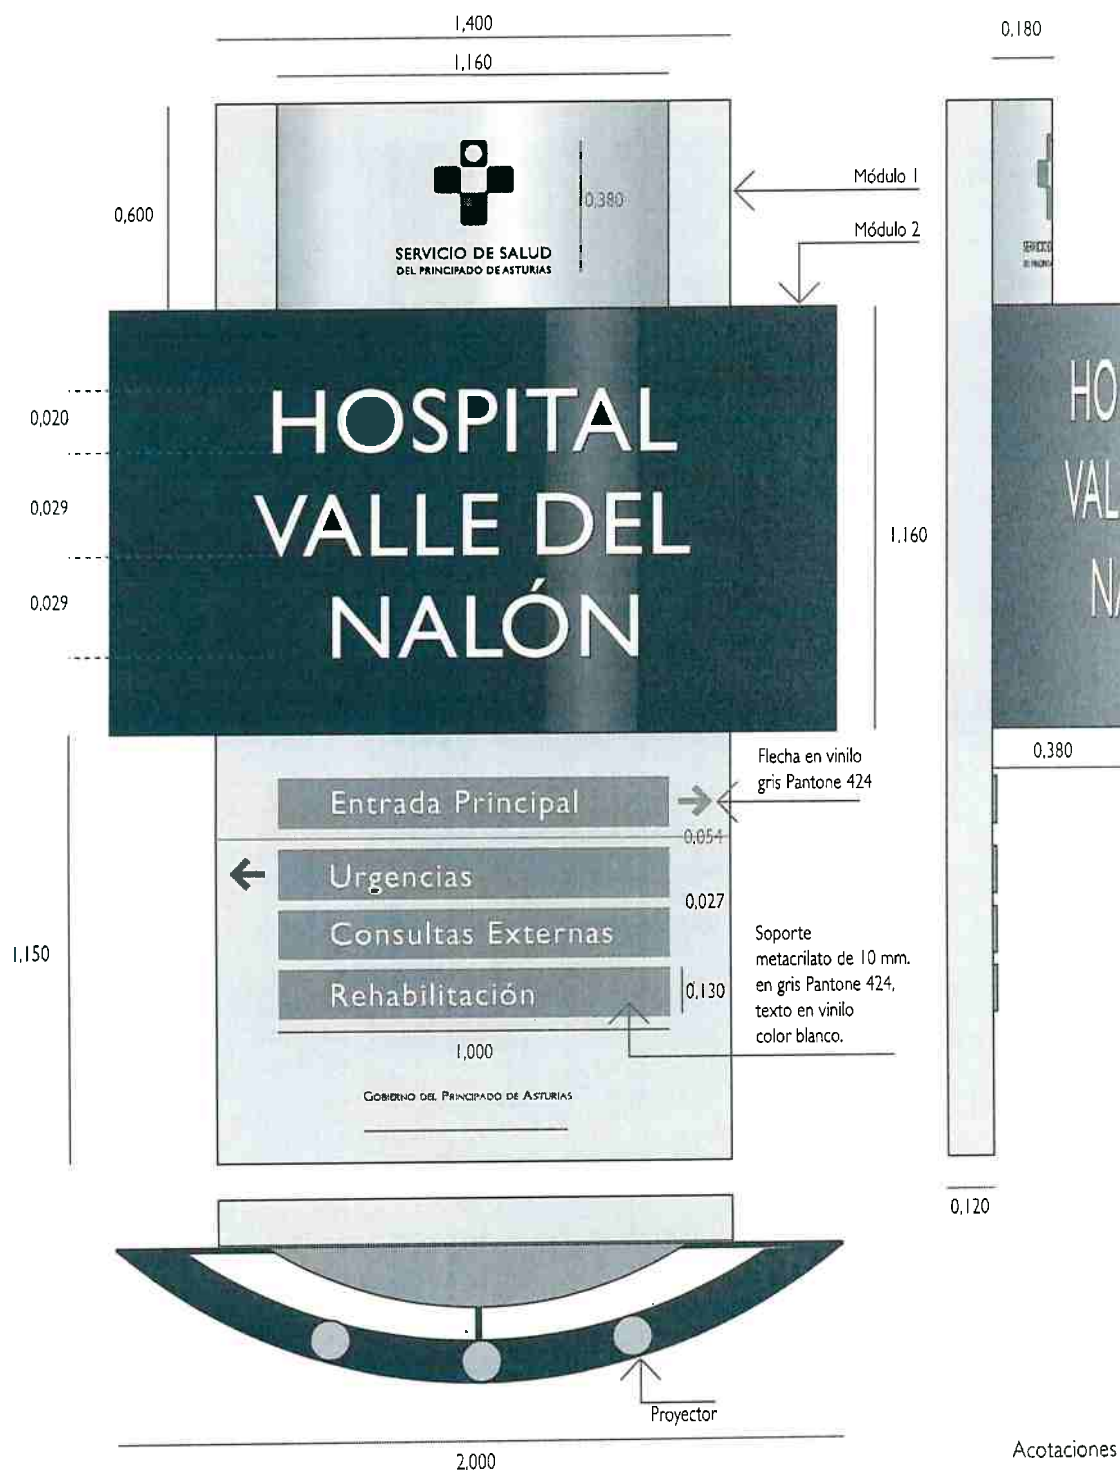

Señalización exterior.

Ubicación de centros.

Esta señalización servirá para localizar el acceso a cada centro y mostrar la situación dentro del complejo hospitalario.

Rótulo formado por dos elementos:

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad

gráfica del "Servicio de Salud del

Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Superficie formada por placas independientes "Slatz de Spandex" o similar, fácilmente intercambiables.

Símbolo recortado en aluminio de 4 mm.; frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072.

Textos "Servicio de Salud del Principado de Asturias" en vinilo azul Pantone 072 y "Gobierno del Principado de Asturias" en vinilo gris Pantone 424.

Plano de los edificios, flechas y pictogramas en vinilo.

Rótulo nº **6-A**


Para la composición de los textos se utilizará Gill Sans regular. Condensada al 90%.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

LA ALTURA TOTAL DEPENDERÁ DE LAS PLACAS INDEPENDIENTES QUE LA COMPONGAN

Azul Pantone 072, número en vinilo color blanco.

Gris Pantone 424, texto en vinilo color blanco.


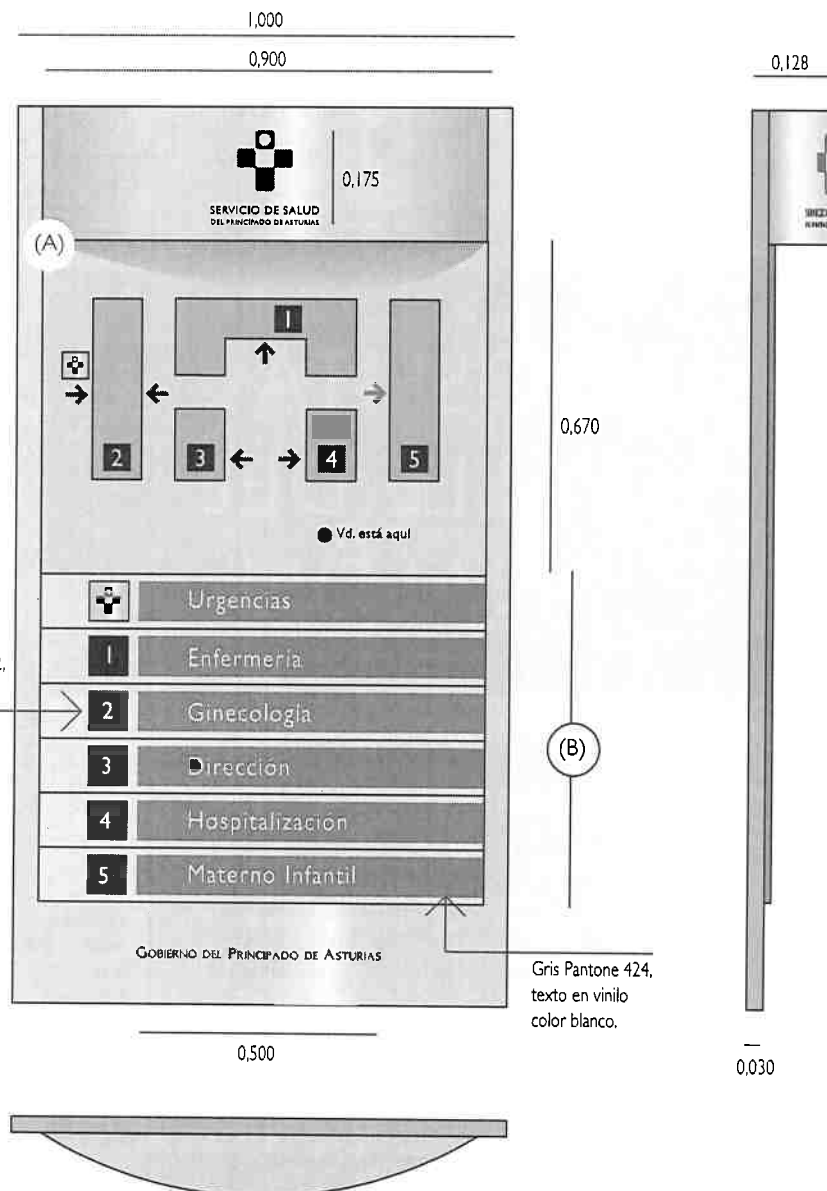


Acotaciones en metros.

Señalización exterior.

Se situará en lugar estratégico, directamente sobre la pared, en muros de cierre o en soportes propios sobre el suelo.

Rótulo nº **6-B**

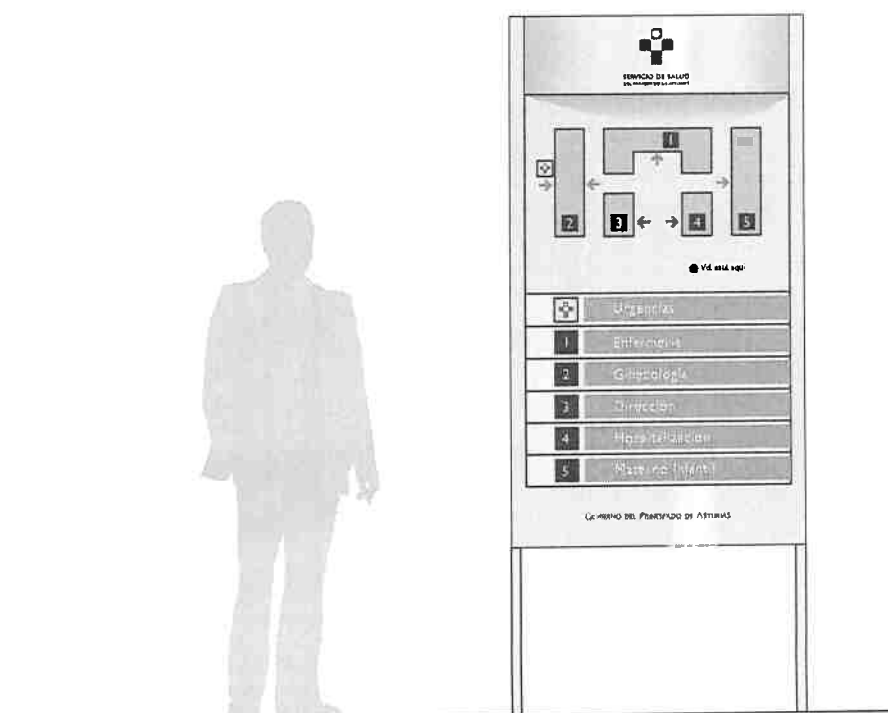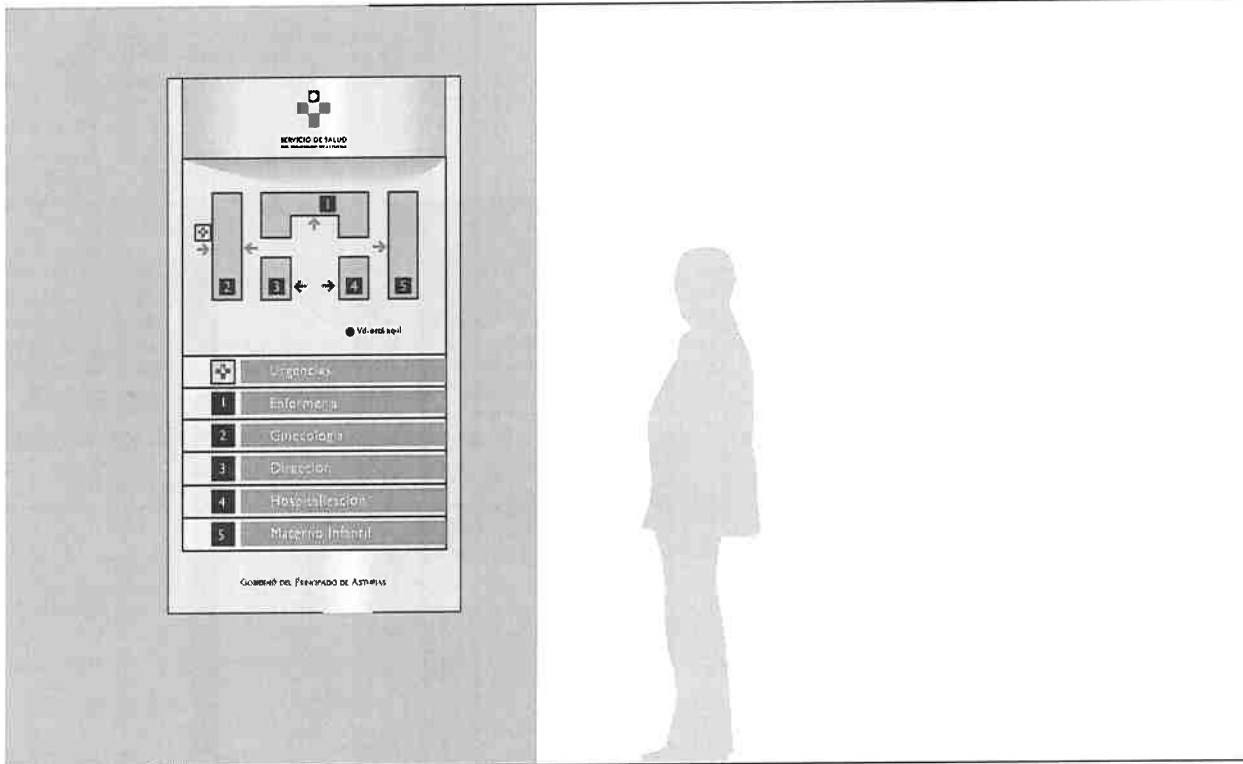

Señalización interior.

Directorio vertical.

Se situará en vestíbulos de entrada de edificios, en vestíbulos de planta, en pasillos, cerca de los ascensores o en cualquier zona de tránsito.

Rótulo formado por dos elementos:

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor)


complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Superficie formada por placas de "Slatz de Spandex" o similar fácilmente intercambiables.

En algunos casos, al igual que los directorios de exterior, se pueden incorporar planos que ayuden en la búsqueda de los departamentos o servicios.

Para la composición de los textos se utilizará Gill Sans regular. Condensada al 90%.

Rótulo nº **7-A**

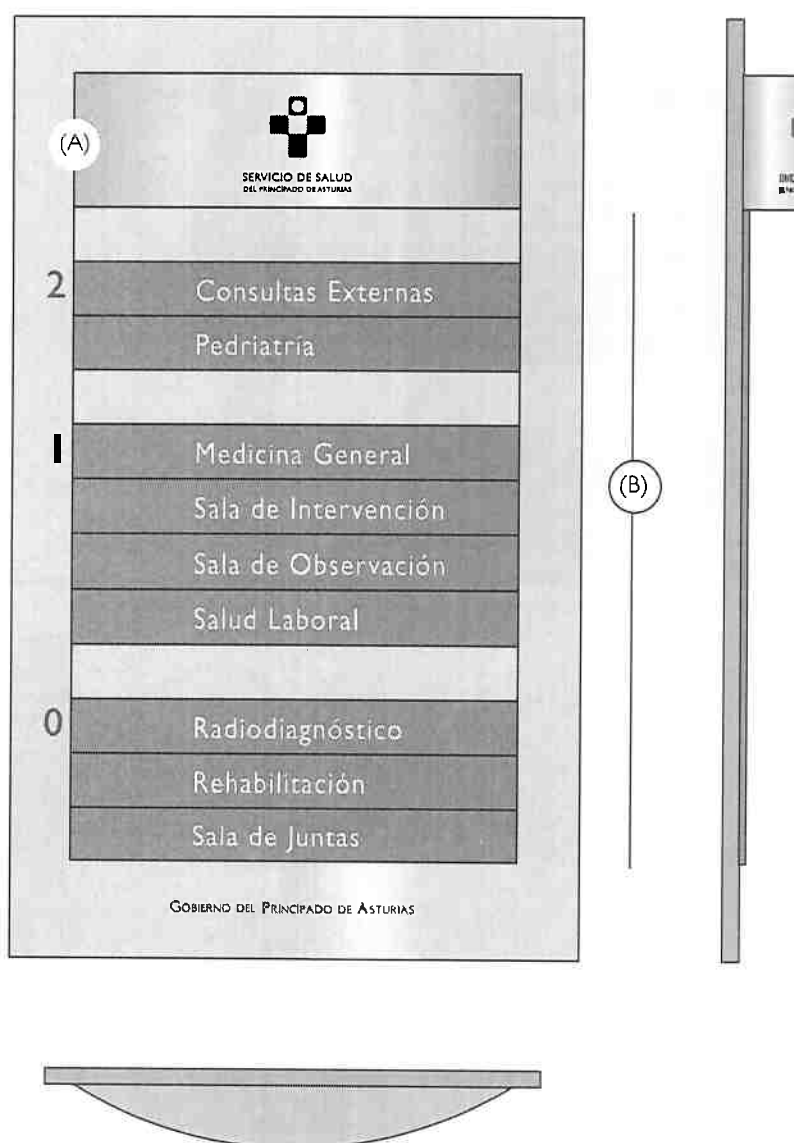

Directorio horizontal.

La altura de la señalización estará en función de la cantidad de placas que la formen.

```

graph TD
    Start((● 0 Vd. está aquí)) --> C1[1]
    Start --> C2[2]
    Start --> C3[3]
    C1 --> CE[Consultas Externas]
    C1 --> P[Pediatría]
    C1 --> MG[Medicina General]
    C1 --> SI[Sala de Intervención]
    C1 --> SO[Sala de Observación]
    C1 --> SL[Salud Laboral]
    C2 --> SPS[SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS]
    C3 --> Empty[ ]
  
```

Señalización interior.

Ejemplo de directorio general para dos edificios comunicados entre sí.


Soporte de bandeja de aluminio y placas independientes "Slatz de Spandex", o similar de una altura de 61,5 mm. (útil 58 mm.) con los nombres de los servicios rotulados con vinilo.

Símbolo recortado en metacrilato blanco de 5 mm.; frontal pintado a un 70 % de azul Pantone 072.

Textos "Servicio de Salud del Principado de Asturias" en vinilo azul Pantone 072 y "Gobierno del Principado de Asturias" en vinilo gris pantone 424.

Para la composición de los textos se utilizará Gill Sans regular, condensada al 90%.

Rótulo nº **7-C**

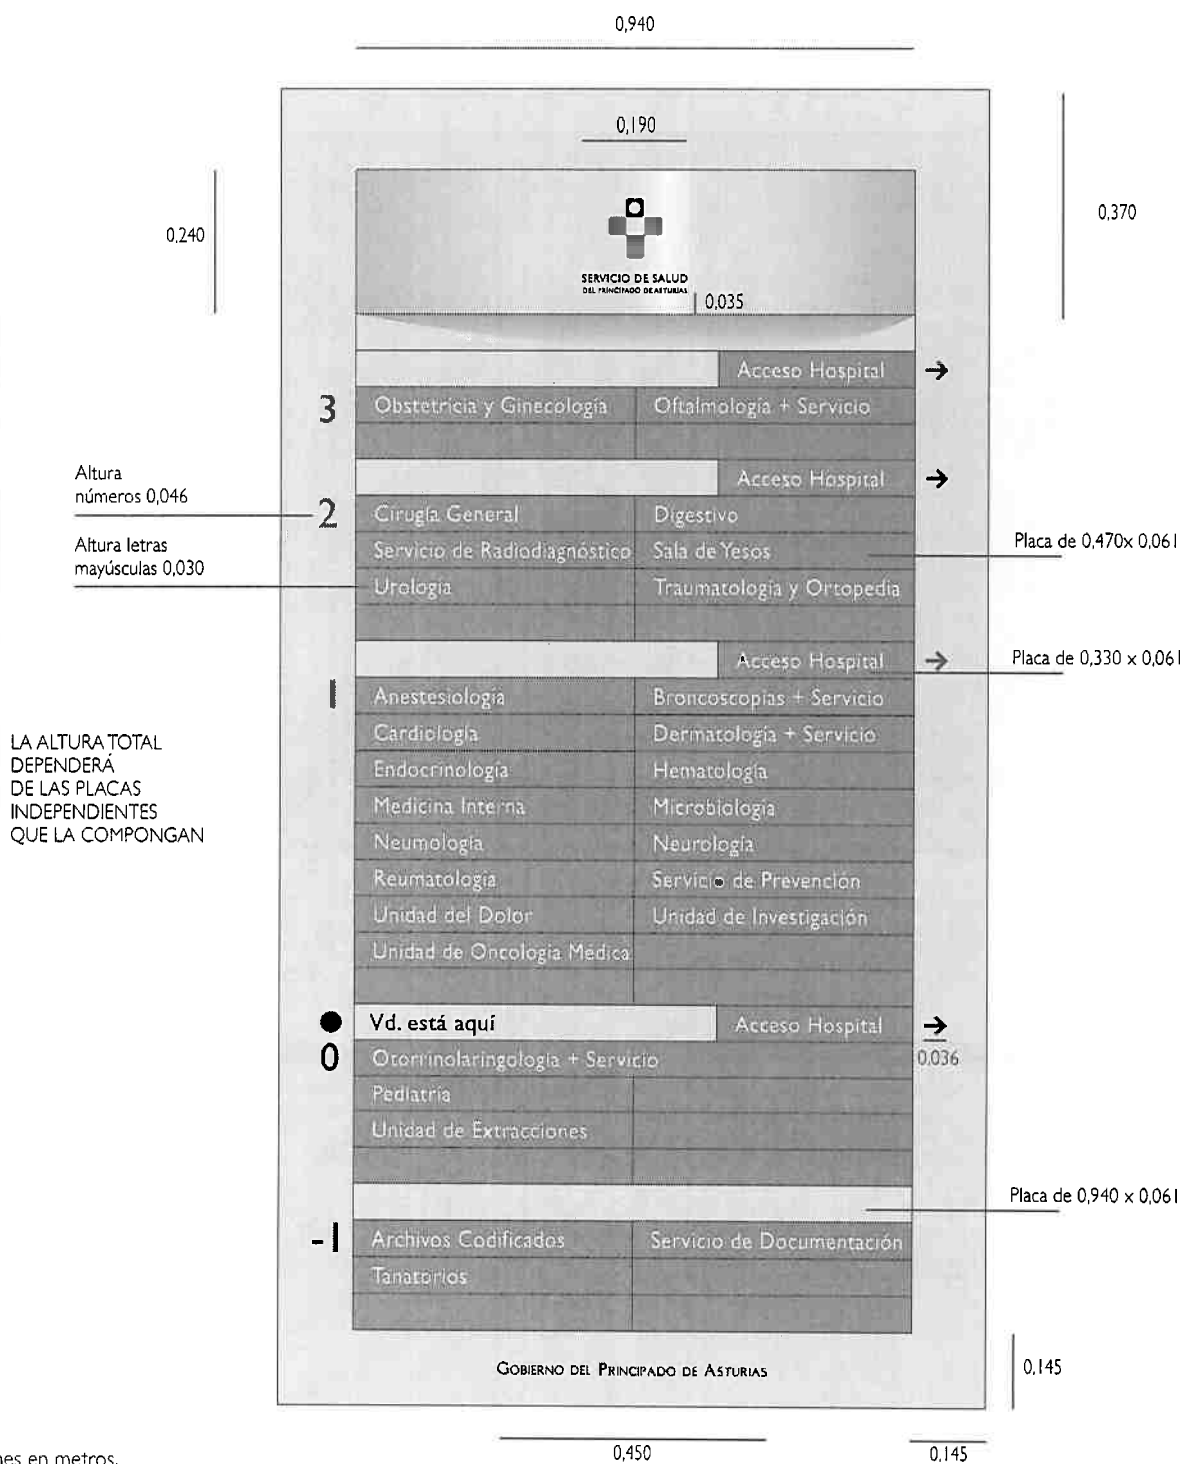

Señalización interior.

Ejemplo de directorio general para dos edificios comunicados entre sí.

Soporte de bandeja de aluminio y placas independientes "Slatz de Spandex", o similar, de 340 x 50 mm. con los nombres de los servicios rotulados con vinilo.


Símbolo recortado en metacrilato blanco de 5 mm.; frontal pintado a un 70 % de azul Pantone 072.

Textos "Servicio de Salud del Principado de Asturias" en vinilo azul pantone 072 y "Gobierno del Principado de Asturias" en vinilo gris pantone 424.

Para la composición de los textos se utilizará Gill Sans regular; condensada al 90%.

Rótulo nº **7-D**

1,020

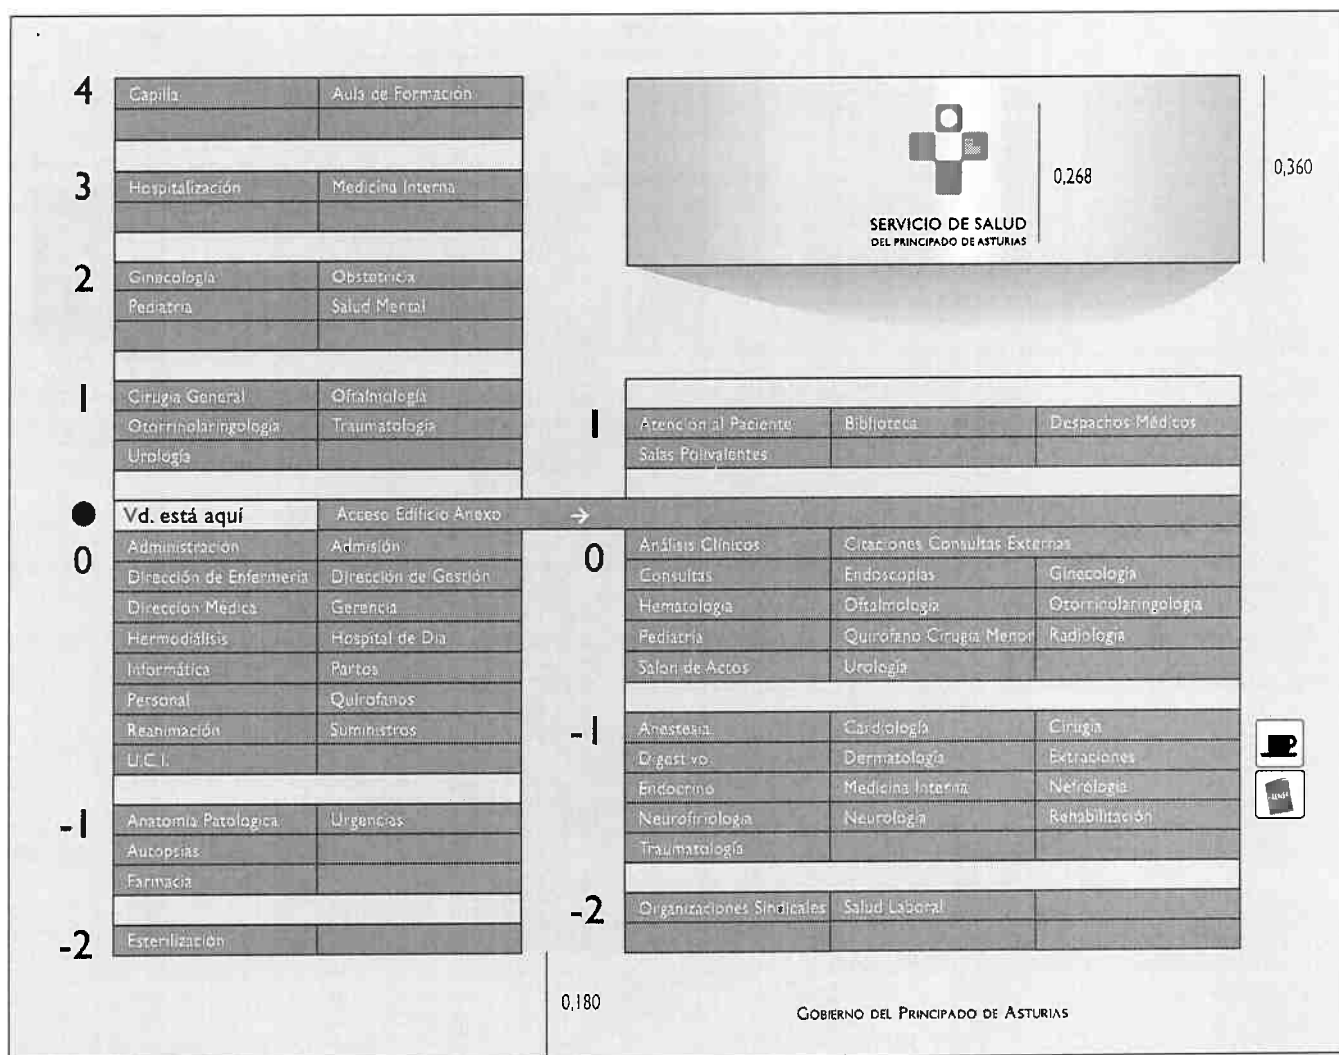

0,180

0,520

0,180

Para la composición de los textos se utilizará Gill Sans regular. Cuerpo 90. Condensada al 90%. Interletraje 3.

Señalización interior.

Ejemplo de directorio general.
Información de los servicios en las plantas.


Soporte de bandeja de aluminio y placas independientes modelo "Slatz Medio de Spandex" o similar; de una altura de 61,5 mm. (útil 58 mm.) con los nombres de los servicios rotulados con vinilo.

Símbolo en metacrilato blanco 5 mm.; frontal pintado a un 70 % de azul Pantone 072.

Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" y "Gobierno del Principado de Asturias" en vinilo gris Pantone 424.

Para la composición de los textos se utilizará Gill Sans regular. Condensada al 90%.

Rótulo nº **7-E**

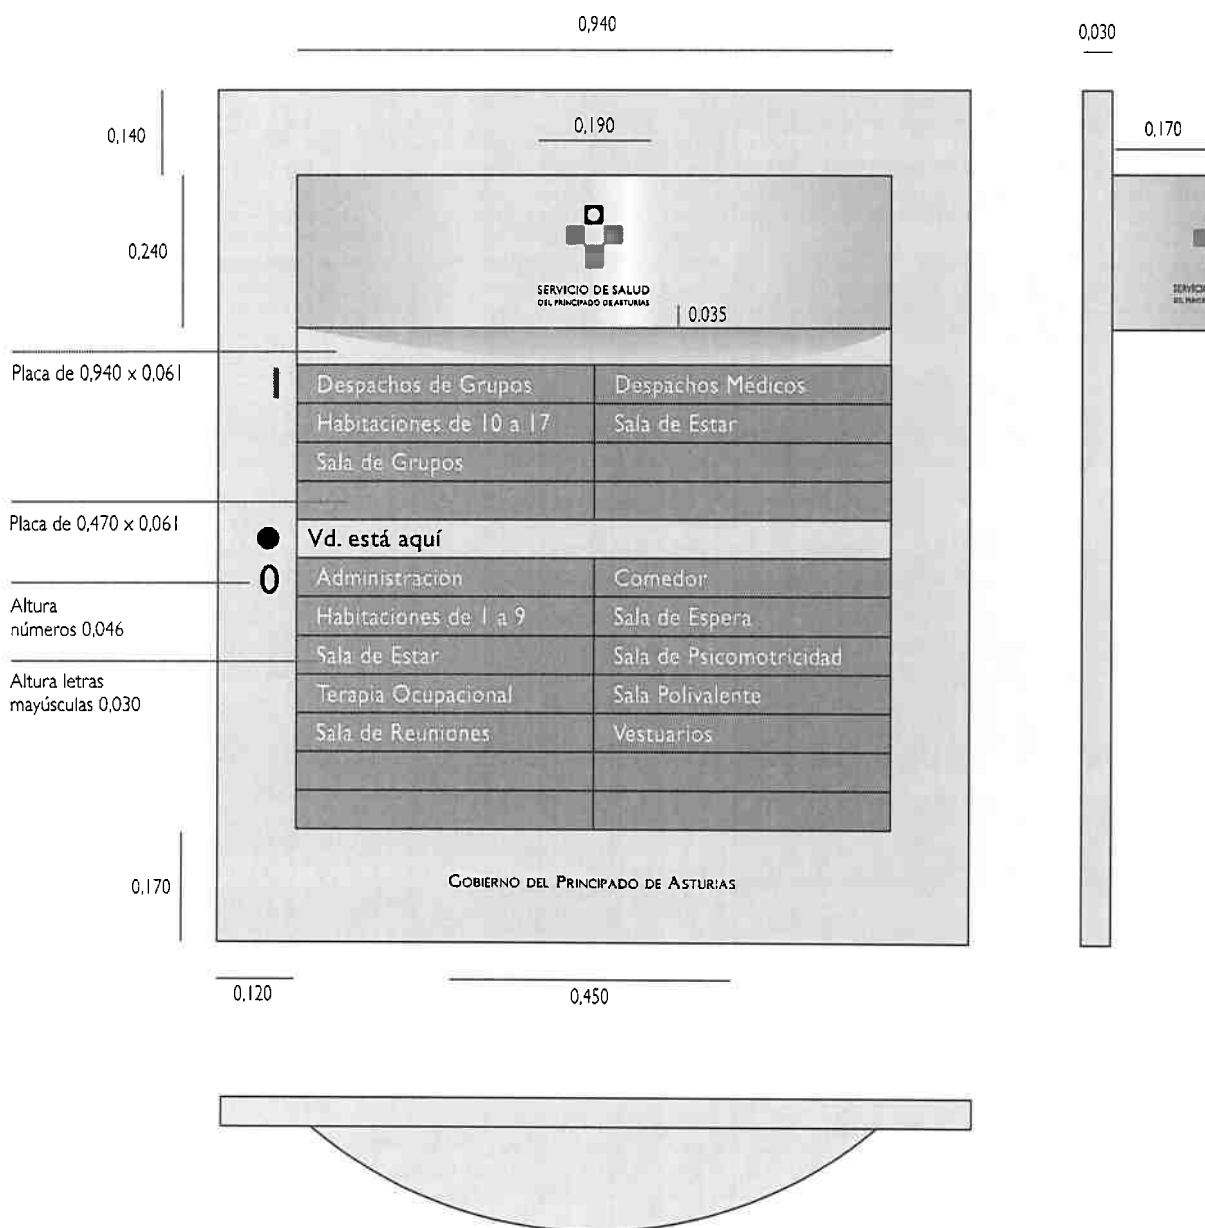

Acotaciones en metros.

Señalización interior.

Ejemplo de la aplicación del sistema de escritura, pictogramas e indicadores direccionales en un edificio de oficinas.

Los pictogramas estarán siempre situados en el extremo opuesto a la flecha para dar preferencia a la información verbal.

Rótulo nº **8-A**


	Salud Laboral	↑
	Medicina General	↑
	Sala de Intervención	→
	Sala de Observación	→
←	Enfermería	☕

Para conseguir una perfecta lectura, hay que tener en cuenta una correcta selección del interletraje.


Señalización interior. Rótulos suspendidos a doble cara.

La señalización estará construida con placas "Slatz Grande de Spandex", o similar, de una altura de 82 mm. (útil 78,5 mm.)

Rótulo nº **8-B**

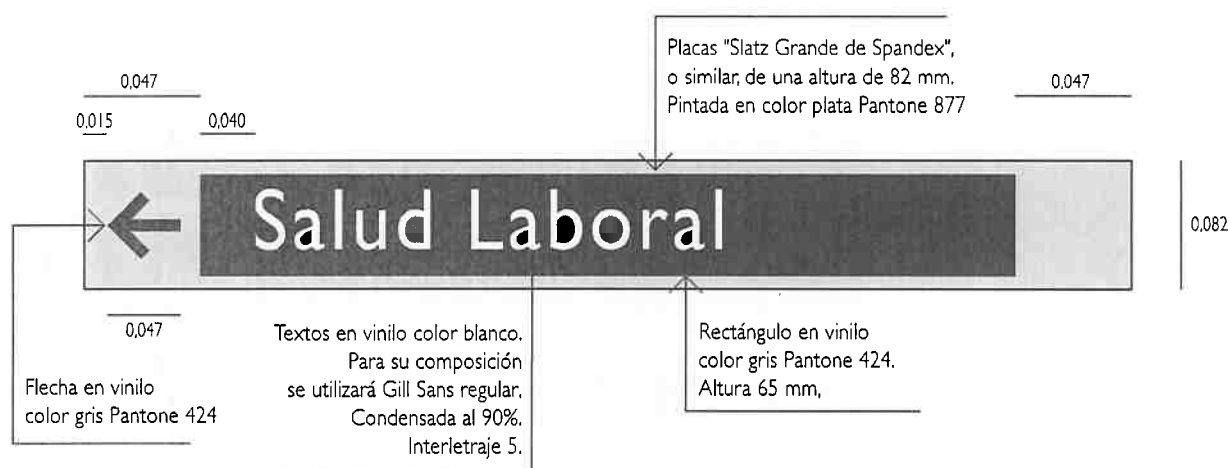

Para la longitud de la placa se utilizará como base el texto más largo, manteniendo las mismas distancias (A) y (B) igual a 0,040 m.

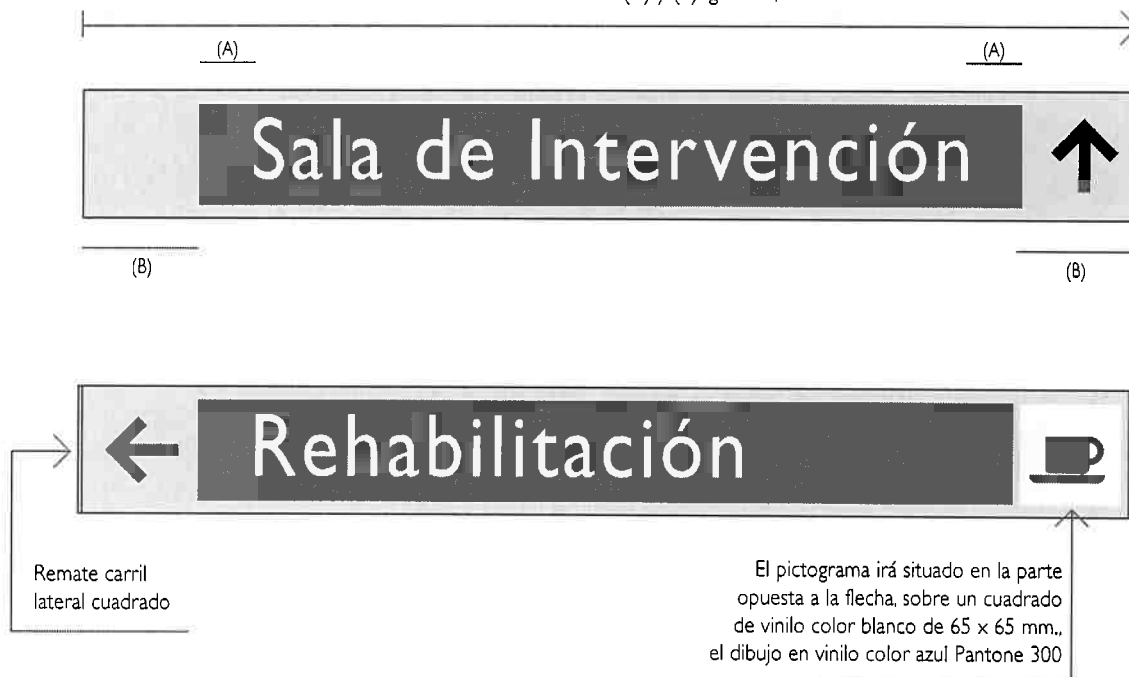


Acotaciones en metros.

Señalización interior.

Normativa para la colocación de las placas.

Para facilitar la lectura se realizarán dos grupos de información:

Rótulo n° **8-C**

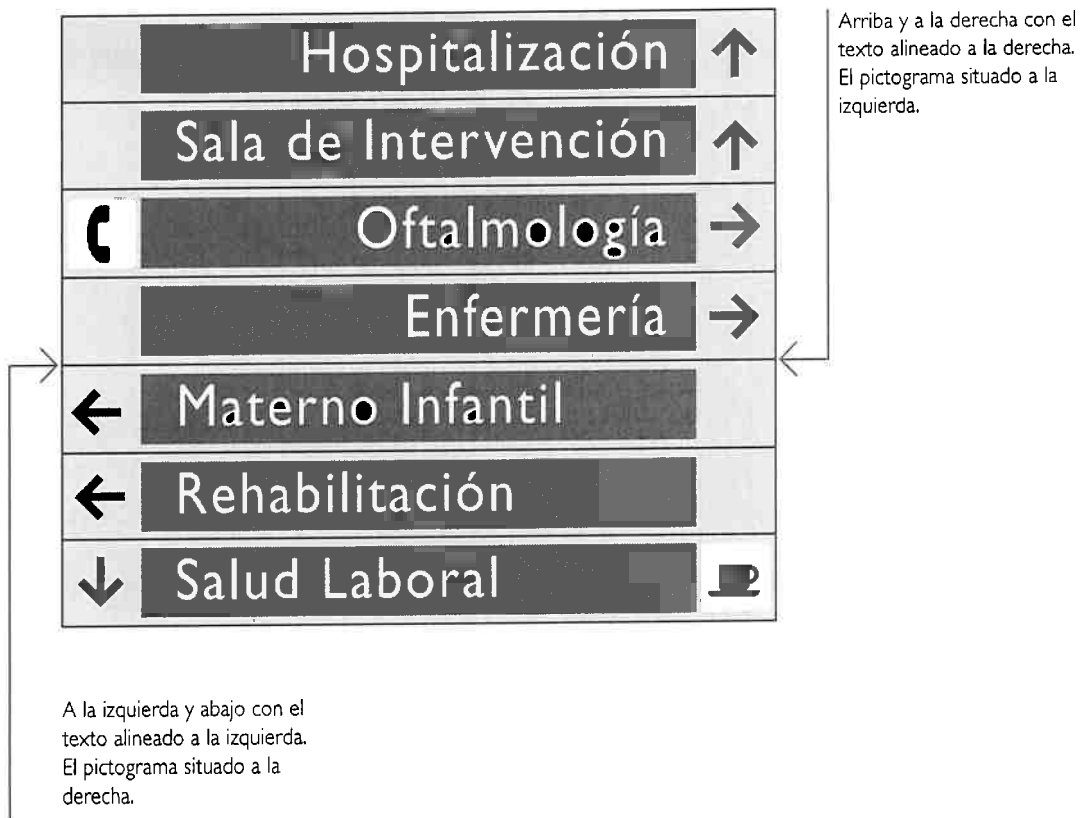


Señalización interior.

Debe situarse en lugares estratégicos para facilitar y dar continuidad al recorrido, ya que generalmente son necesarias varias señalizaciones para marcar el camino hacia el lugar indicado.

Su fijación podrá ser:

- A la pared.
- Suspendidas del techo (una o dos caras).
- En bandolera (una o dos caras)




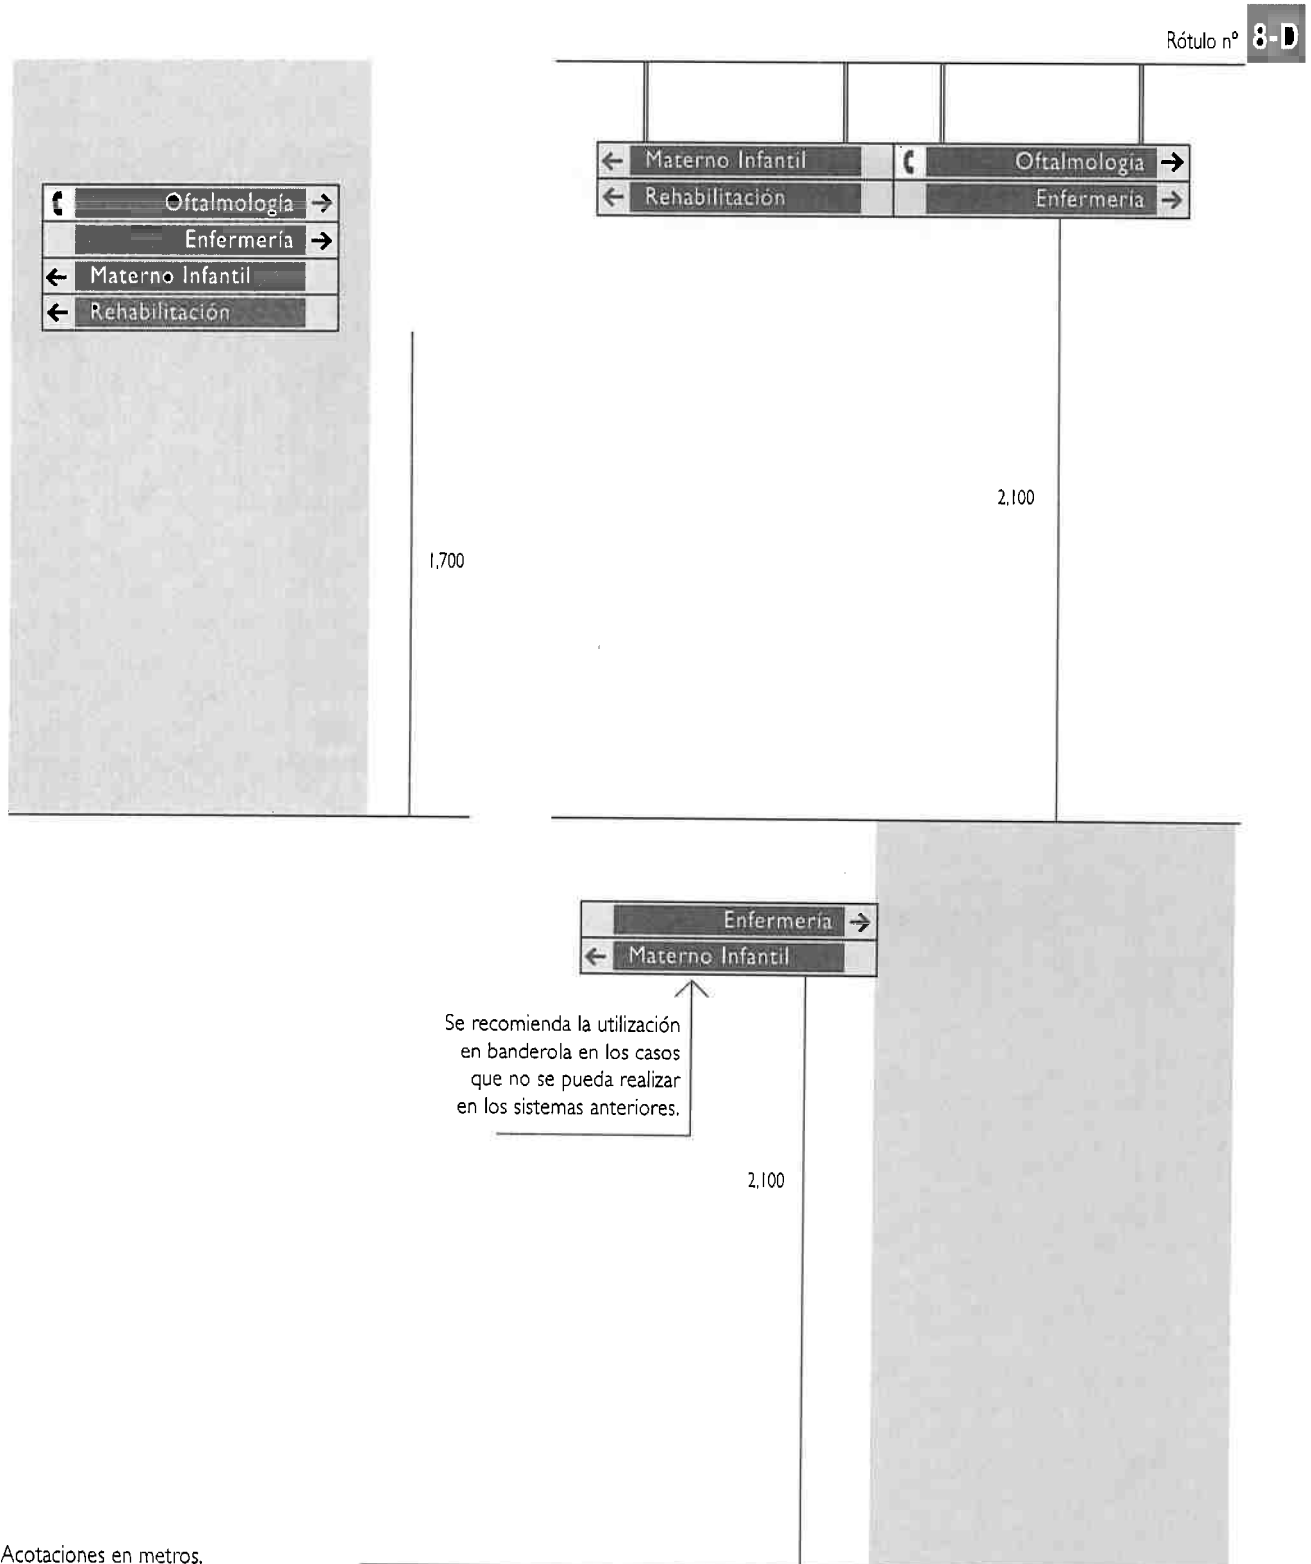


Señalización interior.

Ejemplo de colocación de la
señalización en diferentes
situaciones en un recorrido.

- (A) Suspendidas del techo dos caras.
- (B) Suspendidas del techo una cara.
- (C) A la pared.

Rótulo nº 8-E

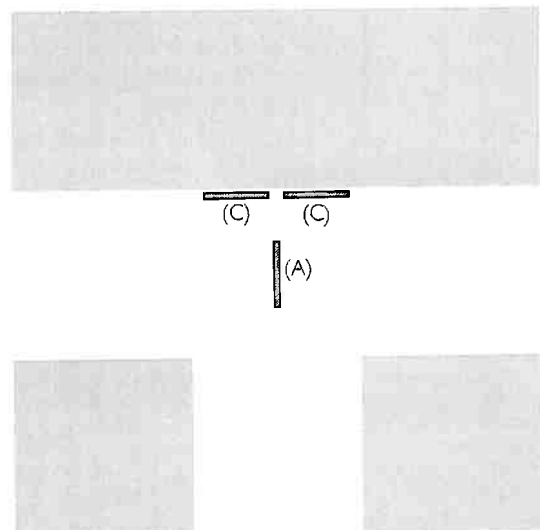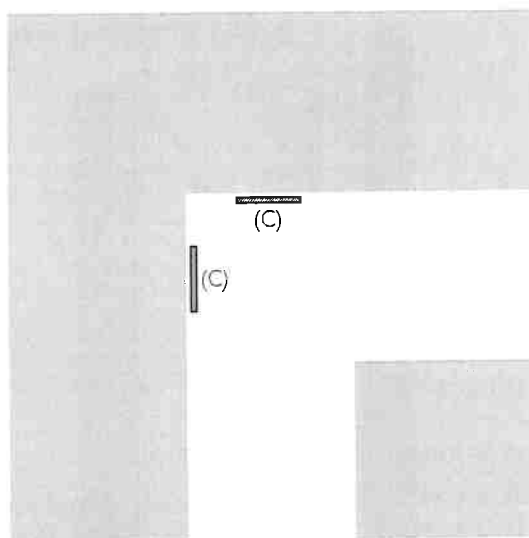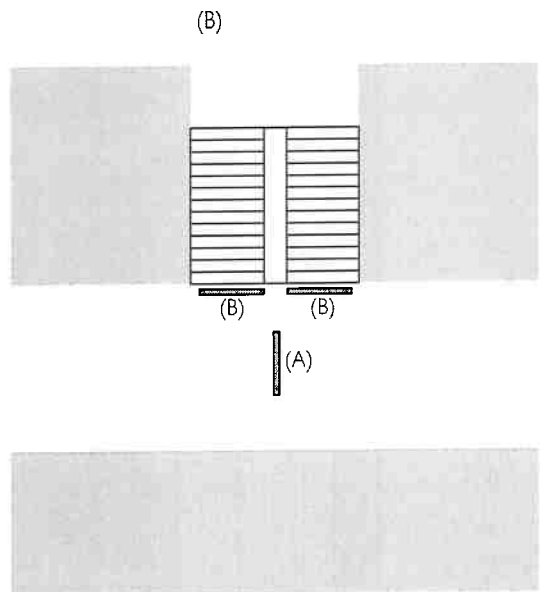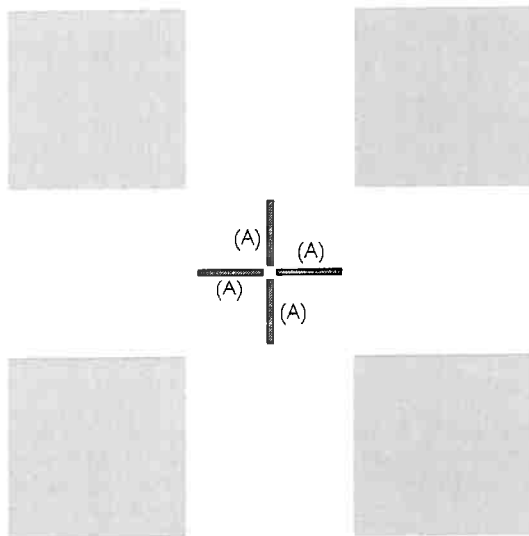

Señalización interior. Consultas y despachos.

Señal formada por tres elementos:


(A) Bandeja de acero pintada en color plata Pantone 877

(B) Placa de aluminio de 3 mm. de grosor pintada en gris Pantone 424. Texto y números en vinilo color blanco.


(C) Placa independiente de aluminio de 2 mm. de grosor pintada en gris Pantone 424. Texto en vinilo color blanco. Se fijará a la bandeja por medio de PVC imantado de 1mm.

Textos compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.


Rótulo n° **9-A**

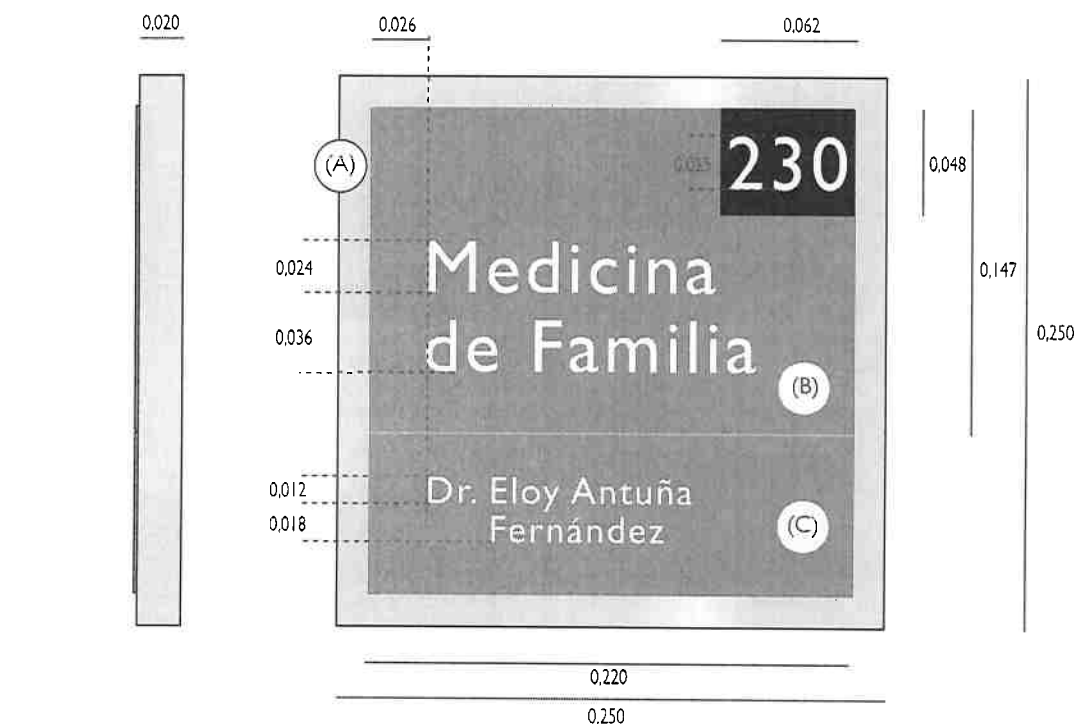

Cuando la placa no tenga numeración, se quitará el recuadro y el texto irá centrado en altura, respetándose el margen izquierdo.

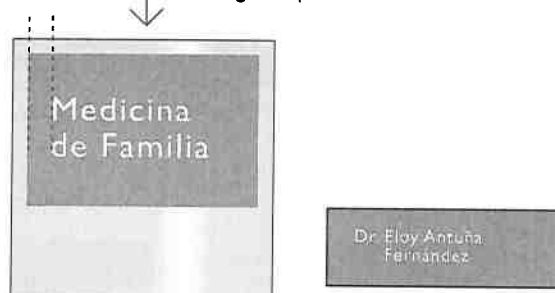

Sujeción a la pared por medio de una regleta de 80 mm. de ancho, doblada y atornillada a la misma.

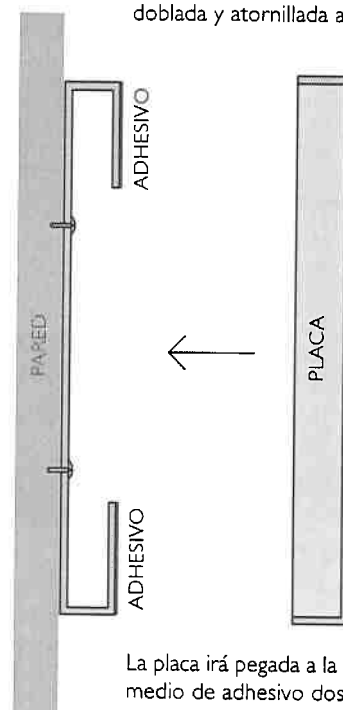

Acotaciones en metros.


Señalización interior.

Conjunto móvil (B) provisional.

Este soporte estará construido en una lámina de metacrilato transparente plegado y fijado a la bandeja por medio de PVC imantado de 1mm.

El tarjetón con el nombre del doctor se realizará en impresora, manteniendo los colores, tamaño y tipo de letra de las placas definitivas.

Rótulo nº **9-B**

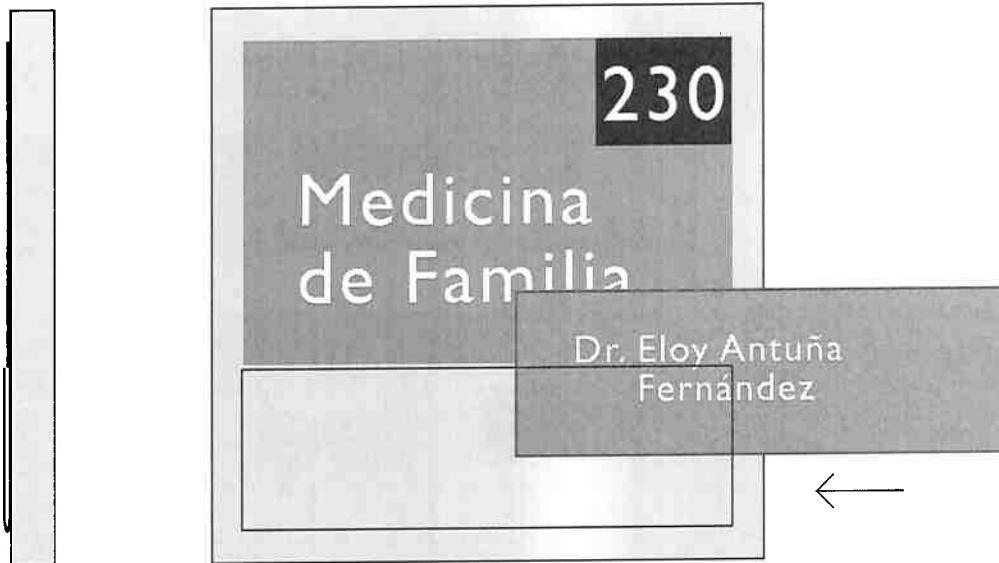


Señalización interior.

Se presenta en este epígrafe la configuración de la señalización situada en los lugares de destino o en el propio lugar que el rótulo señala.

Estos indicadores se situarán, con relación a la puerta, en el mismo lado en que se encuentre la manilla para abrirla.

Rótulo nº **9-C**

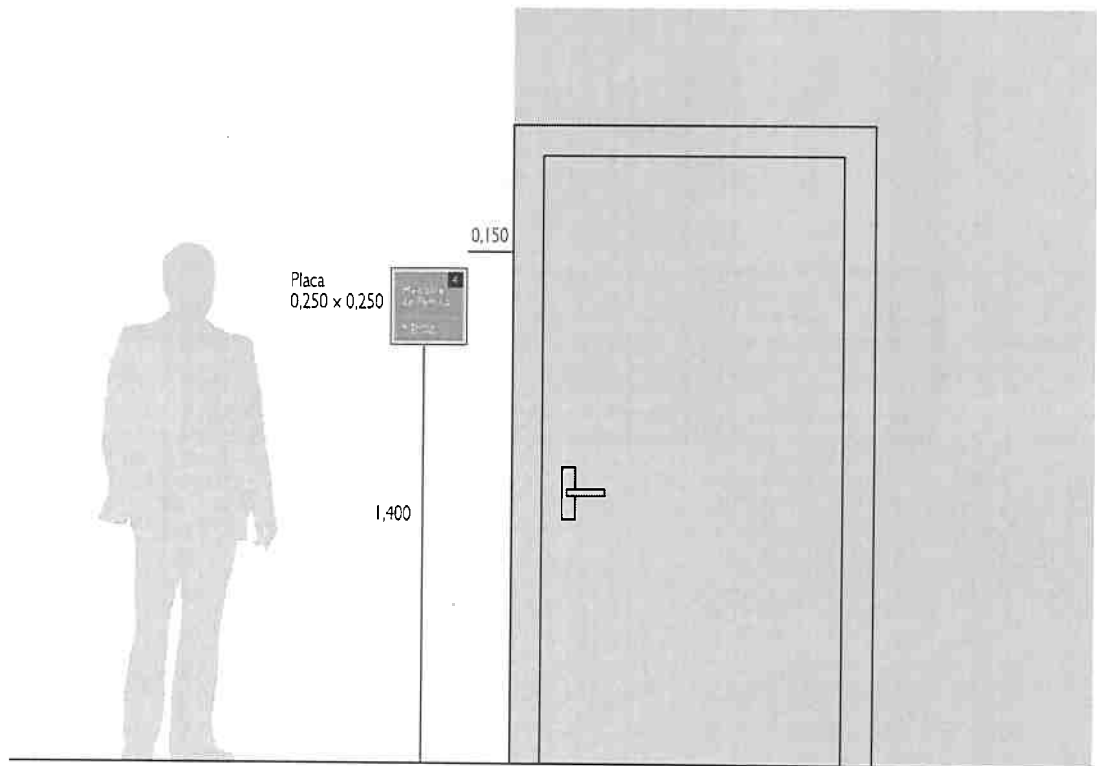

Señalización interior. Pictogramas.

Placa de metacrilato transparente de 8 mm. de grosor, con los cantos pulidos y pintada por la parte de atrás en blanco. En el frontal se colocará el pictograma en vinilo color azul Pantone 829.



Estos indicadores se situarán, siempre que sea posible y con relación a la puerta, en el mismo lado en que se encuentre la manilla y siguiendo las cotas adjuntas.

La placa se fijará por medio de pegamento.

Por estar generalizado internacionalmente, se utilizará los pictogramas del programa AIGA, desarrollado por el American Institut of Graphis Arts.

Rótulo nº

10-A

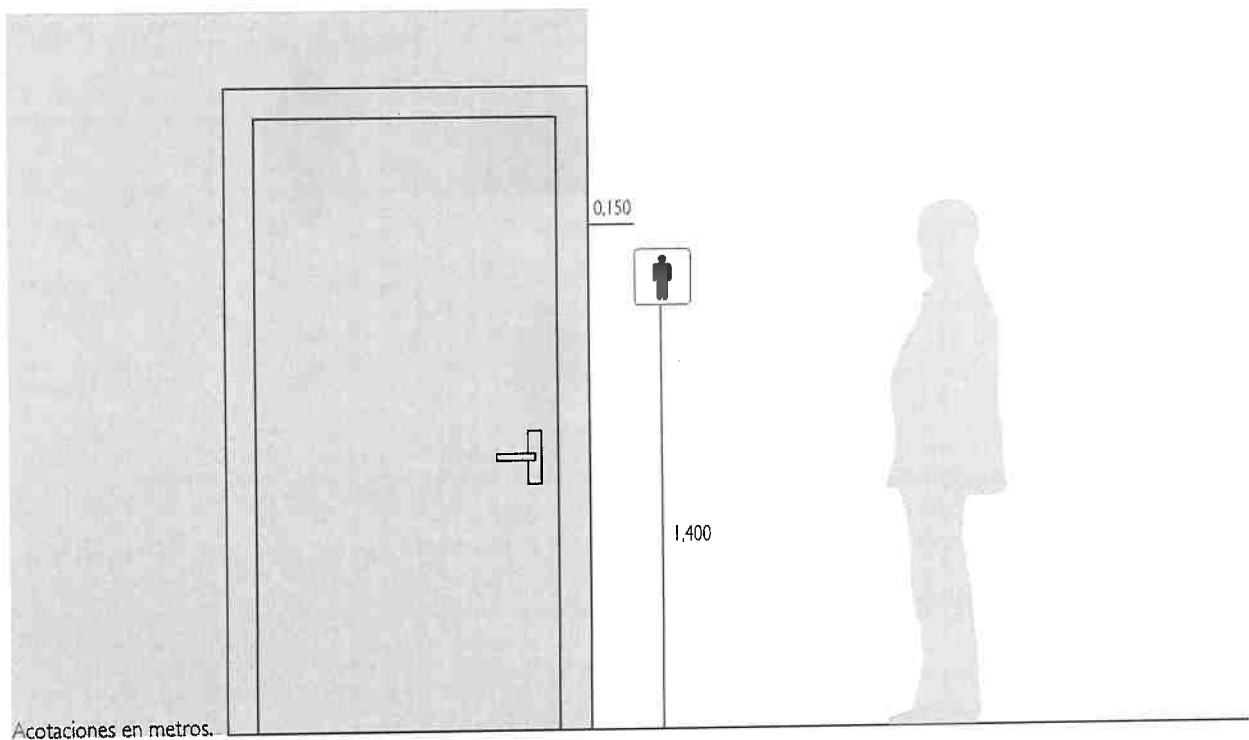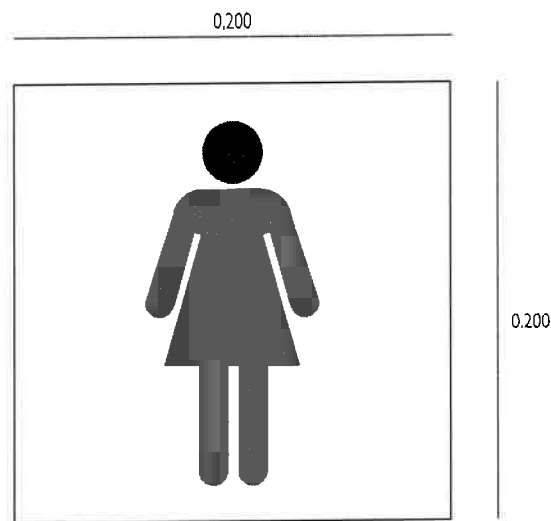

Sistema pictográfico.

La necesidad de transmitir una información, que sea fácilmente comprendida por un público diferente (distinta cultura, distintas costumbres y, sobre todo, distinto idioma), motiva la constante transposición de expresiones verbales en sistemas visuales de signos.

El pictograma es la síntesis gráfica de un concepto, y debe transmitir la información deseada de forma clara y concisa para ser rápidamente asimilada por los receptores.

Rótulo nº **10-B**

Los pictogramas pueden ser completados con sistemas direccionales, formas verbales, etc.

Se utilizará el color Pantone azul 300 y, en las señales de prohibición, el Pantone rojo 485.




Colocación del símbolo.

Puertas de cristal y cristaleras.

Se realizarán en vinilo tipo ácido, y se colocarán interiormente, en el sitio señalado con las medidas adjuntas.

Rótulo nº **11-A**

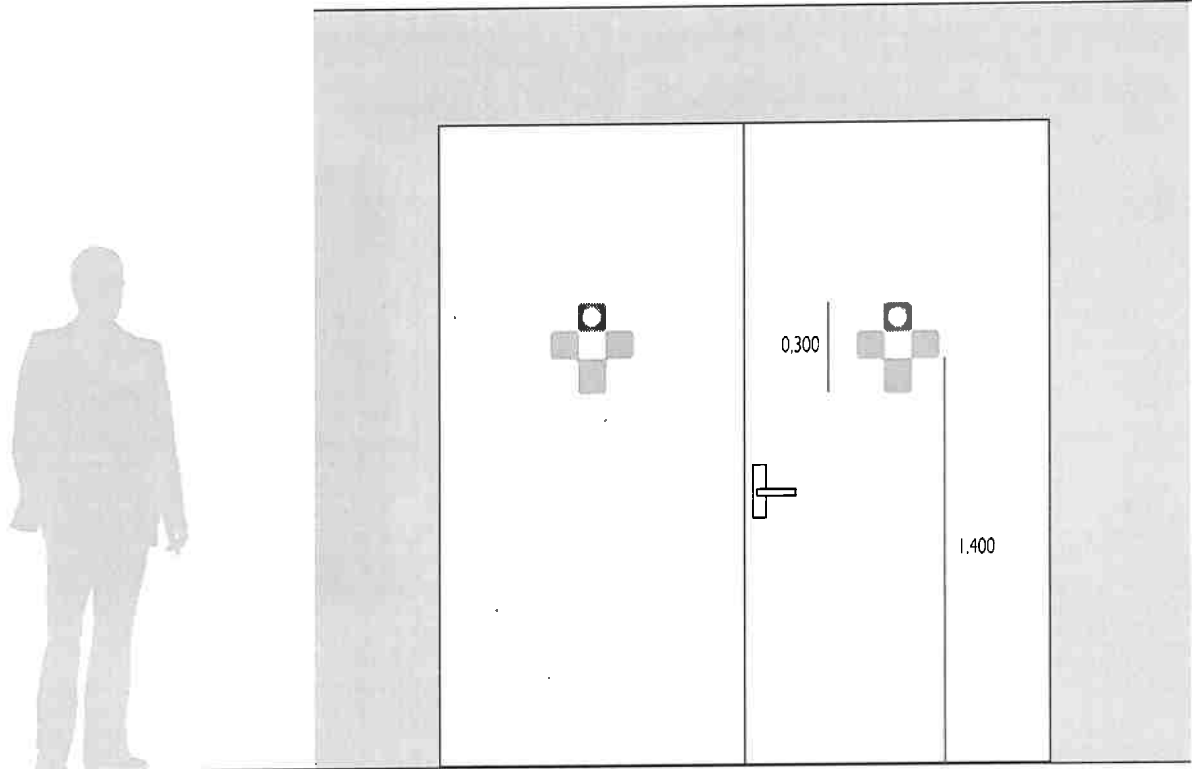

Señalización interior. Habitaciones



Placa de metacrilato transparente de 8 mm. de grosor, con los cantos pulidos y pintada por detrás: la parte superior en azul Pantone 072 y la inferior en plata Pantone 877. En el frontal se colocará el texto y número en vinilo blanco.

Estos indicadores se situarán, siempre que sea posible y con relación a la puerta, en el mismo lado en que se encuentre la manilla y siguiendo las cotas adjuntas.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.
Interletraje: 5.

La placa se fijará por medio de pegamento.

Rótulo nº **12-A**

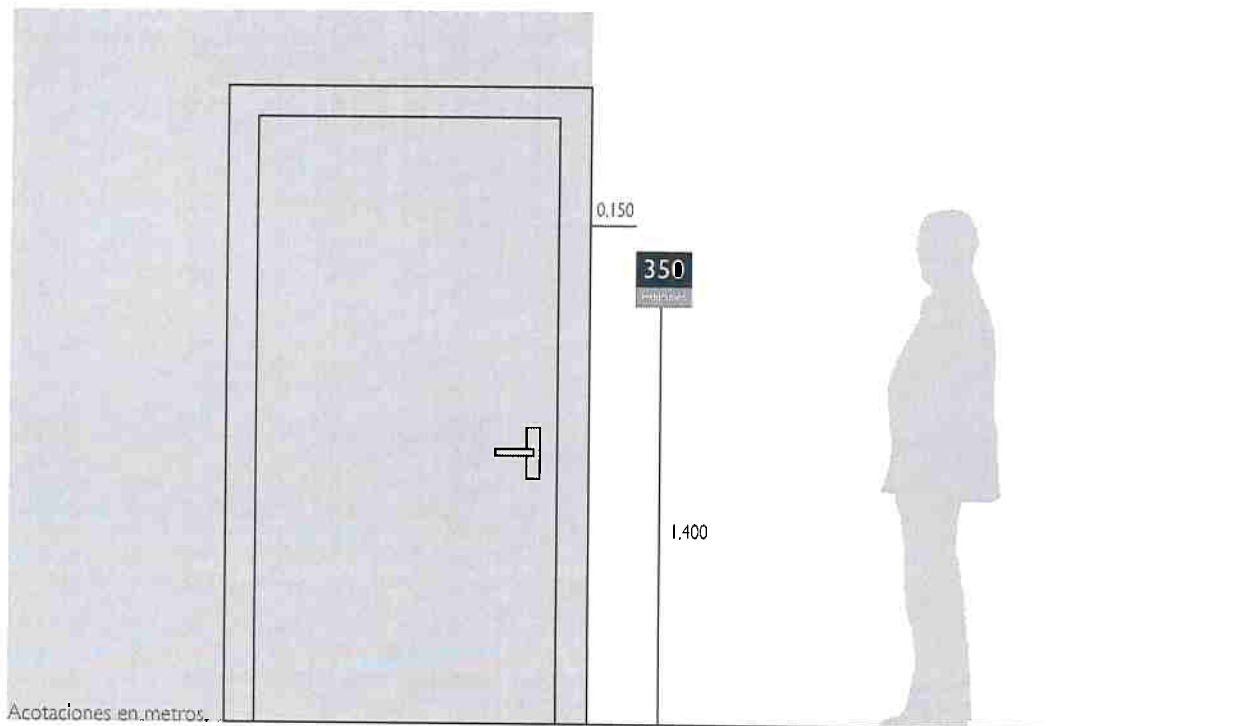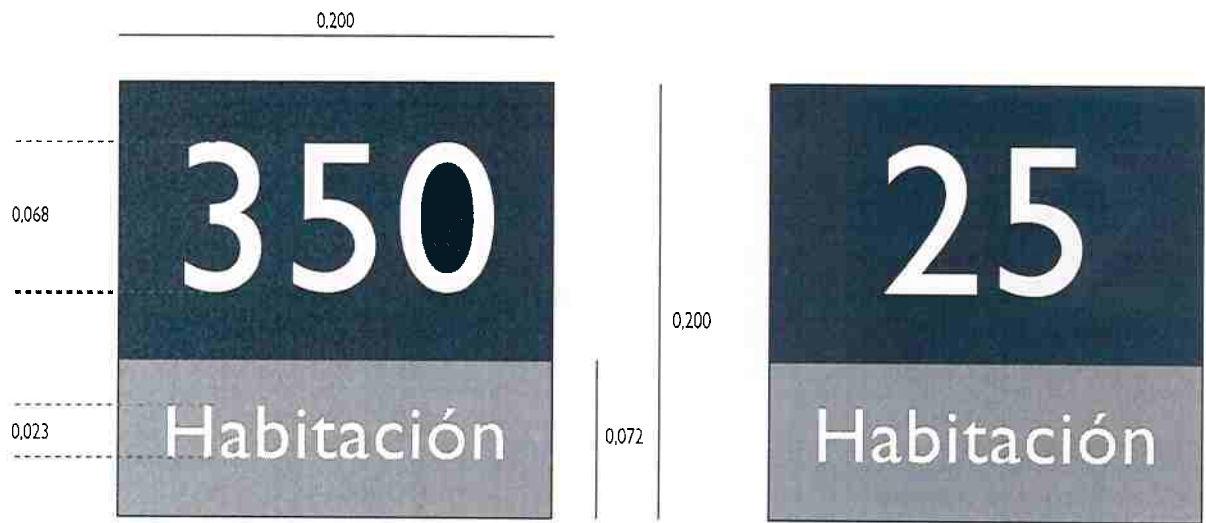

PLACAS CON PICTOGRAMAS.PDF

Señalización interior. Aislamientos / visitas.

Señal formada por tres elementos:


(A) Placa fija de soporte de aluminio de 3 mm. de grosor y placa de "visitas limitadas" de aluminio de 3 mm. Pintada en Pantone 424 y pegada. Texto en vinilo color blanco.

(B) Placa de aluminio de 2 mm. de grosor pintada en el color correspondiente. Texto en vinilo color blanco. Se fijará a la bandeja por medio de PVC imantado de 1 mm.

(C) Placa de aluminio de 2 mm. de grosor pintada en color Pantone 424. Texto en vinilo color blanco. Se fijará a la bandeja por medio de PVC imantado de 1 mm.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.

La placa se fijará por medio de pegamento.

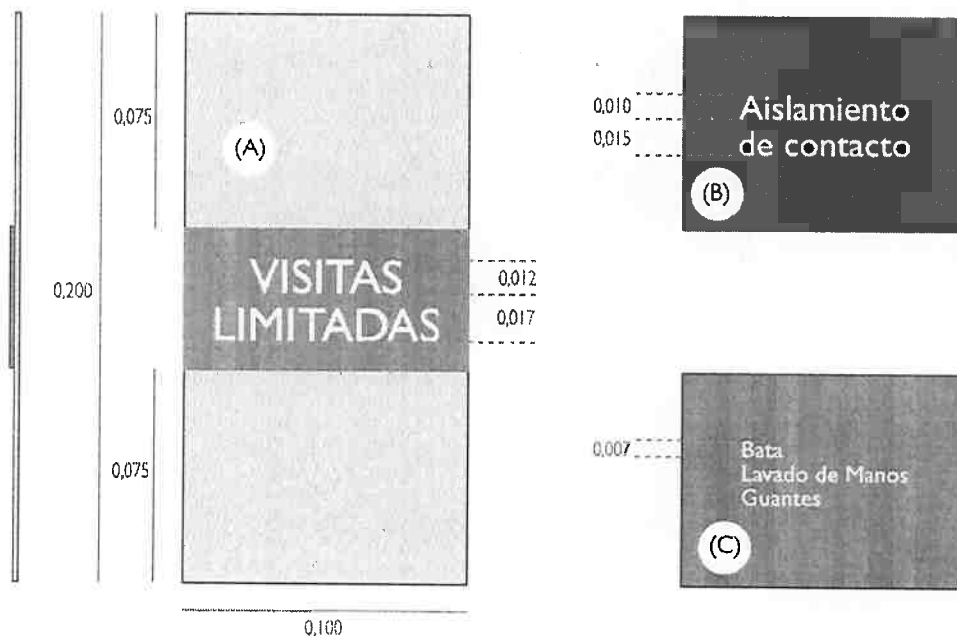

Color rojo Pantone 485 para las placas de prohibición

Color azul Pantone 300 para las placas de uso obligatorio.



Señalización interior. Consultas y despachos.


Señal formada por tres elementos:

(A) Bandeja de acero pintada en color Pantone 877

(B) Placa de aluminio de 3 mm. de grosor pintada en gris Pantone 424. Texto y números en vinilo color blanco.

(C) Placa independiente de aluminio de 2 mm. de grosor pintada en gris Pantone 424. Texto en vinilo color blanco. Se fijará a la bandeja por medio de PVC inmantado de 1 mm.


Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

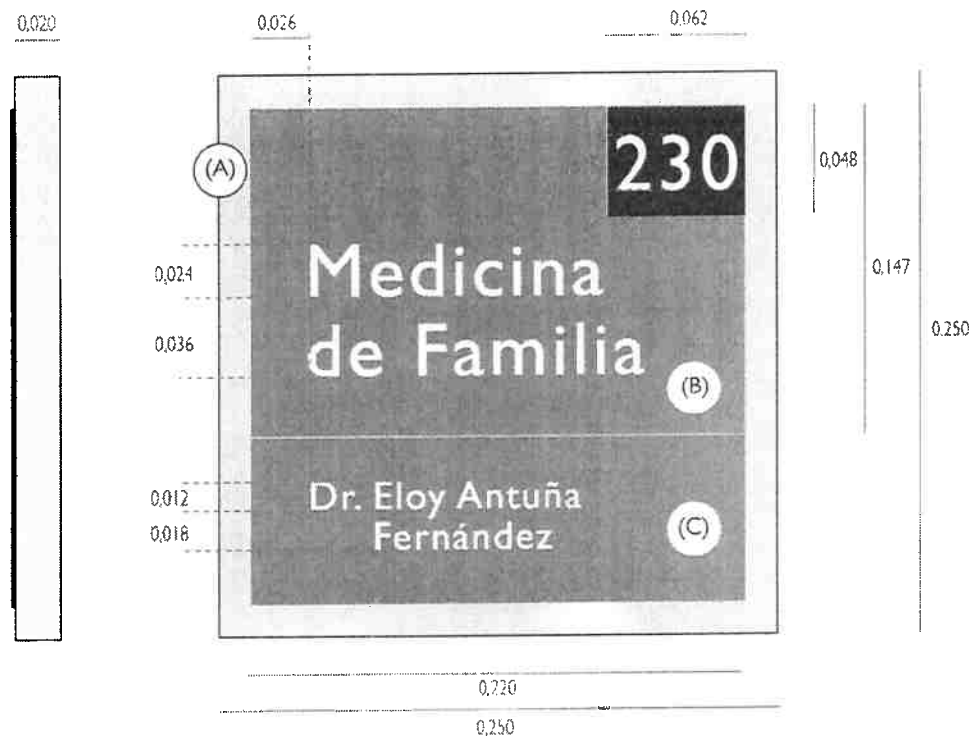

Cuando la placa no tenga numeración, se quitará el recuadro y el texto irá centrado en altura, respetándose el margen izquierdo.



Sujeción a la pared por medio de una regleta de 80 mm. de ancho, doblada y atornillada a la misma.

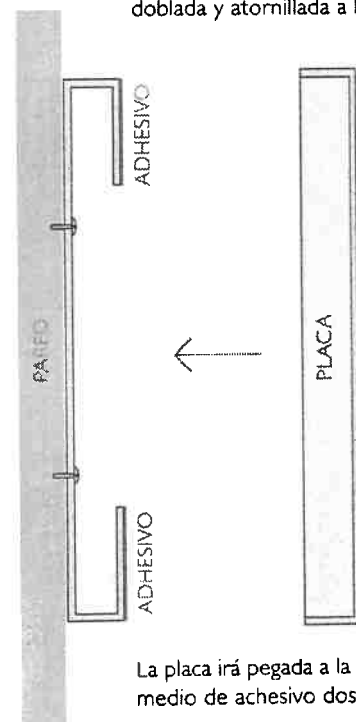

La placa irá pegada a la regleta por medio de adhesivo dos caras.


Señalización interior. Placa complementada con el uso de pictogramas.

Señal formada por dos elementos:


(A) Bandeja de acero pintada en color Pantone 877

(B) Placa de aluminio 3 mm. de grosor pintada en gris Pantone 424. Texto y pictograma en vinilo color blanco.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.
Interletraje: 5.

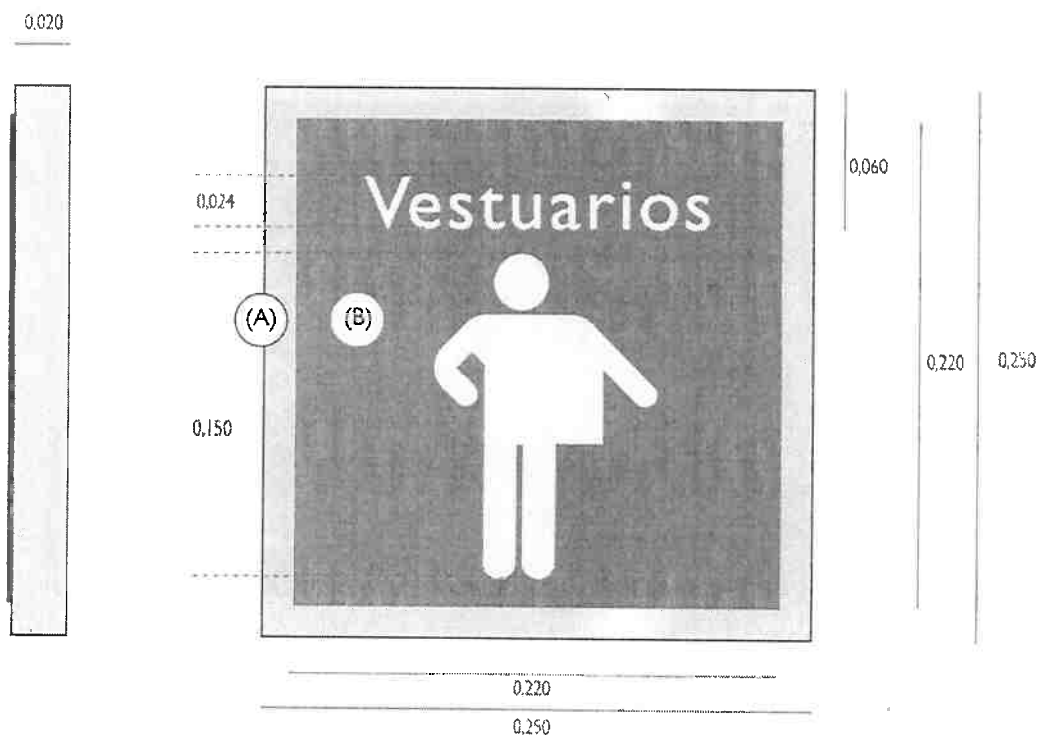

Sujeción a la pared por medio de una regleta de 80 mm. de ancho, doblada y atornillada a la misma.

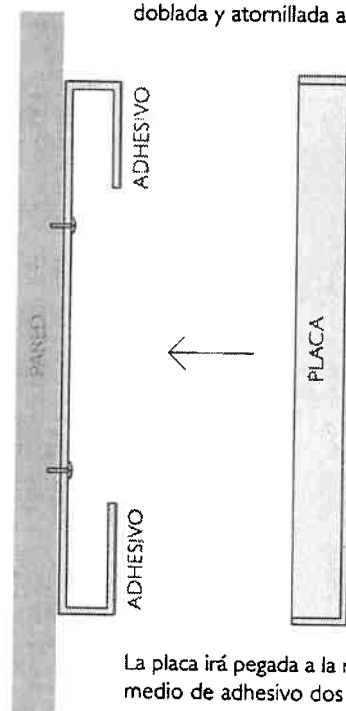

Acotaciones en metros.

La placa irá pegada a la regleta por medio de adhesivo dos caras.



Señalización interior. Pictogramas.

Placa de metacrilato transparente de 8 mm. de grosor, con los cantos pulidos y pintada por la parte de atrás en blanco. En el frontal se colocará el pictograma en vinilo color azul Pantone 829.

Estos indicadores se situarán, siempre que sea posible y con relación a la puerta, en el mismo lado en que se encuentre la manilla y siguiendo las cotas adjuntas.

La placa se fijará por medio de pegamento.

Por estar generalizado internacionalmente, se utilizará los pictogramas del programa AIGA, desarrollado por el American Institut of Graphis Arts.

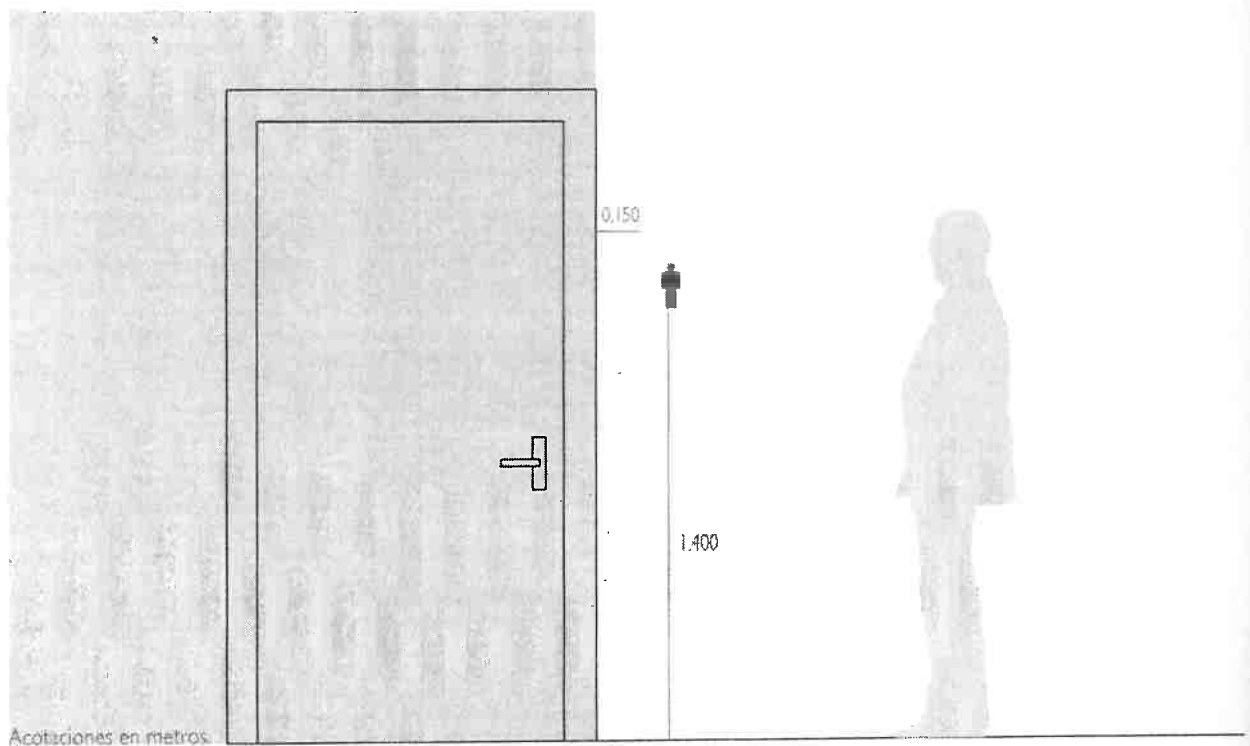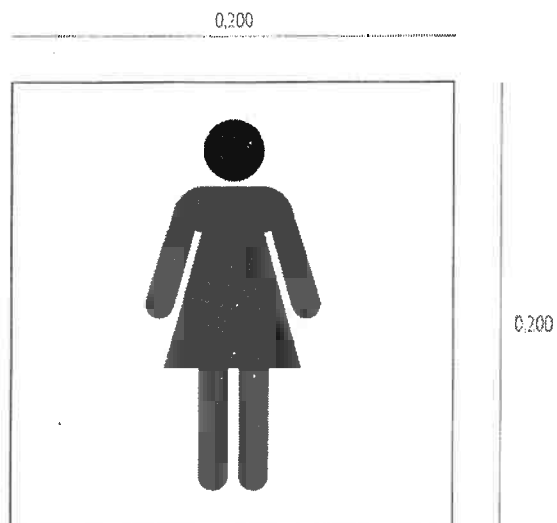



Señalización interior. Zona de uso restringido.

Placa de metacrilato transparente de 8 mm. de grosor, con los cantos pulidos y pintada por detrás: la parte superior en rojo Pantone 485 y la inferior en gris Pantone 424. En el frontal se colocará el texto y número en vinilo blanco.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

La placa se fijará por medio de pegamento.

Como son puertas que deberían estar cerradas, estos indicadores se colocarán en la propia puerta, siguiendo las cotas adjuntas.

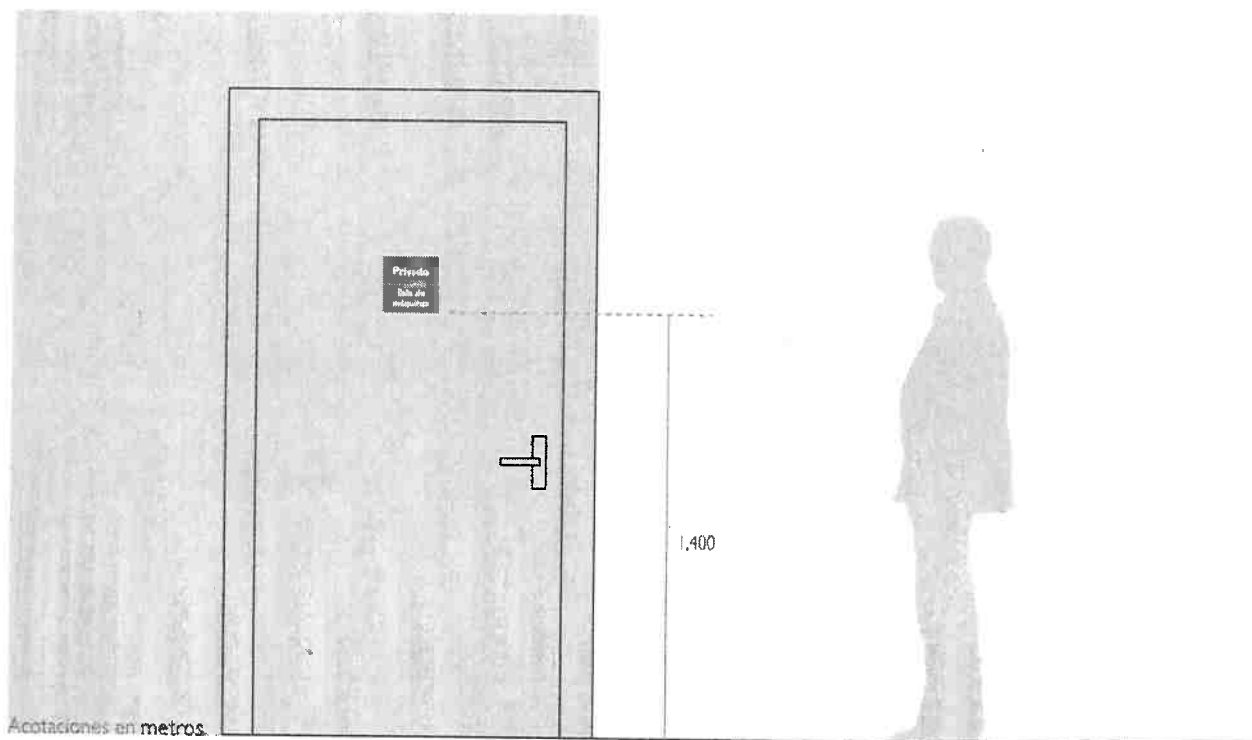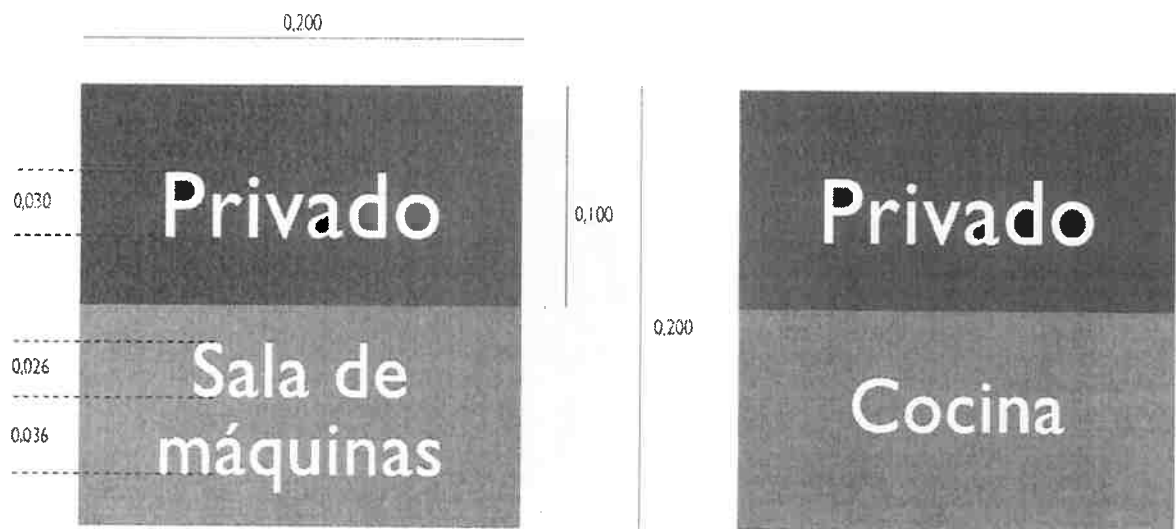



Señalización interior. Habitaciones

Placa de metacrilato transparente de 8 mm. de grosor, con los cantos pulidos y pintada por detrás: la parte superior en azul Pantone 072 y la inferior en plata Pantone 877. En el frontal se colocará el texto y número en vinilo blanco.

Estos indicadores se situarán, siempre que sea posible y con relación a la puerta, en el mismo lado en que se encuentre la manija y siguiendo las cotas adjuntas.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.
Interletraje: 5.

La placa se fijará por medio de pegamento.

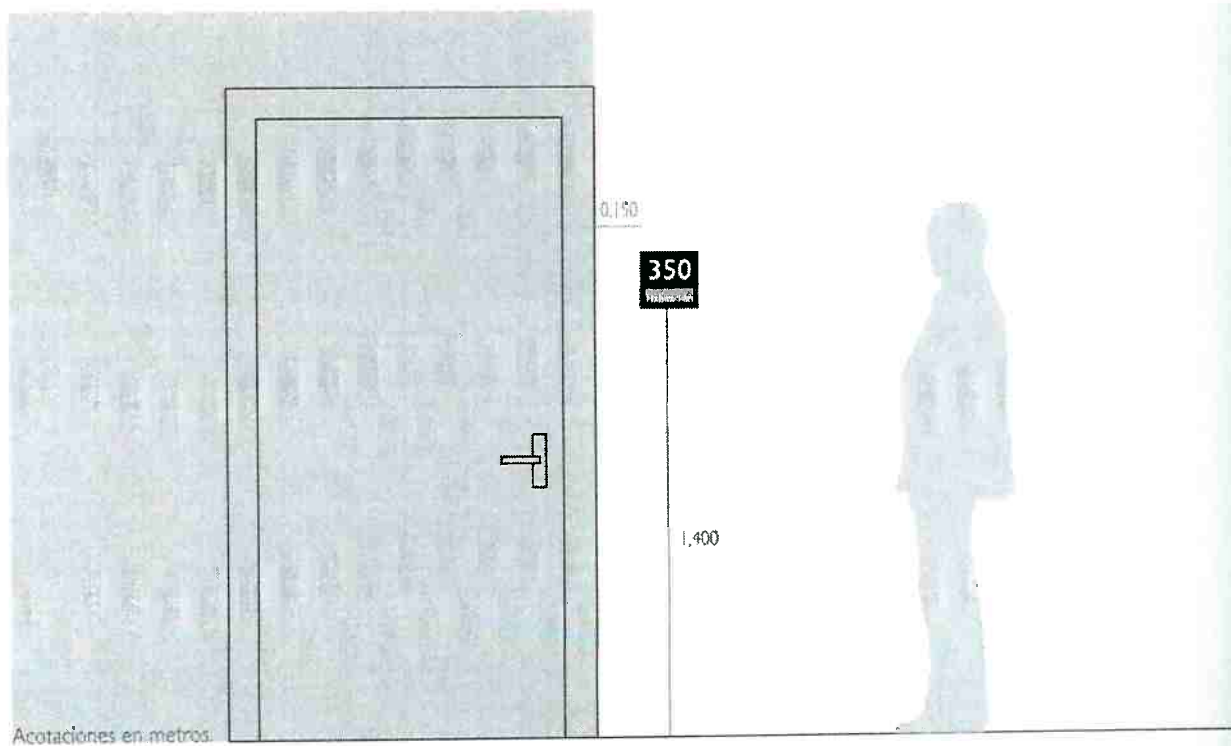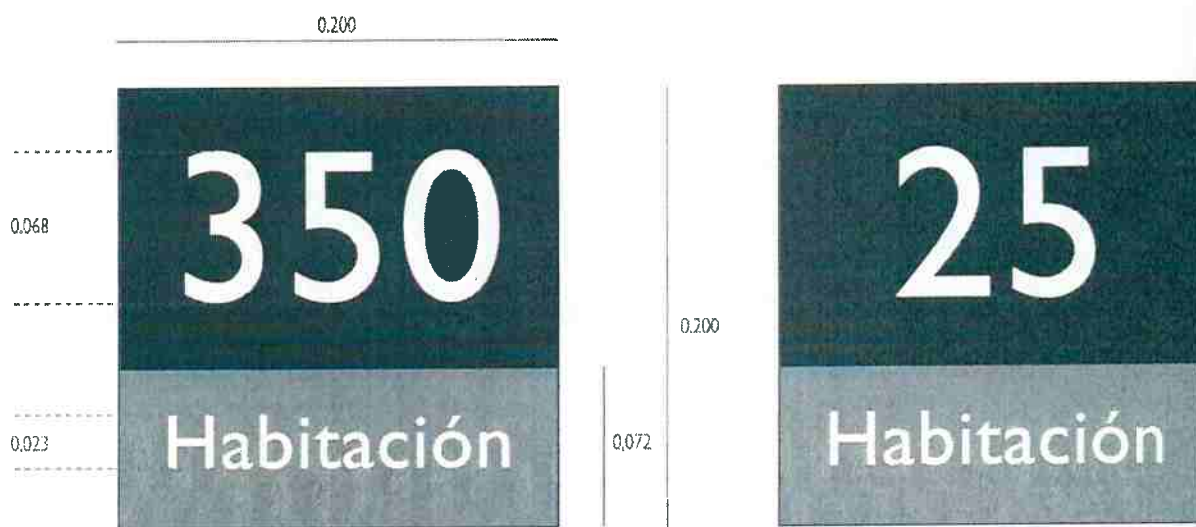

MONOLITO INSALUD.PDF



Señalización interior. Reutilización de los soportes de Insalud (2,00 x 4,25 m.)

Eliminar la imagen anterior, sanear y pintar el monolito en color Pantone 877.

Rótulo formado por dos elementos:

(A) Módulo circular en acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias". Esmerilado horizontalmente.


(B) Placa de PVC de 8 mm de grosor pintada en color gris Pantone 424. Textos en vinilo color blanco.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Esta señal puede estar iluminada exteriormente por medio de focos. En el caso de monolitos de menor tamaño, este sistema, se adaptará proporcionadamente

Símbolo recortado en aluminio de 4 mm. de grosor, el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072, pegado y asegurado con tornillería interiormente.


Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" fresado (0,2 mm bajorelieve) y pintado en azul Pantone 072.

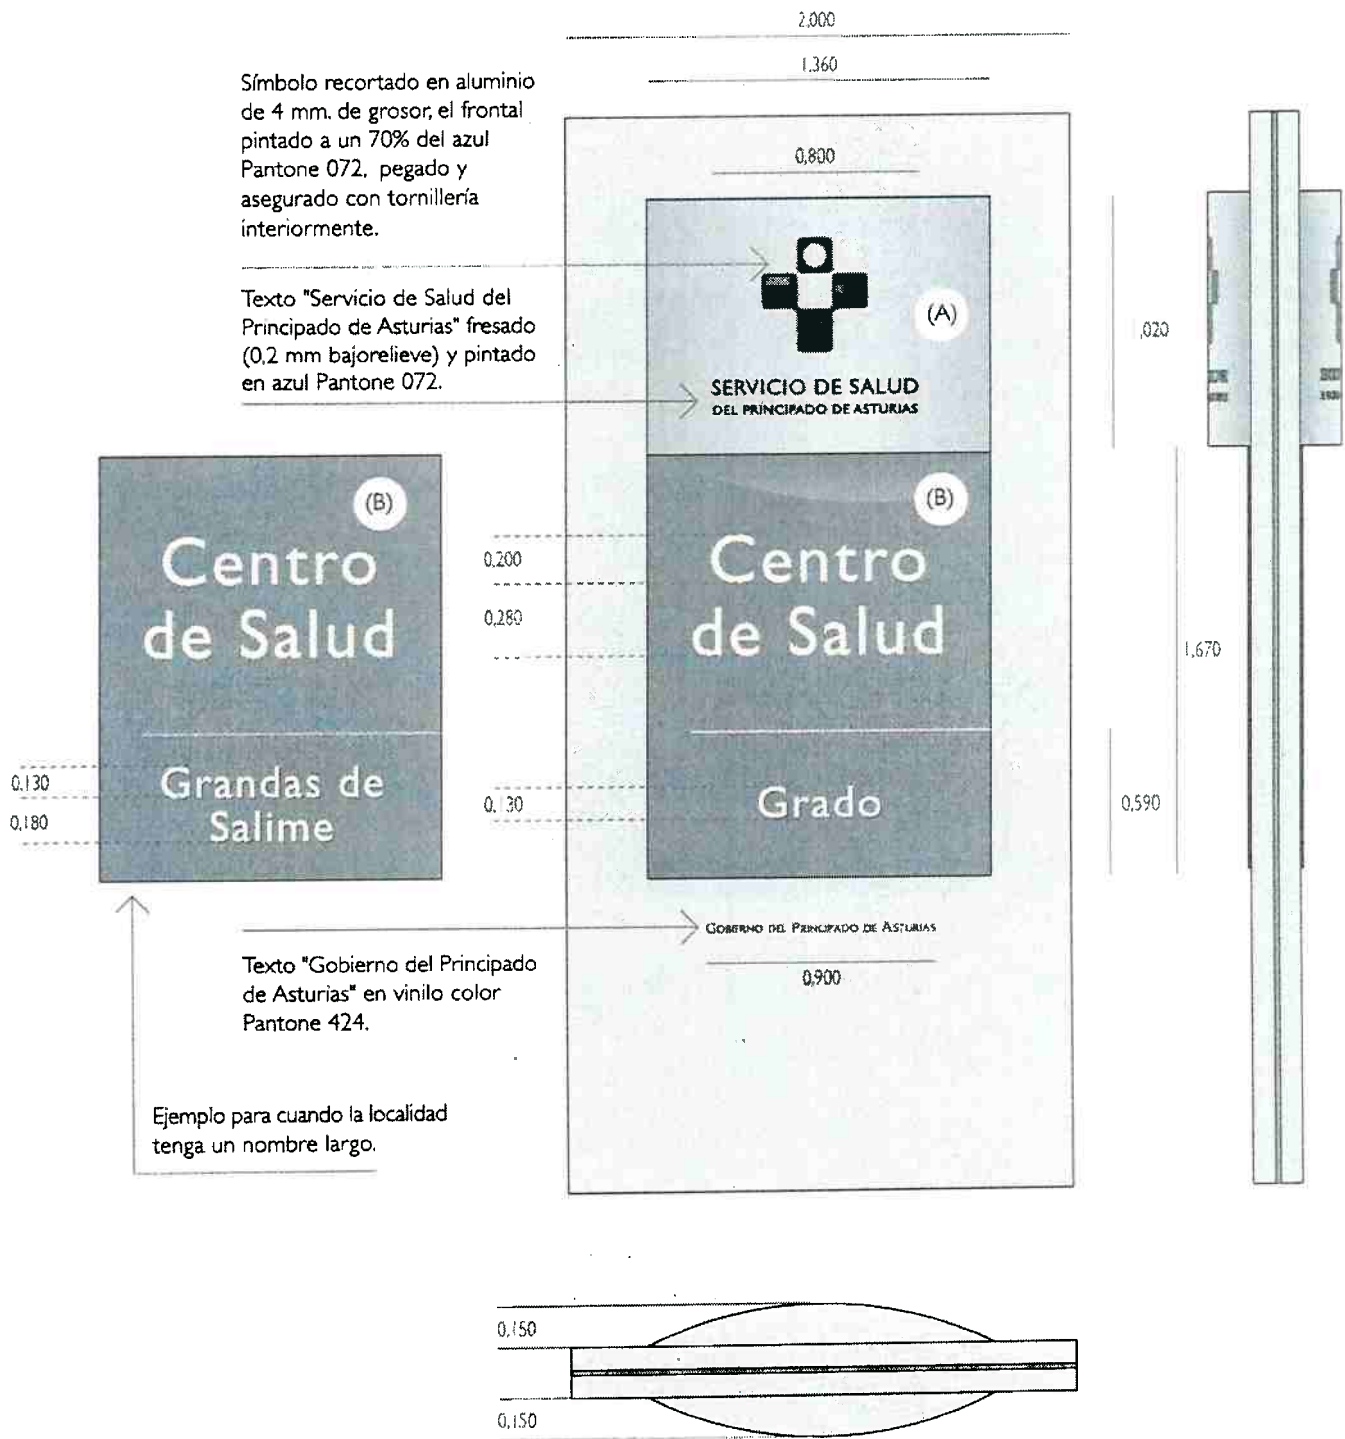

Texto "Gobierno del Principado de Asturias" en vinilo color Pantone 424.

Ejemplo para cuando la localidad tenga un nombre largo.

SEÑALIZACION AREA IV.PDF

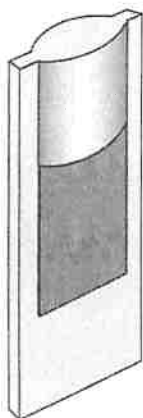

Señalización. Monolito luminoso (dos caras). Área Sanitaria IV

Rótulo formado por tres elementos:

(A) Módulo de estructura metálica recubierta de aluminio de 2 mm de grosor. Pintada en color plata Pantone 877.

B) Módulo circular, con luz interior, en metacrílico translúcido de 3 mm de grosor recubierto de vinilo translúcido, color plata Pantone 877, con la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias". La parte inferior cerrada con metacrílico

Opal para dejar salir la luz sobre el letrero; la superior de acero inoxidable.

(C) Placa de metacrílico transparente de 5 mm de grosor, con los cantos biselados y pulidos, pintada por detrás en color gris Pantone 424. En el frontal se colocarán los textos en vinilo color blanco.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Símbolo recortado en metacrílico translúcido de 10 mm. de grosor, el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072, pegado.

Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" fresado (0,2 mm bajorelieve) y pintado en azul Pantone 072.

Metacrílico Opal para dejar salir la luz sobre el letrero.



Acotaciones en metros.

SEÑALIZACION CONSULTORIAS.PDF

Rótulo formado por dos elementos:

blue/white) para la rotulación del servicio correspondiente.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.
Interletraje: 5.


Esta señal puede estar iluminada exteriormente por medio de focos. Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK
(Lasermax exteriores, LM 922-382 China)


Símbolo recortado en aluminio de 4 mm. de grosor, el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072, pegado y asegurado con tornillería interiormente.

Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" fresado (0,2 mm bajorelieve) y pintado en azul Pantone 072.

La placa de plástico de ROWMARK de 1.5 mm de grosor, pegada sobre la bandeja de acero inoxidable.
Los textos irán fresados (0.2 mm bajorelieve).

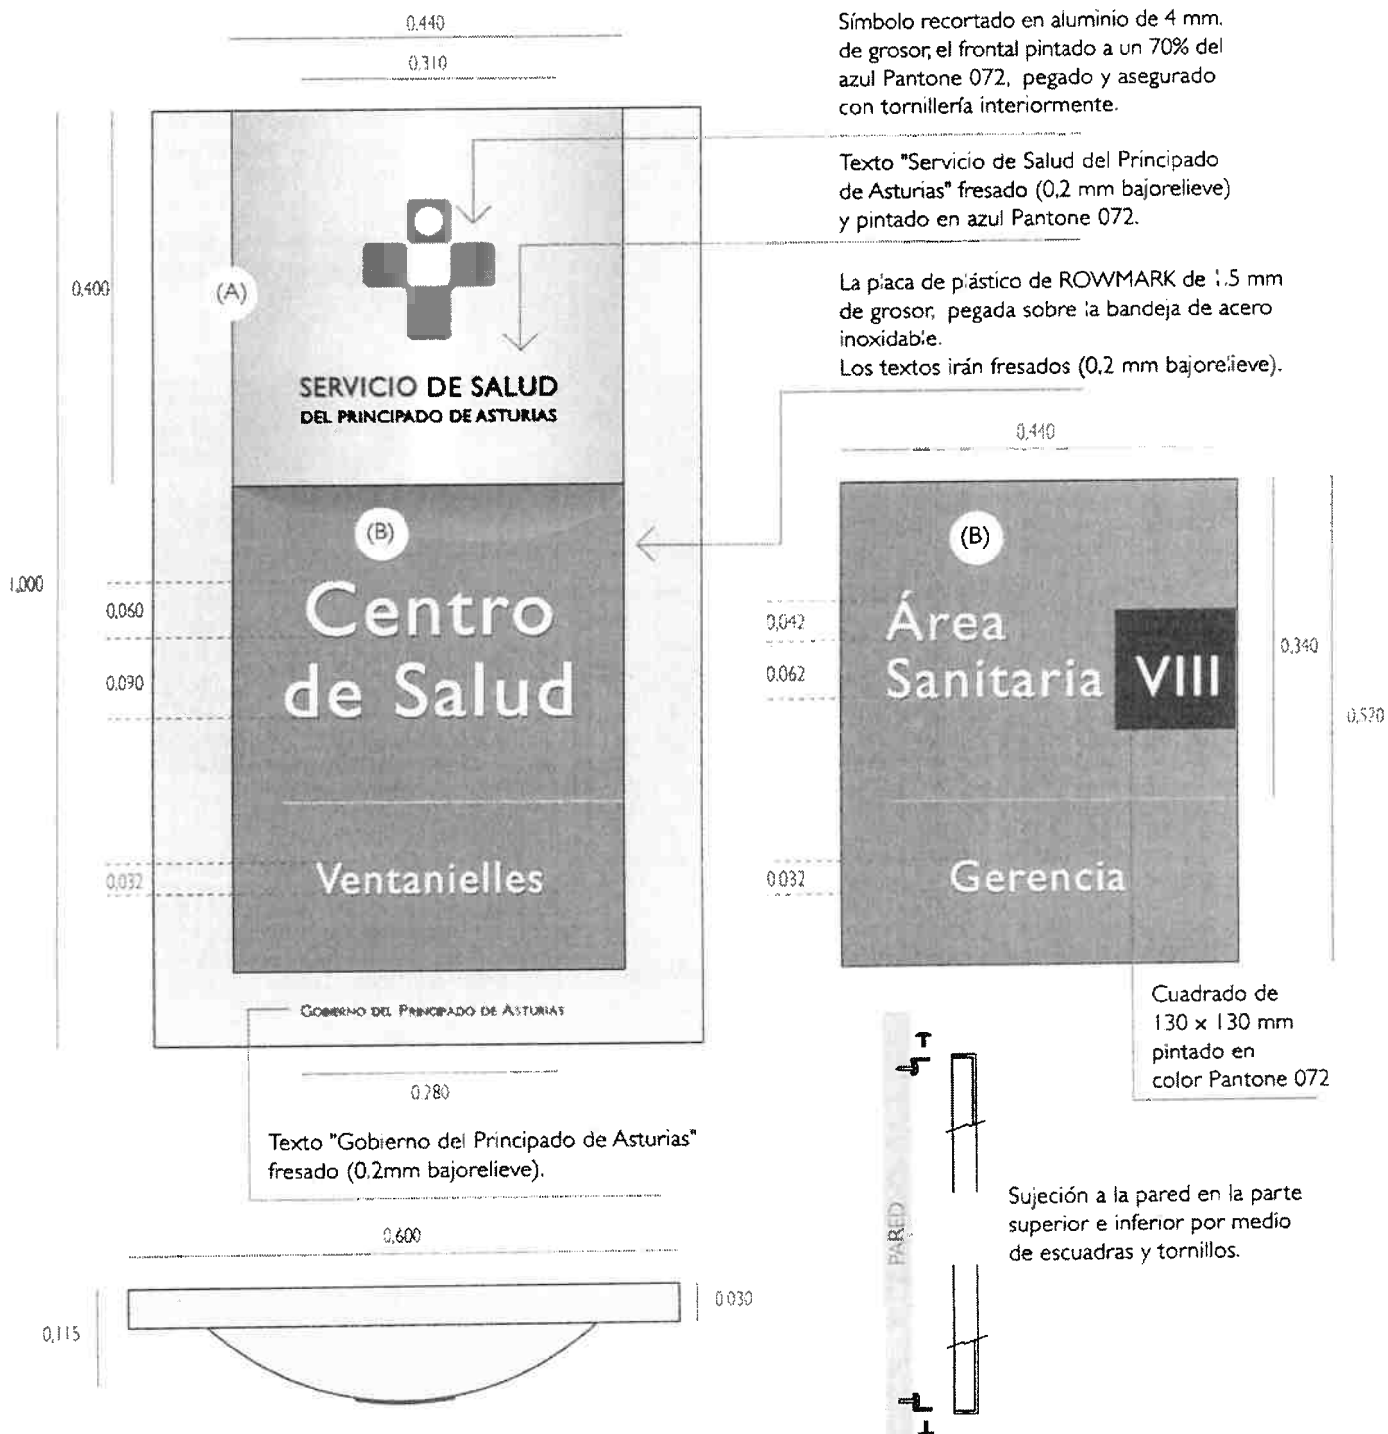

Acotaciones en metros.

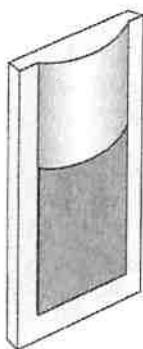

Señalización de consultorios periféricos y locales.

Modelo complementario.

Rótulo formado por dos elementos:


(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular de la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias", en el mismo material. Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasemax exteriores, LM 922-382 China

blue/white) para la rotulación del servicio correspondiente.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Esta señal puede estar iluminada exteriormente por medio de focos. Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

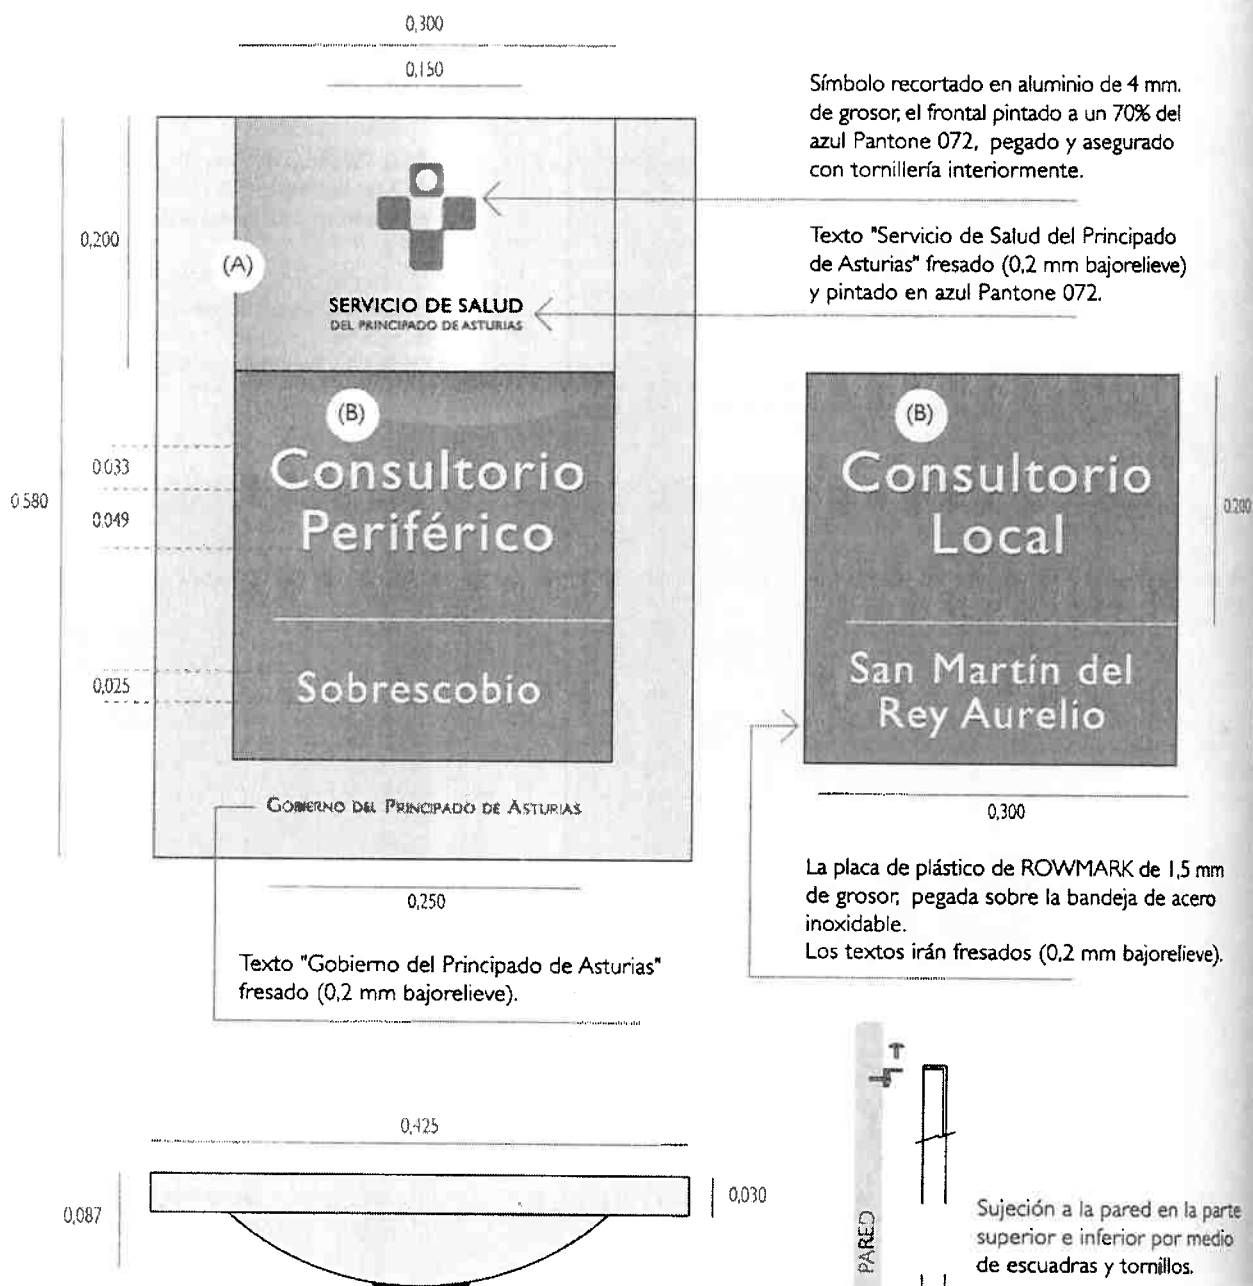


Símbolo recortado en aluminio de 4 mm. de grosor, el frontal pintado a un 70% del azul Pantone 072, pegado y asegurado con tornillería interiormente.

Texto "Servicio de Salud del Principado de Asturias" fresado (0,2 mm bajorelieve) y pintado en azul Pantone 072.

La placa de plástico de ROWMARK de 1,5 mm de grosor, pegada sobre la bandeja de acero inoxidable. Los textos irán fresados (0,2 mm bajorelieve).

Acotaciones en metros

SEÑALIZACIÓN URGENCIAS.PDF

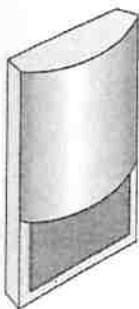

Servicio de Urgencias. Plafón luminoso para consultorio con horario limitado.

Rótulo formado por dos elementos:


(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) y módulo circular, con luz interior, recubierto de vinilo translúcido color plata Pantone 877; con el símbolo. La parte inferior cerrada con metacrilato Opal para dejar salir la luz sobre el letrero y la superior de acero inoxidable.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasemax exteriores, LM 922-382 China blue/white) para la rotulación del servicio y horarios.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

Símbolo recortado en metacrilato transparente de 8 mm. de grosor. Frontal pintado en rojo Pantone 485. pegado.

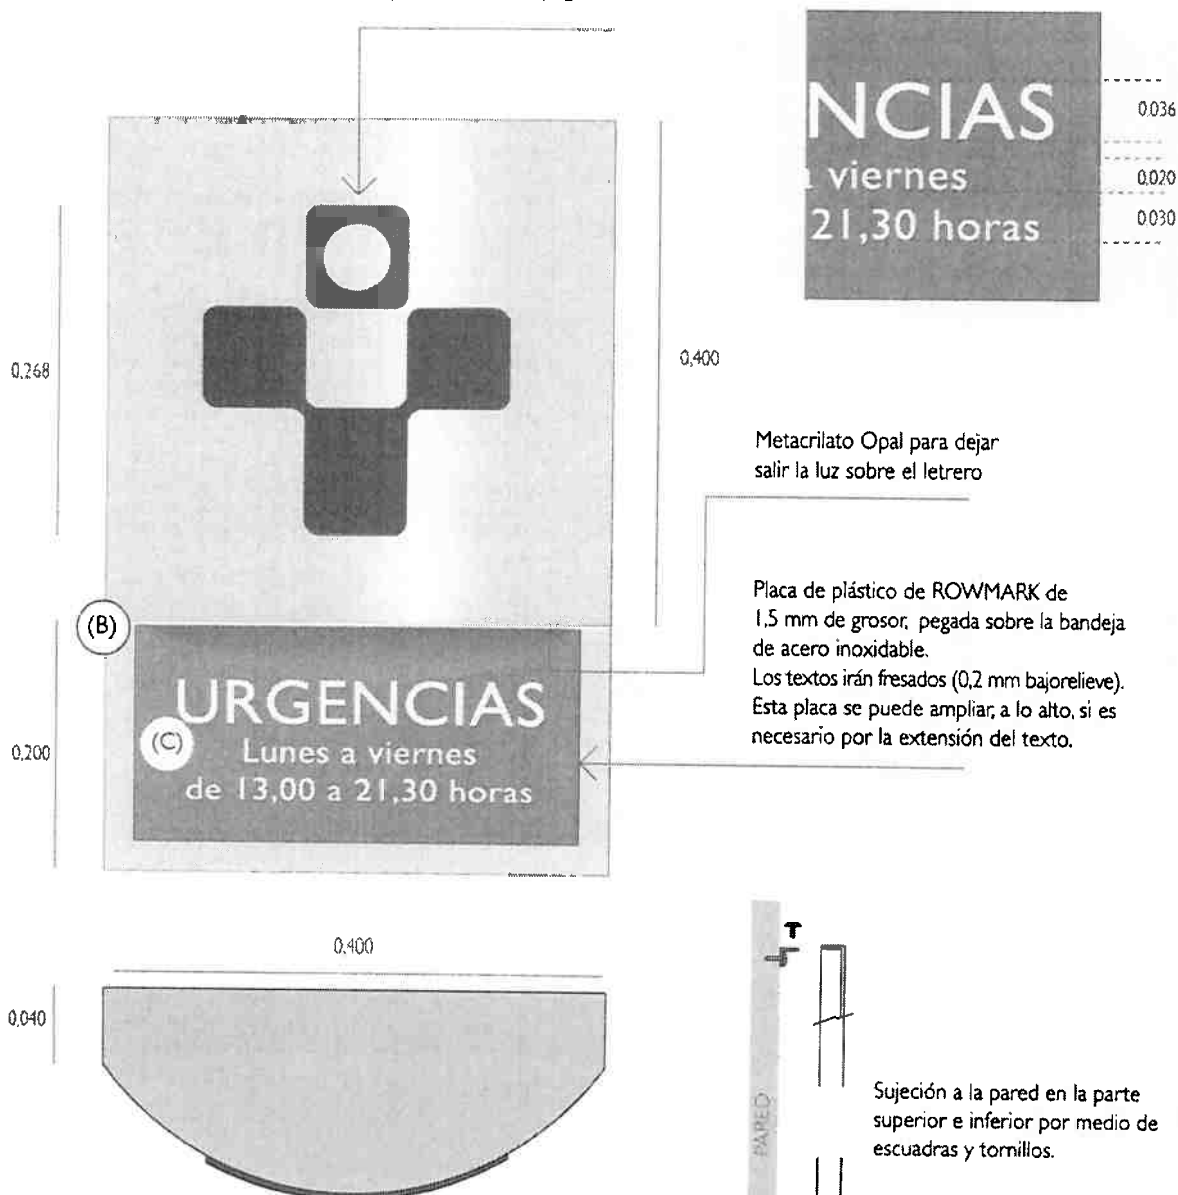

Acotaciones en mm.

Servicio de Urgencias. Plafón luminoso.



Rótulo formado por dos elementos:

(A) Módulo circular de estructura metálica y aluminio, con luz interior. Pintado en color plata Pantone 877. Frontal en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor recubierto de vinilo translúcido color plata Pantone 877. Llevará el símbolo en color rojo Pantone 485.

(B) Módulo de estructura metálica y aluminio con luz interior, con el texto "URGENCIAS". El frontal en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse o reducirse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

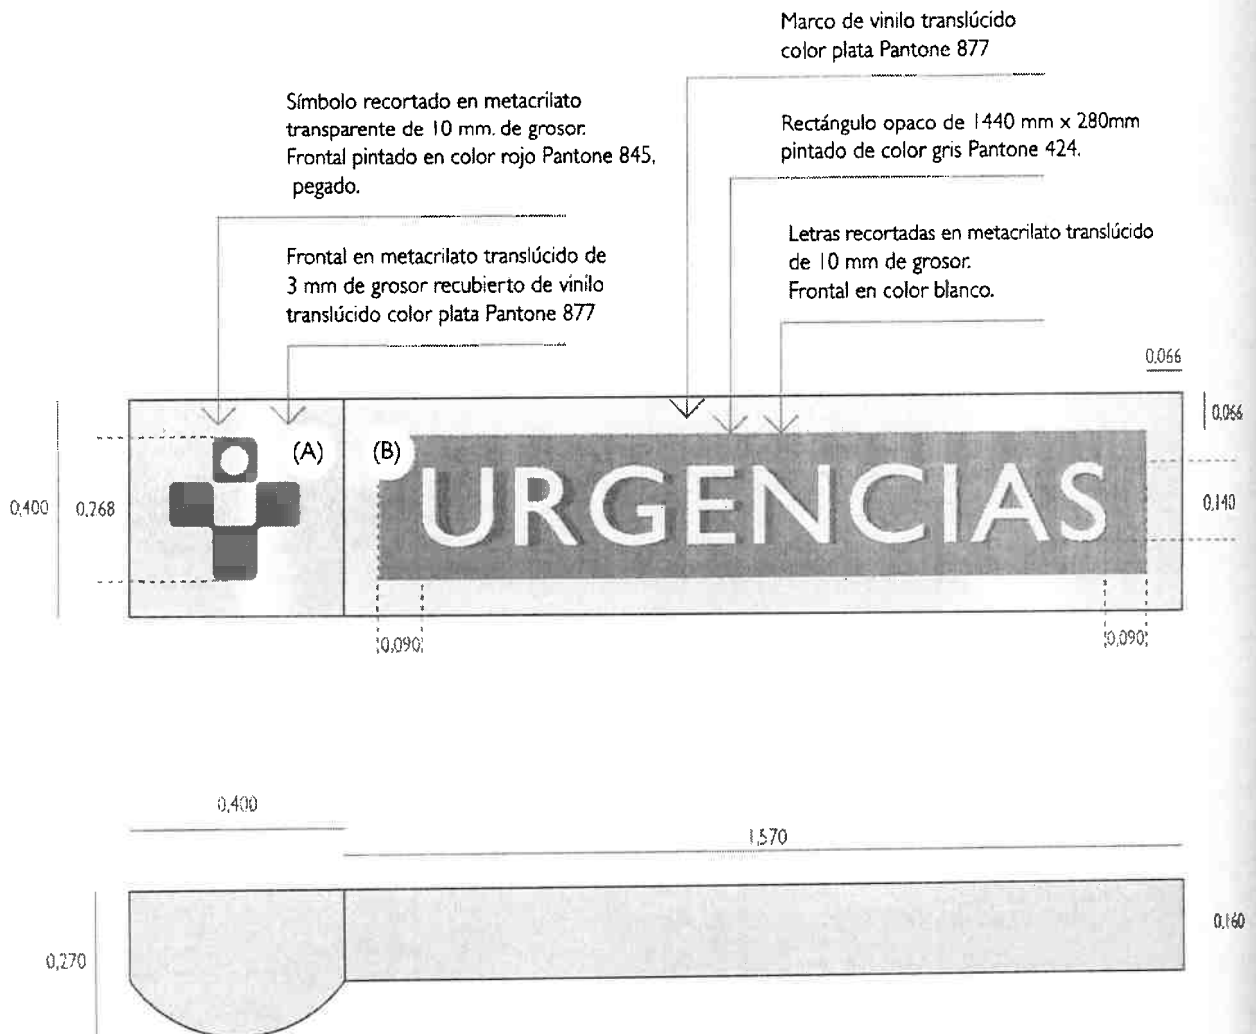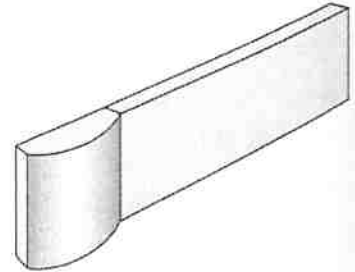

Acotaciones en mm.

Servicio de Urgencias. Banderola luminosa (dos caras) con flecha direccional.

Rótulo formado por dos elementos:


(A) Módulo circular de estructura metálica y aluminio, con luz interior. Pintado en color plata Pantone 877. Frontal en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor recubierto de vinilo translúcido color plata Pantone 877. Llevará el símbolo en color rojo Pantone 485.

(B) Módulo de estructura metálica y aluminio con luz interior, con el texto "URGENCIAS". El frontal en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor.

(B) Módulo de estructura metálica y aluminio con luz interior. El frontal en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor flecha direccional.

Textos: compuestos en Gill Sans normal. Interletraje: 5.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse o reducirse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

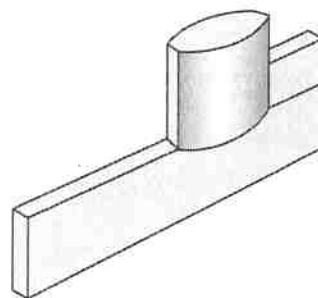

Símbolo recortado en metacrilato transparente de 10 mm. de grosor. Frontal pintado en color rojo Pantone 845, pegado.


Frontal en metacrilato translúcido de 3 mm. de grosor recubierto de vinilo translúcido color plata Pantone 877.

Frontal en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor recubierto de vinilo translúcido color plata Pantone 877.

Flecha recortada en metacrilato transparente de 10 mm. de grosor. Frontal pintado en color gris Pantone 424, pegada.


Letras recortadas en metacrilato translúcido de 10 mm de grosor. Frontal en color blanco.

Rectángulo opaco de 1440 mm x 280mm pintado de color gris Pantone 424.

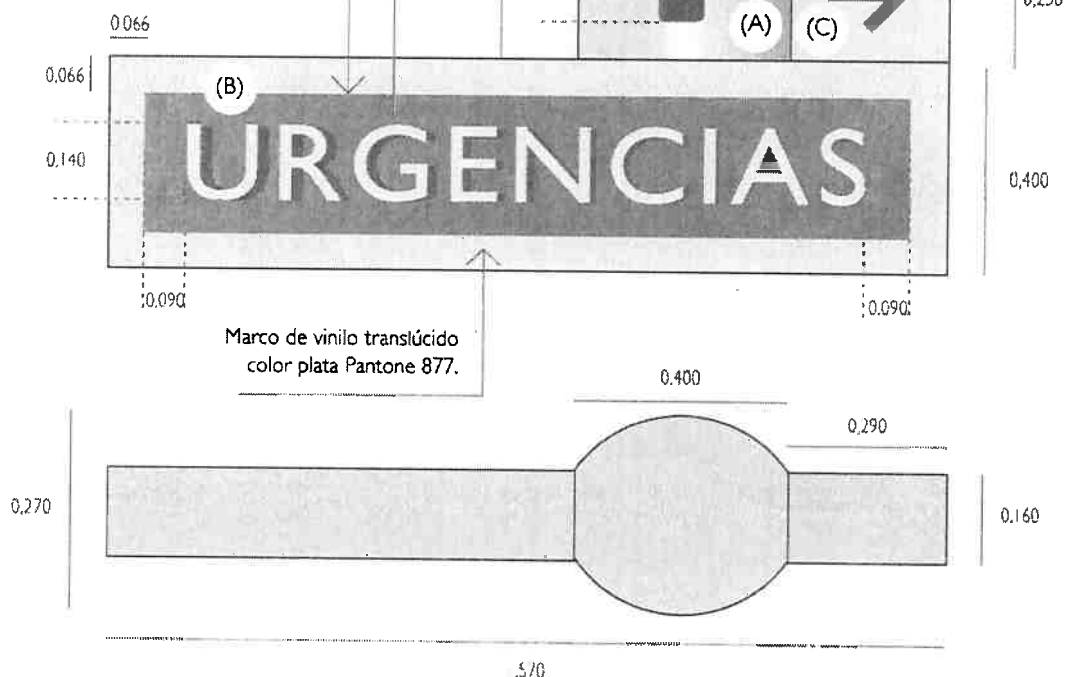

Acotaciones en mm.

SEÑALIZACION SAMU.PDF

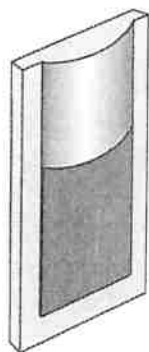

Señalización SAMU. Luminoso.

Rótulo formado por tres elementos:


(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor). Esmerilada horizontalmente.

(B) Módulo circular, con luz interior, en metacrilato translúcido de 3 mm de grosor recubierto de vinilo translúcido, color plata Pantone 877, con la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias". La parte inferior cerrada con metacrilato Opal para dejar salir la luz sobre el letrero, la superior de acero inoxidable.


(C) Placa de plástico de ROWMARK (Lasemax exteriores, LM 922-382 China blue/white) para la rotulación del servicio correspondiente.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.
Interletraje: 5.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

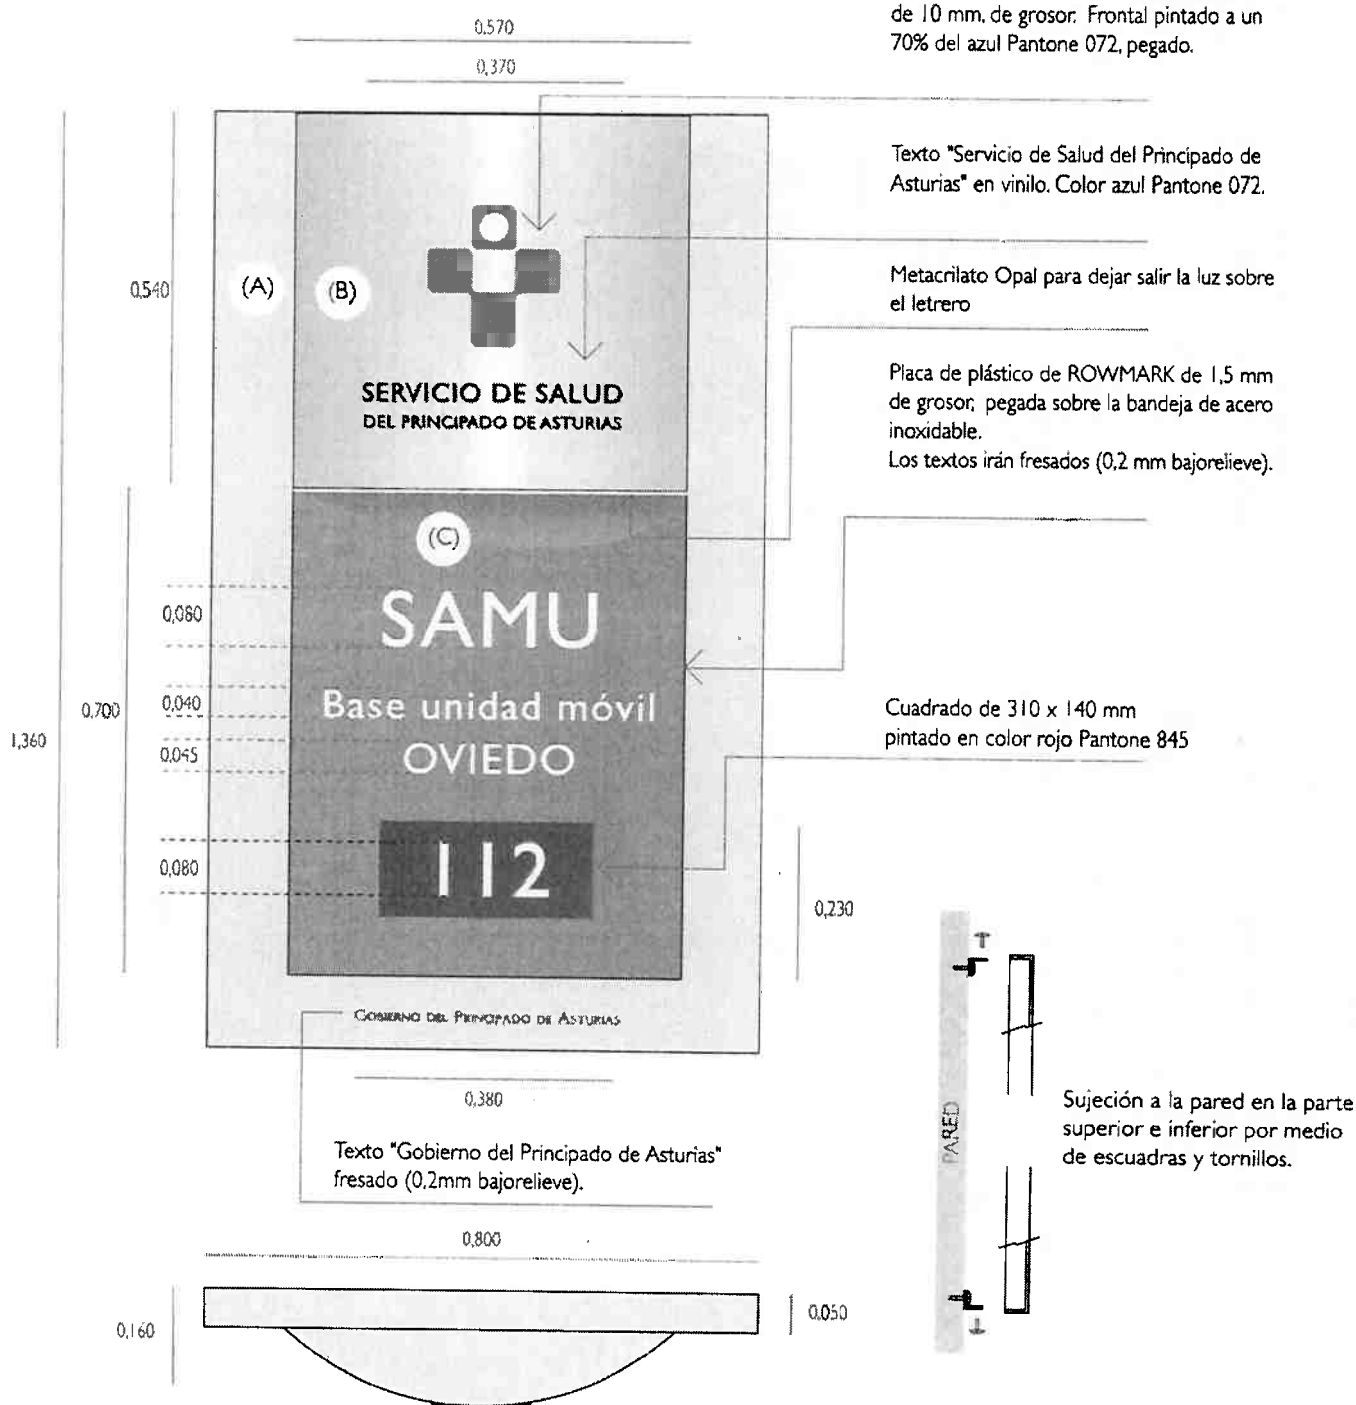

Acotaciones en metros.

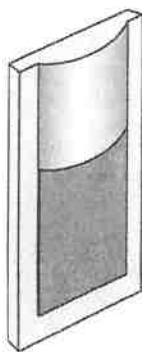

Señalización SAMU.


Rótulo formado por dos elementos:

(A) Bandeja de acero inoxidable mate (1,5 mm de grosor) complementada con el módulo circular en el mismo material, con la identidad gráfica del "Servicio de Salud del Principado de Asturias". Ambos irán esmerilados horizontalmente.

(B) Placa de plástico de ROWMARK (Lasemax exteriores, LM 922-382 China blue/white) para la rotulación del servicio correspondiente.

Textos: compuestos en Gill Sans normal.
Interletraje: 5.

Las medidas son orientativas, pudiendo ampliarse proporcionalmente en el caso que se crea conveniente.

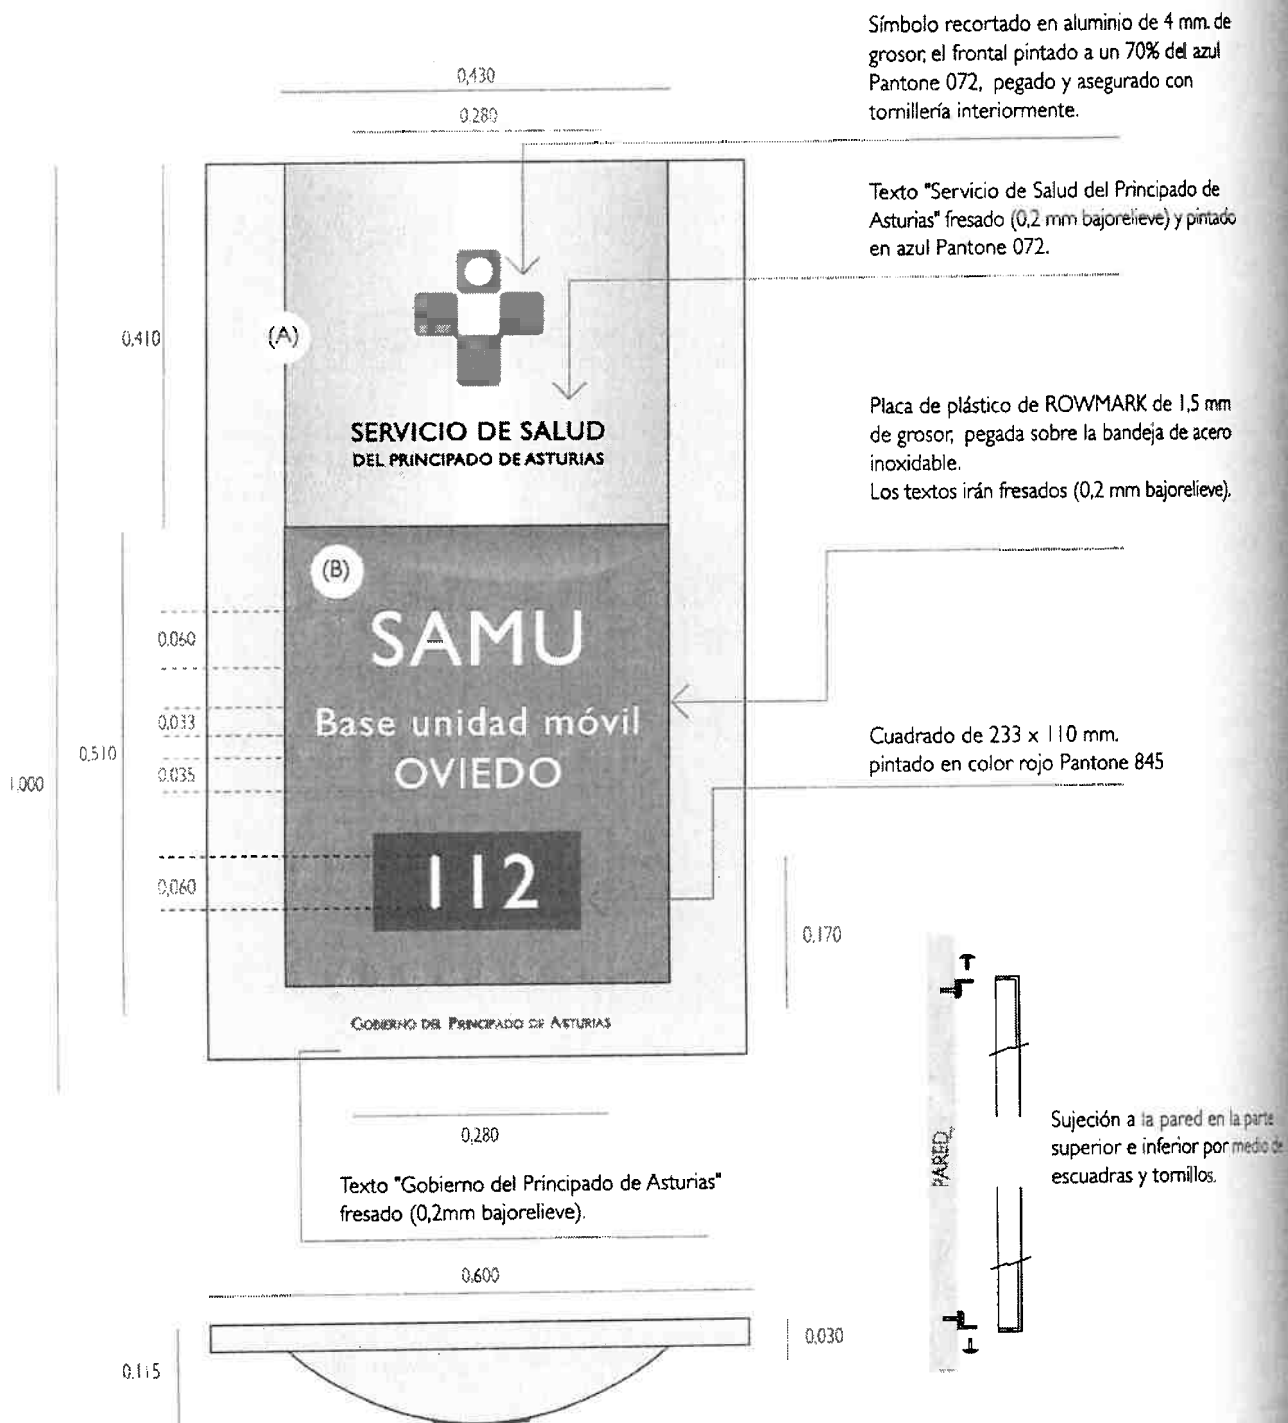

Acotaciones en metros.

ANEXO III PPT- Ficha autoevaluación Lote 1

LOTE 1: MOBILIARIO GENERAL OFICINA

Sublote 1.1 : Alfombra goma eva		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 200 x 200 cm		(indicar medidas)
Fabricada con EVA (no contiene PVC)		
Sublote 1.2 : Armario metálico persiana. Medidas 100x43,5x135cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 100 x 43,5 x 135 cm (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm		
Pintura epoxi		
3 estantes interiores regulables		
Sistema antivuelco		
Cerradura con llave		
Sublote 1.3 : Armario metálico persiana. Medidas 120x43,5x198cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 120 x 43,5 x 198 cm (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm		
Pintura epoxi		
4 estantes interiores regulables		
Sistema antivuelco		
Cerradura con llave		
Sublote 1.4 : Armario metálico persiana. Medidas 100x43,5x198cm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 100 x 43,5 x 198 cm (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm		
Pintura epoxi		
4 estantes interiores regulables		
Sistema antivuelco		
Cerradura con llave		
Sublote 1.5 : Bancada 3 asientos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno		
Estructura metálica epoxi		
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo		
Sin brazos y sin mesa		
Sublote 1.6 : Bancada 4 asientos		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno		
Estructura metálica epoxi		
Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo		
Sin brazos y sin mesa		
Sublote 1.7 : Butaca		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 71 alto x 78 ancho (46 alto asiento y 63 alto brazos) (± 5%)		(indicar medidas)
Estructura interior en madera con forma ergonómica		
Recubrimiento de espuma de poliuretano de densidad variable y alta resiliencia HR		
Patatas de madera de haya		
Tapicería vinílica impermeable antimicrobial, antibacterial y antimicótica		
Sublote 1.8: Cortina enrollable separadora camilla medidas 200 x 270 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 200 cm. ancho x 270 cm. de alto		(indicar medidas)

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)		
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)		
Peso: 407 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,25 – 0,33 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.9 : Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 90x100 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 90 cm. ancho x 100 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.		
Enrollable mediante mecanismo de cadena		
Apertura 3%		
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.		
Color blanco		
Peso: 365-380 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,20 – 0,30 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		

Sublote 1.10 : Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 120x130 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 120 cm. ancho x 130 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.		
Enrollable mediante mecanismo de cadena		
Apertura 3%		
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.		
Color blanco		
Peso: 365-380 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,20 – 0,30 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.11 : Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 130x130 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 130 cm. ancho x 130 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.		
Enrollable mediante mecanismo de cadena		
Apertura 3%		
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.		
Color blanco		
Peso: 365-380 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,20 – 0,30 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.12: Cortina enrollable grado apertura 3% medidas 252x112 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 252 cm. ancho x 112 cm. de alto		(indicar medidas)
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm.		
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Apertura 3%		
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.		
Color blanco		
Peso: 365-380 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,20 – 0,30 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.13: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 140x100		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 140 cm. ancho x 100 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado		
Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)		
Altura mandos 2 metros		
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)		
Peso: 407 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,25 – 0,33 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.14: Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 280x100		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 280 cm. ancho x 100 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado		

Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)		
Altura mandos 2 metros		
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)		
Peso: 407 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,25 – 0,33 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.15 : Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 290x100		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 290 cm. ancho x 100 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado		
Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)		
Altura mandos 2 metros		
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)		
Peso: 407 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,25 – 0,33 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.16 : Cortina enrollable de oscurecimiento black out medidas 295x100		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 295 cm. ancho x 100 cm. de alto		(indicar medidas)
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo		
Fabricado con tubo de aluminio extrusionado		
Enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)		
Altura mandos 2 metros		
Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)		
Peso: 407 gr/m2 aprox.		
Espesor: 0,25 – 0,33 mm		
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1		
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo		
Sublote 1.17 : Estantería medidas 60 x 45 x 120 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 60 x 45 x 120 cms (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricada en melanina		
Trasera 8 mm; Laterales 19 mm		
2 estantes de 25 mm		
Sublote 1.18 : Estantería medidas 125 x 45 x 160 cms		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas 125 x 45 x 160 cms (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricada en melanina		
Trasera 8 mm; Laterales 19 mm		
3 estantes de 25 mm		

Sublote 1.19 : Mesa de oficina 1400 x 800 x 740 mm		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medida de la mesa 1400 x 800 x 740 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Acabado de la superficie mesa en melamina 25 mm.		
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
4 patas metálicas de 50x50 mm		
Bandeja organización para cableado		
Sublote 1.20 : Mesa de oficina 1600 x 800 x 740 mm con ala		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Acabado de la superficie mesa en melamina		(indicar medidas)
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
4 patas metálicas de 50x50 mm		
Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm (± 5%)		
Medida del ala de 960 x 600 x 740 mm (± 5%)		
Faldón a juego con mesa y ala		
Bandeja organización para cableado		
Sublote 1.21 : Mesa para microscopio (2 puestos)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medida de la mesa 120 + 120 x 60 x 74 cm. (± 5%)		(indicar medidas)
Acabado de la superficie mesa en melamina		
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
4 patas de 50x50 mm		
Sublote 1.22 : Mesa Reuniones		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medida 300 x 120 x 74 cm. (± 5%)		(indicar medidas)
Acabado de la superficie mesa en melamina		
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
4 patas de 50x50 mm		
Sublote 1.23 : Mesita auxiliar baja		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medida de 620 x 620 mm (± 5%)		(indicar medidas)
Acabado de la superficie mesa en melamina		
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi		
Altura 400 cm (± 5%)		
Sublote 1.24 : Mesita baja infantil		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: Ø 100 cm x 58 cm de alto (± 5%)		(indicar medidas)
Tapa en laminado de alta presión		
Cantos de DM mecanizados y barnizados		
Sublote 1.25 : Perchero de Pared		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Perchero metálico mural 3 o 4 colgadores		(indicar medidas)
Sublote 1.26: Silla de confidente con brazos color azul oscuro		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento)		
Asiento y respaldo de polipropileno en color azul oscuro		
Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas		
Sublote 1.27: Silla de confidente con brazos color granate		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento)		
Asiento y respaldo de polipropileno en color granate		
Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas		
Sublote 1.28: Silla ergonómica de trabajo color azul oscuro		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Silla ergonómica con regulación automática en altura		

Sistema de regulación con mecanismo SYNCRO bloqueable en varias posiciones		
Asiento ergonómico con curvatura delantera		
Apoyabrazos regulables		
Regulación independiente de la altura del respaldo		
Regulación en profundidad del asiento (trasla/automático)		
Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor aproximadamente, e interior de madera o polipropileno		
Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo		
Sublote 1.29: Silla ergonómica de trabajo color granate		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Silla ergonómica con regulación automática en altura		
Sistema de regulación con mecanismo SYNCRO bloqueable en varias posiciones		
Asiento ergonómico con curvatura delantera		
Apoyabrazos regulables		
Regulación independiente de la altura del respaldo		
Regulación en profundidad del asiento (trasla/automático)		
Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor aproximadamente, e interior de madera o polipropileno		
Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo		
Sublote 1.30: Sillas infantiles bajas		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 39 x 40 x 34 cm (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricado en polipropileno		
Apilables		
A juego con mesa sublote 1.24		
Sublote 1.31: Taburete alto con asiento en madera		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Estructura metálica con 4 patas en tubo de acero redondo de 22x1,5 mm		
Reposapiés en acero		
Tapas en cada tapa en su apoyo en el suelo para evitar roces y ruidos		
Asiento anatómico color haya regulable en altura y con respaldo		
Sublote 1.32: Taburetes ruedas sin respaldo regulable altura.		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Base fabricada en tubo de acero redondo de 25 mm de Ø (± 5%) con ruedas o topes deslizantes		(indicar medidas)
Asiento tapizado polipiel en material ignífugo		
Aro reposapiés		
Incorpora columna de gas para regulación neumática de la altura del asiento		
Sublote 1.33: Taquilla doble cuerpo (colgar y baldas)		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 30x50x180 cm (± 5%)		(indicar medidas)
Fabricadas en chapa de acero		
Pintadas con pintura Epoxi-poliéster		
Bandeja y colgador para perchas		
Bordes sin aristas		
Bisagras ocultas		
Con roseta de ventilación		
Cerradura de cilindro con 2 llaves		
Sublote 1.34: Videoproector con cableado		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Tecnología LCD		
Luminosidad 3200 lumen		

Enfoque manual		
Resolución XGA		
Ratio de proyección 1,5-1,8:1		
Zoom manual		
Con cableado de conexión para correcto funcionamiento		
Sublote 1.35: Vinilos decorativos zona pediatria		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Película de calandre polimérico con polímeros añadidos para reducir su encogimiento		(indicar medidas)
Garantía exterior mínimo 5-7 años		
Medidas 1000x1000 mm($\pm$ 5%) de vinilo recortado con motivo a elegir (elefante, hipopótamo,...)		
Sublote 1.36: Vitrina de pared con 2 puertas correderas de cristal		
Característica técnica	Cumple (si/no)	Observaciones
Medidas: 700x 250 x 500 mm ($\pm$ 5%)		(indicar medidas)
Fabricada en acero esmaltado		
Puertas correderas de cristal con cerradura		
1 estante de cristal		